

ສ້າງຢູ່ອໍານວຍ

ສ້າງຢູ່ລະຫັດທີ່ ๑๓/ໜັກຫຼາ

ສ້າງຢູ່ອໍານວຍບັນຫຼື້ນ ຄະ ອົງຄະນາຄະບົມບໍ່ຈ້າງຫັດສະແດງເກົ່າ ຕໍາບຳລຸ່ມທ່າເກະຍົມ ອຳເກົດເມື່ອສະແດງ ຈັງຫັດສະແດງ ເມື່ອວັນທີ ೨೯ ກັນຍານ ២៥៦៤ ຮະຫວັງອົງຄະນາຄະບົມບໍ່ຈ້າງຫັດສະແດງ ໂດຍ ນາງຂໍ້ວູ້ເຮືອນ ເຖິງທອງຕໍາແໜ່ງ ນາຍກອງອົງຄະນາຄະບົມບໍ່ຈ້າງຫັດສະແດງ ທີ່ຈຶ່ງຕ່ອໄປນີ້ໃນສ້າງຢູ່ອໍານວຍເຊີງວ່າ "ຜູ້ຂ້ອ" ຝ່າຍທີ່ນີ້ກັບ ບຣິ່ນທ ໂປຣມະກິດສຳຈຳກັດ ຈຶ່ງຈົດທະເບີນເປັນນິຕິບຸຄຄລ ຄະ ສຳນັກງານທະເບີນຫຸ້ນສ່ວນບຣິ່ນທກຸງເທັມຫານຄຣກຣມພັດນາອຽກຈິກຄາມຄ່າກະທຽວພາລິ່ຍ ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ ອູ້ລົງທຶນທີ່ ១ ຂອຍສຸຄນຮສວສດີ ២៦ ຕໍາບຳລ/ແຂວງ ລາດພຣ້າວ ອຳເກົດ/ເຂົຕ ລາດພຣ້າວ ຈັງຫັດ ກຽງເທັມຫານຄຣ ໂດຍ ນາຍເກະຍົມ ສຸຄນຮຣັຕນ ປຣາກງູ້ຕາມຫັນສື່ວັບຮອງຂອງ ສຳນັກງານທະເບີນຫຸ້ນສ່ວນບຣິ່ນທກຸງເທັມຫານຄຣ ກຣມພັດນາອຽກຈິກຄາມຄ່າກະທຽວພາລິ່ຍ ລົງວັນທີ ១៩ ສີງຫາຄມ ២៥៦៤ ແລະມອບຈຳນາຈໃຫ້ ນາຍຟັງຮູ້ອຸ້ມ ເຈິລຸໂສຣ ຕາມຫັນສື່ວັບຮອງຈຳລັງວັນທີ ២៩ ກັນຍານ ២៥៦៤ ທະເບີນນິຕິບຸຄຄລເລຂທີ່ ០១០៥៥៦០៣២៥៣១៥ ແນບທ້າຍສ້າງຢູ່ອໍານວຍນີ້ ຈຶ່ງຕ່ອໄປນີ້ໃນສ້າງຢູ່ອໍານວຍເຊີງວ່າ "ຜູ້ຂ້ອ" ອົກຈ່າຍທີ່ນີ້

ຜູ້ສ້າງຢູ່ໄດ້ຕໍກລົງກັນມີຂໍອຄວາມດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

ຫຸ້ນ ១. ຂໍອຕໍກລົງຫຼື້ນ

ຜູ້ຂ້ອຕໍກລົງຫຼື້ນແລະຜູ້ຂ້າຍຕໍກລົງຫຼື້ນ ໂດຍ (ຮັດຕູ) ປຣິມາຕຣກຣະບອກສູບ ២,៣៥៥ ຊື່ ຫຣິກໍາລັ່ງເຄື່ອງຍົນທີ່ ១២០ ກີໂລວັດຕີ່ ຂະນາດ ១៦៣ ແຮງມ້າ ៣,៦០០ ຮອບຕ່ອນທີ່ ຈຳນວນ ៣ (ສາມ) ດັ່ງວິທີປະກວດຮາຄາ ອິເຄີກທຣອນິກີສ (e-bidding) ຮວມເປັນຮາຄາທີ່ສິ້ນ ៧,៤៥៧,០០០.០០ ນາທ (ເຈົ້າລ້ານສື່ແສນເກົ້າໜີ່ເຈັດພັນບາທຄ້ວນ) ຈຶ່ງໄດ້ຮັມກາເງີນມຸລຄ່າເພີ່ມ ຈຳນວນ ៥២០,៥៥៧.៥៥ ນາທ (ສື່ແສນເກົ້າໜີ່ສື່ຮ້ອຍໜ້າສົບເຈັດບາທເກົ້າສົບສື່ສຕາງ) ຕລອດຈົນກາເງີນຈຳກັດ ແລະ ອິນໆ ແລະ ອົກຈ່າຍທີ່ຈ່າຍທັງປະງວດດ້ວຍແລ້ວ

ຫຸ້ນ ២. ກາຮຮັບຮອງຄຸນກາພ

ຜູ້ຂ້າຍຮັບຮອງວ່າສິ່ງຂອງທີ່ຂ້າຍໄຫ້ຕາມສ້າງຢູ່ອໍານວຍນີ້ເປັນຂອງແທ້ ຂອງໃໝ່ ໄນເຄີຍໃຫ້ຈຳນວກອ່ອນ ໄນເປັນຂອງເກົ່າເກີນ ແລະ ມີຄຸນກາພ ແລະ ຄຸນສມບັດໄມ່ຕໍ່ກ່າວ່າທີ່ກໍາທັນໄວ້ໃນເອກສາຮແນບທ້າຍສ້າງຢູ່ອໍານວຍ ១ ແລະ ២
ໃນການທີ່ເປັນກາຮ່າງສິ່ງຂອງຊື່ຈະຕ້ອງມີການຕຽບທົດສອບ ຜູ້ຂ້າຍຮັບຮອງວ່າ ເມື່ອຕຽບທົດສອບແລ້ວ ຕ້ອງມີຄຸນກາພແລະ ຄຸນສມບັດໄມ່ຕໍ່ກ່າວ່າທີ່ກໍາທັນໄວ້ຕາມສ້າງຢູ່ອໍານວຍນີ້ດ້ວຍ

ຫຸ້ນ ៣. ເອກສາຮອັນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສ້າງຢູ່


ເອກສາຮແນບທ້າຍສ້າງຢູ່ອໍານວຍດັ່ງຕ່ອໄປນີ້ໄຫ້ດືກເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສ້າງຢູ່ນີ້

៣.១ ພັນວັກ ១ ສຳເນາໄບເສັນອຮາຄາຫຼື້ນ	ຈຳນວນ ២ (ສອງ)	ໜ້າ
៣.២ ພັນວັກ ២ ສຳເນາແຕ້ຕາລືອກ	ຈຳນວນ ៦២ (ຫກສົບສອງ)	ໜ້າ

ຄວາມໄດ້ໃນເອກສາຮແນບທ້າຍສ້າງຢູ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັມແຍ້ງກັບຫຼື້ນ ໃຫ້ໃໝ່ຫຼື້ນໃນສ້າງຢູ່ນີ້ ໃຫ້ໃໝ່ຫຼື້ນໃນສ້າງຢູ່ນີ້ບັນດັບ ແລະ ໃນການທີ່ເອກສາຮແນບທ້າຍສ້າງຢູ່ບໍ່ແຍ້ງກັນເອງ ຜູ້ຂ້າຍຈະຕ້ອງປະກົບຕິດາມກໍາວິນຈັຍຂອງຜູ້ຂ້ອ ກໍາວິນຈັຍຂອງຜູ້ຂ້ອໄຫ້ດືກເປັນທີ່ສຸດ ແລະ ຜູ້ຂ້າຍໄມ່ມີສິທິສີເຮີຍກ່ຽວກັບຮາຄາ ອົກຈ່າຍທີ່ຈ່າຍໄດ້ເພີ່ມເຕີມຈາກຜູ້ຂ້ອທັງສິ່ນ

(ລົງຫຼື້ນ)
(ນາງຂໍ້ວູ້ເຮືອນ ເຖິງທອງ)

ຜູ້ຂ້ອ
ງາງ

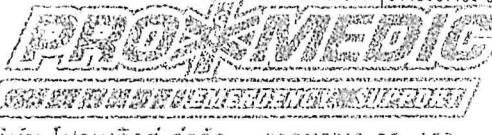
ນະພັກ ໂປຣມະເມີກີສ ຈຳຕັດ PAGMEPIC CO., LTD
(ນາຍຟັງຮູ້ອຸ້ມ ເຈິລຸໂສຣ)

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็นแคชเชียร์เช็คธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาสีแยgwang hin เลขที่ ๑๑๔๑๖๓๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ตามใบเสร็จรับเงินของค่าบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เลขที่ RCPIA-๐๙๒๕๘/๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๓๗๔,๙๕๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (๕ %) ของราคากำหนดตามสัญญามา谋ให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อเป็นหลักการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกัน ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทรานส์ฟอร์มแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอีเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพันข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมา谋ให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมา谋ให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมา谋ให้แก่ผู้ซื้อภายใน๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมา谋ไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีค่าเบี้ยเมื่อผู้ขายพันจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในการนี้ที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๙ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดสั่ง แล้วแต่กรณี ภัยในกำหนด ๓ (สาม) เดือน นับถ้วนจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคากำหนดที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถ้วนจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา


(ลงชื่อ)



ผู้ซื้อ

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)



บริษัท ප්‍රොමේදික් จำกัด PROMEDIC CO., LTD.
(ลงชื่อ) 
ผู้ขาย
(นายณัฐวุฒิ เจริญศรี)

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสาระแก้ว ภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้พร้อมทั้งที่บห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ไม่ว่าจะเป็น การส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือแนบปีนต่อผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสาระแก้ว ในเวลาราชการก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ และส่งมอบพัสดุ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสาระแก้ว ในวันเวลาราชการ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบแล้วว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้วผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเองและระยะเวลาที่เสียไปเพราเหตุดังกล่าว ผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน (จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

ผู้ซื้อคงเหลือเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขายเมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดย ครบถ้วนแล้วและโอนทะเบียนให้แก่ผู้ซื้อแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๓ (สาม) ปี นับตั้งจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้อุகค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรออยู่ให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ได้

(ลงชื่อ)

ผู้ซื้อ

(นางสาวอรุณ เทียนทอง)



(ลงชื่อ)

(นายณัฐวุฒิ เจริญศรี)

ผู้ขาย

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังนี้ หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดีลด์ค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อ ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ)

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

ผู้ซื้อ



ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญาฯ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมาบังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมาบังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรคสองและวรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติตามที่ต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



บริษัท ไทยเนวิเกชั่น จำกัด ที่ ๗๗๘ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๖ โทร.

(ลงชื่อ) ผู้ขาย
(นางสาววันรุ่ง เทียนทอง)

(ลงชื่อ) ผู้ขาย
(นายณัฐวุฒิ เจริญศรี)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาววิรารณ ปุริสพันธ์)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางภัครกนล ทองใบ)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๔๗๑๙๔๗๔
เลขคุณสัญญา ๖๔๐๔๑๑๑๑๔๐๑๑

บันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา
โครงการ 7.1 รดพยานمال (รถตู้)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสาระแก้ว

ลักษณะเลขที่ : CNTR-0452/64

แผนกเอกสารและสัญญา	งานศูนย์ภารกิจการลากภาระฯ	ตัวครุภัณฑ์	ครัวภัณฑ์การแพทย์และยาเมือง
--------------------	---------------------------	-------------	-----------------------------

รายละเอียดของเงินทำสัญญา

ลักษณะเลขที่ : 64-42-00224-5410300-00002

ที่อยู่ : บริษัท โนร์เวย์ เทคโนโลยี จำกัด

ประเภทเจ้าหนี้ : ผู้ประกอบการรับเหมาเพิ่ม

ที่อยู่ : 1 ซอยคลองแพร 26 แขวงลาดพร้าว เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

วันที่ทำสัญญา : 29 กันยายน 2564

ระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ : 120 วัน

วันที่ต้องดำเนินการ : 30 กันยายน 2564

วันที่สิ้นสุดสัญญา : 27 มกราคม 2565

เหตุผลและความจำเป็น
ที่ต้องดำเนินการก่อนวันที่
ทำสัญญา

รวมเงินทำสัญญา : 7,497,000.00 บาท ชำระเดือนละ 1 จ่าย

จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายคืนไม่ไปตามสัญญา/หักลดลง)

เงินเดือนประจำ : % ของวงเงินตามสัญญา/หักลดลง

0.00 บาท

เงินประจำเดือนงาน : % ของวงเงินหักเดือนในแต่ละงวด

อัตราค่าใช้จ่าย : 0.20 ของมูลค่าพัสดุที่ซื้อไม่ได้ลงมา

หลักประกันเดือนถัดไป.....

รายละเอียดโครงการ

จัดซื้อจัดจ้างพยาบาล (รถตู้) ปรับมาตรการทางลูกค้าไม่ต่ำกว่า 2,400 ต่อ หนึ่งเดือน ต้องการเดินทางโดยรถตู้ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลเมตร จำนวน 3 คัน

รวมผลลัพธ์การแบ่งภาระการจ่ายเงินเดือนให้สัดส่วน



ลงชื่อ.....
(นางสาวณัฐเรือน เพชรนทอง)
วันที่..... ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....
(นางนวีวรรณ บุรีสพันธ์)
วันที่..... ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....
(นายณัฐพล ใจดี)
วันที่..... ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....
(นางภัครกมล ทองใบ)
วันที่..... ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔

ลักษณะเอกสาร : CNTR-0452/64

รายละเอียดการจ่ายเงิน

1	7,497,000.00	7,497,000.00	0.00	0.00	7,497,000.00
ประกอบเด้าย ผู้นำทีประมาด 7,497,000.00 บาท					
รวม	7,497,000.00	7,497,000.00	0.00	0.00	7,497,000.00

ลงชื่อ.....
ก.
 (นางชัยรัตน์ เทียนทอง)
 วันที่..... ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....
ก.
 (นางสาววรรณ บุรีสพันธ์)
 วันที่..... ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔

PROMEDIC
 บริษัท โปรเมดิค จำกัด
 บริษัท โปรเมดิค จำกัด ๗๙๙๗ ๘๙๙๗

ลงชื่อ.....
ก.
 (นางสาวนริษา ใจดีวงศ์)
 วันที่..... ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....
ก.
 (นางกัศกรกล ทองใบ)
 วันที่..... ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔

ใบเสนอราคาซื้อตัวยิริสประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

๑. ข้าพเจ้า บริษัท โพรเมดิกส์ จำกัด อาคาร ห้องเลขที่ ๑ ชั้นที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลสุคนธสวัสดิ์ ๒๖ ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๓๐ โทรศัพท์ ๐๘๐๐๑๑๑๑๗๙ โดยนายเกษตร สุคนธรัตน์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณา เงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารซื้อตัวยิริส e-Bidding และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๔/๒๕๖๔ โดยตลอดและยอมรับข้อ ก咽喉ตและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของ ทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อตัวยิริส e-Bidding ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ราคាធ່ອ หน่วย	ภาษีมูลค่า เพิ่ม (ถ้า มี)	จำนวน	รวมเป็นเงิน	กำหนดส่ง มอบ
๑	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตร ระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่อง ยนต์ไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์			๓ คัน	๗,๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๗๐
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้างเลขที่ ๙๗/๒๕๖๔ ผู้เสนอ: แผ่นที่ ๑ ในจำนวน ๒ แผ่น </div>						
รวมเป็นเงินขึ้นศิษย์ละเอียดประกอบสัญญาฉบับเดียว จำนวนที่ ๙๗ ก.ย. ๙๗๖๔						

(เจ้าค้ำยสัมภาระค่าหักห้ามเดินทางไกล) ท่านนายปัชชาภาณุกุล ที่ชื่อ/นามสกุล:
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ดังนี้ (๙๗๖๔)
(นางสาวณัฐเรือน เทียนทอง)

บังคับใช้เงินอันจะมีอยู่เป็นระยะเวลานาน (๙๗๖๔) นับแต่วันเสนอราคา และ องค์กรบริหารส่วนจังหวัด ผู้ชาย/ผู้หญิง
อาจรับคำสั่งให้ดำเนินการใดก็ตามที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาโดยชอบด้วยความเหตุผลอัน
คุณธรรมที่สูงสุด ให้ดำเนินการดังกล่าว ห้ามเดินทางไกล ๑๕๕๗ (๙๗๖๔)
เมื่อวันที่..... (ลงชื่อ)..... พยาน (นางสาววรรณ บุริสพันธ์)

ลงชื่อ..... ในการซื้อตัวยิริสได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวด ค่าอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า^{๙๗๖๔}
ลงชื่อ..... พยาน (นางสาววรรณ บุริสพันธ์)

ลงชื่อ..... ทราบด้วยว่า..... ทราบด้วยว่า..... พยาน (นางกัครกมล ทองใบ)

๔.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารซื้อตัวยิริส e-bidding กับ องค์กร
บริหารส่วนจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อตัวยิริส e-bidding ให้แก่ องค์กรบริหารส่วนจังหวัด ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญางานเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลาง
สัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา นี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมรับโทษท้าทายต่อส่วนจังหวัด
รับ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์สืบค้าประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่
องค์กรบริหารส่วนจังหวัด และ องค์กรบริหารส่วนจังหวัด มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคาซื้อตัวยิริสเป็นประวัติการได้หรือ
องค์กรบริหารส่วนจังหวัด อาจเรียกประภาตราค่าใหม่ก็ได้ (นางกัครกมล ทองใบ)

๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอี้น หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ ฯ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคากำไร

๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เข่น ตัวอย่าง (sample) แต่ละลักษณะ แบบรูปประยุกต์
และเชิงดุล คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) พร้อมใบเสนอราคาก ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ
สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอี้น ข้าพเจ้ามอบ เช็ค เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาก เป็นเงินจำนวน ๓๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ในเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทเรียดดิรรัม และประศจากกลั่นอัด หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห่วยบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคากันในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔	เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๙๗/๒๕๖๔
ผู้เสนอ..... ๙	ผู้รับ..... ๖
ผู้รับ..... ๖	ผู้เสนอ..... ๙
แบบรายละเอียดประการผู้จัดการซื้อขาย/ซื้อขายวันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๔	

ใบเสนอราคากำรเลขที่ 6409160006066
รหัสอ้างอิง OTP hNop

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๑๐๐๔๔๔๐๐๖๐๖๖ (ลงชื่อ) ๗๙๗๐ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
บริษัท โปรเมติกส์ จำกัด PROMETIC CO., LTD. (ลงชื่อ) นางสาวกุญชล ใจดี (ลงชื่อ) พยาน
ลงชื่อ..... ๗๙๗๐ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
นางสาววรรณา บุริสพันธ์ (ลงชื่อ) พยาน
ลงชื่อ..... ๗๙๗๐ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
นางภัครกมล ทองใบ (ลงชื่อ) พยาน

คณะกรรมการ E-bidding
เมื่อวันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๔

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ

สำเนาถูกต้อง


(นางภัครกมล ทองใบ)


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน

วัตถุประสงค์ ใช้ในการอุบัติการที่มีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลในผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดย บุคลากรที่เหมาะสม ออาที่ พแพทย์ พยาบาล เภสัชกรฉุกเฉิน และใช้ชันส่งผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน

๑. คุณสมบัติทั่วไป (หมวด ก.)

- ๑.๑ เป็นรถยนต์สี่ข่าวน้ำพ่วงไม่มีเครื่องยนต์ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีตัวรถและเครื่องยนต์จากผู้ผลิตเดียวกัน มีเครื่องหมายรถพยาบาลตามตัวอย่างของทางราชการทั้งชุด - ขาว พร้อมห้องพ่นตราหรือ เครื่องหมายของหน่วยงานนั้นตามที่กำหนดในภายหลัง
- ๑.๒ สามารถบรรทุกผู้ป่วย และผู้โดยสารอื่นได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน เอกสารแบบสั่งยาชี้ช้ำ/สั่งยาชี้ช้ำ เลขที่ ๙๗/๒๕๖๖
- ๑.๓ กระจากห้องน้ำด้วยฟิล์มกระรองแบบบังคับด้านหน้า คนขับซื้อ ผู้ขับ..... ส่วนที่..... แผ่น
- ๑.๔ ในห้องคนขับและห้องพยาบาลติดตั้งระบบปรับอากาศเป็นแบบค่อยๆ เอน แยกห้องคุณ แอร์ทุก ๑๘๐๐ แบบรุ่นน้ำเสียง เสียงดัง ฉุกเฉินที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๖
- ๑.๕ ห้องห้องด้านหลังห้องพยาบาลเป็นแบบแอร์ (หลังที่ ๗) โดยมีช่องลม... ผู้เชื้อ/ผู้ว่าจ้าง
- ๑.๖ ห้องคนขับมีประตูปิด - เปิดห้องด้านซ้ายและด้านขวา มีกุญแจสักหัวเดียวเปิดเข้าออกได้ช่วงหน้า ห้องคนขับ กุญแจชุดเดียวกันทั้งสองฝั่ง ห้องคนขับ กุญแจชุดเดียวกันทั้งสองฝั่ง
- ๑.๖.๑ ผู้ขับขี่ต้องรู้จักซึ่งหลังชุดคัดเป็นห้องพยาบาล (ดูรูป) บริษัท ดี.เค. พ. ๒๕๖๖
- ๑.๖.๒ ผ่านการรับรองมาตรฐานป้องกันการลื่น宙นมาตรฐาน EN ๑๓๐๘๕ (ลิงชื่อ) พยาน
- ๑.๖.๓ ผ่านการรับรองมาตรฐานป้องกันการไหมไฟตามมาศ (มาตรฐานต้องห้ามติดไฟ)
- ๑.๖.๔ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อม คณะกรรมการ e-bidding แบบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย ๘ ก.ย. ๒๕๖๖
- ๑.๖.๕ ผลิตภัณฑ์ Altro / ผู้ขับขี่..... ล็อชื่อ..... ประชานกรรมการ
- ๑.๗ มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายกำหนดแบบ LED ดวงเดียว ๑๗๕๕๘๔ ติดตั้งด้านหน้าเท่านั้น ล็อชื่อ..... กรรมการ
- ๑.๗.๑ ดวงไฟมีความกว้าง ๘ ซม. ยาว ๑๗.๘ ซม. และหนา ๒.๗ ซม.
- ๑.๗.๒ ฝาครอบไฟเป็นแบบใสหรือสีใช้สัดสูตรความร้อนชนิด Polycarbonate ทนต่อ แสงแดดได้ดี
- ๑.๗.๓ ชุดสัญญาณไฟ LED แต่ละชุดใช้หลอด LED จำนวน ๒๕ ดวง สำเนาถูกต้อง

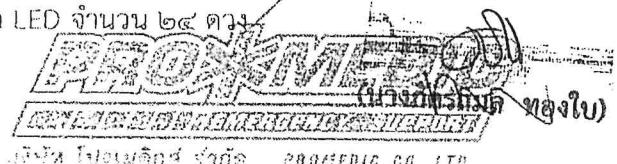

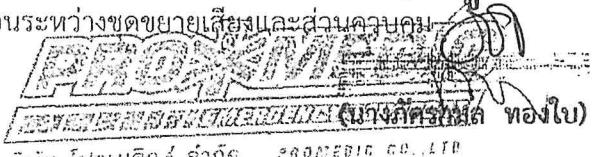- ๑.๗.๔ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อม
แบบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย✓
- ๑.๗.๕ สัญญาณไฟที่เสนอผ่านการรับรองมาตรฐาน SAE J๕๘๕ โดยแบบเอกสารมาพร้อมใน
วันเสนอราคา✓
ผลิตภัณฑ์ AXIXTECH รุ่น R7✓
- ๑.๘ ส่วนท้ายรถติดตั้งคอมไฟแบบ LED จำนวน ๒ โคม โดยมีคุณลักษณะดังนี้✓
- ๑.๘.๑ ดวงไฟความกว้าง ๗ ซม. ยาว ๑๓.๒ ซม. และหนา ๒.๒ ซม.✓
- ๑.๘.๒ ฝาครอบไฟเป็นแบบใสหรือสีใช้วัสดุทนความร้อนชนิด Polycarbonate หนาต่อ
แสงเด็ดได้ดี✓
- ๑.๘.๓ ชุดสัญญาณไฟ LED แต่ละชุดใช้หลอด LED จำนวน ๑๒ ดวง✓
- ๑.๘.๔ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อม
แบบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย✓ คณะกรรมการ e-bidding - ก.ย. ๒๕๖๔
- ๑.๘.๕ สัญญาณไฟที่เสนอผ่านการรับรองมาตรฐาน SAE J๕๘๕ โดยแบบเอกสารมาพร้อมใน
วันเสนอราคา✓ ลงชื่อ..... บัญชีการ
- ผลิตภัณฑ์ AXIXTECH รุ่น R4 เอกสารแนบท้ายสัญญาซึ่งมีสัญญาณไฟติดตั้ง
บนด้านข้างของไฟตัดหน้าและไฟตัดหลัง จำนวน ๑ ชิ้น (ก.ย. ๒๕๖๔) ลงชื่อ..... บัญชีการ
- ๑.๙ ติดตั้งดวงไฟฉุกเฉินแบบ LED ด้านข้างด้านหน้าพ้ายานพาหนะ ๒ ดวง โดยมีคุณลักษณะดังนี้✓ บัญชีการ
๑.๙.๑ ดวงไฟความกว้าง ๑๐.๕ ซม. ยาว ๑๕.๕ ซม. และหนา ๒.๕ ซม. แบบรูปหลังไฟตัดหน้าตัดหลัง
- ๑.๙.๒ ฝาครอบไฟแบบใสหรือสีใช้วัสดุทนความร้อนชนิด Polycarbonate หนาต่อ
แสงเด็ดได้ดี (ลงชื่อ)..... (นางสาวอรุณรัตน์ ใจดี) ลงชื่อ..... (นางสาวอรุณรัตน์ ใจดี)
- ๑.๙.๓ ไฟตัดฉุกเฉิน LED แต่ละชุดใช้หลอด LED ๒๔ ดวง (ลงชื่อ)..... ผู้ขาย/ผู้รับซื้อ
- ๑.๙.๔ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อม
แบบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย✓ ลงชื่อ..... พยาน
- ๑.๙.๕ สัญญาณไฟที่เสนอผ่านการรับรองมาตรฐาน SAE J๕๘๕ โดยแบบเอกสารมาพร้อมใน
วันเสนอราคา✓ ลงชื่อ..... (ลงชื่อ)..... พยาน
- ผลิตภัณฑ์ AXIXTECH รุ่น R6 (ลงชื่อ)..... (นางสาวอรุณรัตน์ ใจดี) พยาน
- ๑.๑๐ มีเครื่องขยายเสียงใช้เรนแบบแยกส่วนขนาด ๒๐๐ วัตต์ ใช้กับไฟกระแสตรง ๑๒ โวลท์
จำนวน ๑ เครื่อง ติดตั้งในห้องคนขับประกอบไปด้วย✓
- ๑.๑๐.๑ เครื่องขยายเสียงใช้เรนแบบแยกส่วนระหว่างชุดขยายเสียงและส่วนควบคุม
สำเนาถูกต้อง
- 
นายวิวัฒน์ ใจดี (นายวิวัฒน์ ใจดี ทองใบ)
นายวิวัฒน์ ใจดี (นายวิวัฒน์ ใจดี ทองใบ) PROMEDIC CO., LTD.

- ๑.๑๐.๒ ส่วนควบคุมมีไมโครโฟนชนิด DYNAMIC มีสวิทช์สำหรับควบคุมการพูด (Push to Talk) มีปุ่มควบคุมการเปิด-ปิดไฟไม่น้อยกว่า ๔ ปุ่ม สายไมโครโฟนเป็นแบบ Coiled Tubing พร้อมที่ยึดไมโครโฟน
- ๑.๑๐.๓ มีเสียงไซเรนแบบต่างๆ ให้เลือก ๔ เสียง
ผลิตภัณฑ์ AXIXTECH รุ่น MODEL AS580✓
- ๑.๑๐.๔ สำปิงขยายเสียงขนาด ๑๐๐ วัตต์ แบบความต้านทาน ๑๖ โอห์ม จำนวน ๒ ตัว
ผลิตภัณฑ์ AS Signal รุ่น AS150✓
- ๑.๑๑ ด้านหลังคนขับติดกับผนังกันห้องออกแบบให้มีเก้าอี้ ๒ ที่นั่ง ติดตั้งแขวนบนโครงโลหะ ของผนังกันโดยไม่มีขาวางบนพื้น หันหน้าไปทางด้านท้ายรถ พร้อมเข็มขัดนิรภัยประจำเก้าอี้ เอกสารแนบท้ายลักษณะของ/สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๙๗/๑๔๗๘
แต่ละที่นั่ง ด้านได้เก้าอี้หั้งสองตัวมีคาดเก็บของ ผนังกัน.....แผ่นที่.....๐ ใบ.....๑ ในจำนวน.....๑๖ แผ่น
- ๑.๑๒ มีท่อออกซิเจนอลูมิเนียมม้ำหนักเบา ขนาดตามมาตรฐาน ๔ คู่ จำนวน ๒ ห่อ ติดตั้งอยู่บานประตู ก.ย. ๒๕๖๔
- ออกซิเจนตั้งกล่าวเดินระบบ Pipe Line ออกไปยังแผงอุ่นออกซิเจนด้านข้างรถ
- ๑.๑๓ ติดตั้งตู้เก็บถังออกซิเจน ในข้อ ๑.๑๒ (ลงชื่อ)๖ ผู้ชื่อ/ผู้รับ.....
- ๑.๑๔ มีคอนโซลยาวทางด้านขวาของตัวรถ สำหรับใส่เครื่องมือแพทย์ตัวต่อตัว เช่นยาและไข้ข้างใต้ ติดตั้งโดยยกแบบเพื่อร่องรูน้ำเสียด้วยปูมน้ำ (กรอบปูมน้ำเสียด้วยชีวิตฉุกเฉินที่ซึมในตัว)
- ๑.๑๕ ด้านบนหน้าจอด้านในปูมน้ำเสียด้วยชีวิตฉุกเฉินที่ซึมในตัว บริเวณด้านขวา (ปูมน้ำเสียด้วยชีวิตฉุกเฉินที่ซึมในตัว) ผู้ชาย/ผู้รับ.....
บริษัทกัณฑ์พร้อมฝาปิดแบบบานเหล็กสปริง (ลงชื่อ)๖ พยาน
- ๑.๑๖ ผนังกันระหว่างห้องคนขับและห้องพยาบาล รวมถึงชั้นล่าง (ปูมน้ำเสียด้วยชีวิตฉุกเฉินที่ซึมในตัว) ๑๕ และ ส่วนของหลังคาภายในห้องพยาบาลรวมถึงผนังอย่างในห้องพยาบาลสีขาว Polymer Composites และอลูมิเนียม (ลงชื่อ)๖ พยาน (นางภัครกนก ทองใบ)
- ๑.๑๗ มีที่แขวนน้ำเกลือสำหรับผู้ป่วยแบบพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน ผลิตจากยางหล่อ ผ่านการรับรอง ความปลอดภัยตามมาตรฐาน EN ๑๗๘๔ ด้วยการทดสอบด้วยมาตรฐาน ISO ๙๐๘๐ ได้รับความเห็นชอบ พร้อมแบบเอกสารรับรอง✓ เมื่อวันที่๕ ก.ย. ๒๕๖๔
ผลิตภัณฑ์ SPENCER ลงชื่อ..... ประทานกรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
- ๑.๑๘ ด้านซ้ายข้างน้ำกับเตียงผู้ป่วยออกแบบให้มีเก้าอี้ตัวหนึ่งตัวนั่งอีกตัวหนึ่ง สำหรับผู้คนพิการ เนื้อขั้นนิรภัยประจำเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยและคนไข้ จำนวน ๒ ตัว
- ๑.๑๙ มีชุดหม้อแปลงไฟฟ้า (Inverter) จากไฟฟ้ากระแสตรง ๑๒ V. เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ V.
ให้ค่าสัมภาระไฟฟ้าต่อเนื่อง ๑,๐๐๐ วัตต์ และสามารถทนต่อการเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้า อย่างฉับพลัน ๒,๐๐๐ วัตต์✓



สถานที่ตั้ง

(นางภัครกนก ทองใบ)

- มีระบบเตือนด้วยเสียง เมื่อกระแสไฟจากแบตเตอรี่ลดต่ำลงน้อยกว่า ๑๐.๕ โวลท์✓
- มีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อกระแสไฟจากแบตเตอรี่ลดต่ำลงน้อยกว่า ๙.๕ โวลท์ และมากกว่า ๒๐.๕ โวลท์✓
- ในห้องพยาบาลติดตั้งปั๊กเสียบไฟฟ้า ๒๒๐ V. จำนวน ๒ จุด ✓
- ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน CE และโรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑
- ผลิตภัณฑ์ LINKCHAMP รุ่น SN-1000

๑.๒๐ ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในห้องพยาบาลนิด LED

๑.๒๐.๑ โคมไฟ LED แบบดาวยาง จำนวน ๔ ดวง✓

๑.๒๐.๒ มีขนาดยาว ๖๑.๐ ซม. กว้าง ๓.๗ ซม. หนา ๑.๘ ซม.✓

๑.๒๐.๓ ให้ความสว่าง ๕๗๖ ลูเมนส์ กันกรязและแม่น้ำ/น้ำทะเล/น้ำขึ้นขัน/สัญญา้งานเลขที่ ๗๗/๒๐๒๒✓

๑.๒๐.๔ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับກลั่นรวมระเบนคุณภาพ E-mark มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ แผ่น

พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคายัง

๑.๒๐.๕ สัญญาณไฟที่เสนอผ่านการรับรองมาตรฐาน E-type approved โดยแนบเอกสาร
มาพร้อมในวันเสนอราคา✓ (ลงชื่อ) ผู้ดูแล/ผู้ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์ Labcraft รุ่น APOLLO ✓ (นางสาวอรอน เทียนทอง)

PRO-MEDIC (ลงชื่อ) ผู้ขาย/ผู้รับ
๑.๒๑ ติดตั้งวิทยุสื่อสารขนาดติดตั้งประจวบฯ ยี่ห้อ VHF/FM กำลังส่ง ๔๕๔ วัตต์ (ลงชื่อ) พยาน
บริษัท ผลิตภัณฑ์ ICOM รุ่น IC-F5123D (ลงชื่อ) พยาน

๑.๒๒ ติดไฟสปอร์ตไลท์ สำหรับส่องสว่างด้านข้าง - ขวา อย่างละ ๒ ดวง มีคุณสมบัติดังนี้

๑.๒๒.๑ เป็นหลอดแบบ LED จำนวน ๔ หลอด (ลงชื่อ) พยาน

๑.๒๒.๒ สามารถใช้กระแสไฟติดตั้งแต่ ๑๒ ถึง ๒๔ โวลท์✓ (ลงชื่อ) พยาน

๑.๒๒.๓ ให้ความสว่าง ๑,๔๐๐ ลูเมนส์✓

คณะกรรมการ e-bidding

๑.๒๒.๔ ใช้กระแสไฟ ๑๔.๔ วัตต์✓ (ลงชื่อ) ผู้อ้วนที่ ๕ ๗.๔.๒๐๑๔

๑.๒๒.๕ ผ่านมาตรฐานป้องกันน้ำและฝุ่นเข้า IPX7✓ (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

๑.๒๒.๖ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ECE R10✓ (ลงชื่อ) กรรมการ

ผลิตภัณฑ์ JULUEN รุ่น SL157 series✓ (ลงชื่อ) กรรมการ

PRO-MEDIC
บริษัท โปรเมดิคส์ จำกัด ๙๐๐ MEDIC LTD
สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอรอน เทียนทอง)

๑.๒๓ ติดตั้งปลั๊กชาร์จไฟในห้องพยาบาล ๑ ชุด

๑.๒๓.๑ ช่องเสียบชาร์จ USB จำนวน ๒ ช่อง จ่ายกระแสไฟ ๒.๔ แอมป์ และ ๓.๐ แอมป์

๑.๒๓.๒ ช่องเสียบชาร์จปลั๊กจุดบุหรี่ ๑๒ โวลท์

๑.๒๓.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน CE และโรงงานผู้ผลิตผ่านการรับรอง มาตรฐาน ISO ๘๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารใบวันเสนอรากา ผลิตภัณฑ์ YuJie Electronics รุ่น DS5-2022/3004

๑.๒๔ มีสวิทซ์ตั้งระบบไฟฟ้าห้องพยาบาล อยู่ในห้องคนขับเพื่อป้องกันการเปิดไฟทิ้งไว้โดยไม่ตั้งใจ ผลิตภัณฑ์ BEP Marine รุ่น 701

๑.๒๕ ติดตั้งสติกเกอร์แสดงชื่อหน่วยงาน, สติกเกอร์รายการสลับแบบสะท้อนแสงที่ภายนอกตัวรถ (๖๗๙๔) เพื่อความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติงานเวลากลางคืน ศูนย์หมายเหตุสัมภาระติดต่อทางโทรศัพท์ ๙๘๙๖ บริษัทฯ ยื่นเสนอ หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการของหน่วยงาน หน่วยงานจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ณ วันที่สัญญาแบบรายละเอียดประการดังนี้/ฯ ถ้าวันที่ ก.ย. ๒๕๖๔

๑.๒๖ ระบบบรรยายอากาศภายในห้องพยาบาล แบบ (ถังชุด) Way Flow โดยติดตั้งพัดลมตามอุปกรณ์ผู้ช่วย/ผู้ช่วยฯ จากการติดตั้งบนหลังคาเรือนและพัดลมดูดระบายอากาศออกมายังชั้นใต้ดิน (ที่อยู่ในห้อง) เพื่อ ระบายน้ำจากภาคตะวันตกและนำอากาศกลับมาในห้อง (ถังชุด) ๒๐ Airflow/Cycles/Hr. ผู้ชาย/ผู้รับเข้า พร้อมแบบผลการทดสอบโดยสามารถใช้มาตรฐาน ISO (มาตรฐานนี้จะต้องเรียกจากผู้ผลิต) ความสะอาดภายในห้องโดยเฉพาะ (ลงชื่อ) พยาน

๑.๒๗ อุปกรณ์และเครื่องมือครุภัณฑ์การแพทย์ช่วยให้ติดฉุกเฉินที่ได้ติดมีไว้รักษาบุคคลที่มีสุขภาพไม่ดี ยืดติดกับตัวถังรถได้อย่างมั่นคงแข็งแรงไม่หลุดง่ายขณะรถกำลังขับเคลื่อน (ลงชื่อ) พยาน

๒. คุณสมบัติทางเทคนิค

๒.๑ ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องดีเซลชนิด ๔ สูบ ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบ ๒,๘๕๕ ซีซี หรือขนาด ๑๒๐ กิโลวัตต์ และ ๑๖๓ แรงม้า คณะกรรมการ e-bidding

๒.๒ ระบบกันสะเทือน ด้านหน้าแบบแมคเฟอร์สันสตรัท (Macpherson Suspension) ตัวถังแบบแข็งแกร่ง ช้อนพร้อมโช๊คอัพ (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

๒.๓ ระบบพวงมาลัยแรคเอนด์พีเนี่ยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง จึงช่วยให้ควบคุมง่ายดี (ลงชื่อ) กรรมการ

๒.๔ ระบบห้ามล้อหน้าติดสก์เบรก ระบบห้ามล้อหลัง ติดสก์เบรก (ลงชื่อ) กรรมการ

๒.๕ ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท์ พร้อมทั้งอุปกรณ์และคอมไฟฟ้าประจำรถถังถ้วน

๒.๖ ยางล้อเป็นขนาดมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

ผลิตภัณฑ์ TOYOTA รุ่น ALL-NEW คอมมิวเตอร์หลังคาสูง MT



เจ้าหน้าที่ บุญเมตต์ ชาติตติ PROMEDIC CO., LTD.

สำเนาถูกต้อง

(นางกัครกมล ทองใบ)

๓. อุปกรณ์และครุภัณฑ์ประจำรถการแพทย์ลูกเลิศ

๓.๑ อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถพยาบาลที่มีใช้ทางการแพทย์

๓.๑.๑ ยางอะไหล่พร้อมกระดาษล้อ ตามขนาดมาตรฐาน

๑ ชุด

๓.๑.๒ แม่เร่งยกรถพร้อมตัวนั่งแบบมาตรฐานประจำรถของผู้ผลิต

๑ ชุด

๓.๑.๓ ประจำดอตล้อ

๑ อัน

๓.๑.๔ นำ้ำยาดับเพลิงประจำรถขนาด ๕ ปอนด์

๑ ชุด

ผลิตภัณฑ์ IMPERIAL

๓.๑.๕ เข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งคนขับและที่นั่งข้างคนขับตอนหน้า

๑ ชุด

๓.๑.๖ อุปกรณ์ที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (Catalog) และมาตรฐานของผู้ผลิต
หมวด (๗) คุณสมบัติของครุภัณฑ์การแพทย์และเงื่อนไขเฉพาะ

๑. ครุภัณฑ์การแพทย์

- ๑.๑ เตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเข็น ๑ เตียง มีระบบเบรกดังนี้
 ๑.๑.๑ ตัวเตียงและโครงทำจากโลหะปลอกสนิม มีความแข็งแรงทนทาน
 ๑.๑.๒ มีระบบป้องกันการกระดกของเตียง เมื่อผู้ป่วยนั่งบริเวณปลายเตียงส่วนหัวเดียง
 จะต้องมีความมั่นคง ไม่กระตก ล้ม
- เอกสารแบบชี้แจงขาย/สัญญาจ้างเลขที่ ๙๗ วันที่ ๒๕๕๘
 พวก..... แผ่นที่ ๑ ๙ ในจำนวน ๑๖ แผ่น
- ๑๙ ก.ย. ๖
- (นางขวัญเรือน เทียนทอง)

- ๑.๑.๓ แนะนำงตัวผู้ป่วยที่เจ้าหน้าที่อย่างดี พนักพิงหลังช่วยยกผู้ป่วยขึ้น - ลง สามารถ
 ปรับระดับได้อย่างต่อเนื่องได้ ๐ ถึง ๓๐ องศา (น้ำหนัก ๑๕๐ กก.) ผู้ขาย/ผู้รับซื้อ
 ๑.๑.๔ ห้องน้ำรถเข็นขึ้นรถพยาบาลได้ง่ายโดยเจ้าหน้าที่คนเดียว ขาต่ำงคานบานและคูกร่องแยก
 อิสระจากกัน มีด้านล่างคันบังคับล้อให้พับเก็บฐานต่ำลงด้วยระบบบลูส์ฟันช์ติดงพบ
 ขึ้นทีละขาก และเมื่อตึงเตียงลงจากล้อคู่ที่ลังและล้อคู่หน้าจะทำการอุ้งตัวโดยอัตโนมัติ
 (Automatic Loading Stretchers) พยาน
- ๑.๑.๕ ราบป้องกันผู้ป่วยตกเตียงทั้งสองข้างสามารถพับเก็บไปด้านล่างได้ โดยสามารถพับเก็บได้
 ๑.๑.๖ มีเบาะรองนอนตลอดความยาวของเตียงสามารถลดล้างทำความสะอาดได้ พรมสาย
 รัดผู้ป่วย ๒ เส้น
- ๑.๑.๗ ล้อรถเข็นมีขนาด ๑๘-๑๙ ซม. พร้อมระบบล็อคล้อหลัง ช่วยป้องกันเตียงไหลและมีล้อ
 สำหรับข่วยเข็นขึ้นรถพยาบาลอีก ๔ สล้อ
- ๑.๑.๘ น้ำหนักเตียงโดยประมาณ ๔๕ กิโลกรัม สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ ๑๗๐ กิโลกรัม
- ๑.๑.๙ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕
 และ ISO ๙๐๐๑ พัฒนาแบบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย
 คณะกรรมการ ๑๖/๒๕๕๘

เมื่อวันที่ - ๖ ก.ย. ๒๕๕๘

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกฤกษ์ ทองใบ)

๑.๓.๓๐ ผ่านการรับรองมาตรฐานการทดสอบการชนด้วยแรง ๑๐G ตามมาตรฐาน EN ๑๔๖๕ และ EN ๑๗๘๙ พร้อมแบบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย
ผลิตภัณฑ์ SPENCER รุ่น CARRERA XL

๑.๓ ชุดล็อกศีรษะกับแผ่นกระดาษรองหลังผู้ป่วย (Head Immobilizer) มีรายละเอียดดังนี้

๑.๓.๑ สามารถใช้ล็อกศีรษะผู้บาดเจ็บกับแผ่นกระดาษรองหลัง (Long Spinal Board) ได้อย่างมั่นคง โดยมีก้อนโฟมรูปทรงสี่เหลี่ยม ๒ ชิ้น สำหรับประกอบด้านข้างศีรษะผู้บาดเจ็บและมีฐานรองสำหรับยึดติดกับแผ่นกระดาษรองหลัง (Long Spinal Board).

๑.๓.๒ ตัวก้อนโฟมในข้อ ๑.๓.๑ ทำจากยางห่อหุ้นรูปเป็นชิ้นๆด้วยวัสดุพลาสติกที่ทนทาน ให้ของเหลวซึมผ่านเข้าไปทำให้เกิดความหมักเม็กลายในไฟฟ้าเพื่อผลิตลักษณะในห้องน้ำอย่างดี แผ่นกระดาษรองแบบบัดดี้แบบเดียบแบบติด (Velcro) สำหรับยึดติดกับตัวฐานด้านบนมีร่องยากร่อง ๒ ร่อง สำหรับป้องกันสายรัดหน้าผากและคางเลือดไปสู่ร่างกาย ๑๘/๗.๙ ก.ป. ๑๕๖

๑.๓.๓ ฐานรองในข้อ ๑.๓.๑ ผลิตจากพลาสติกพื้นสีขาวรัดสำหรับโดยรอบแผ่นกระดาษรองผู้ป่วย/ผู้รับจ้าง หลังอย่างมั่นคง และมีแผ่นหนาตามเดียบแบบบัดดี้ (ไขปลดชุดรีลย์ที่ยืนหยัด)

๑.๓.๔ มีสกรูรัด ๑๐ ชุดบนบัดดี้แบบเดียบเพื่อหัวผู้ดูแลทางเดินทางผู้ป่วยและคางผู้ป่วยคงตัวจากยางห่อหุ้น (ลงชื่อ) ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

๑.๓.๕ ผิววัสดุไม่ซึมซับของเหลวสูญญากาศถัง ๔ ชั้น ทำความสะอาดได้ทันที (ลงชื่อ) ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

๑.๓.๖ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ ฯ และ ISO ๔๐๐๑ พร้อมแบบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคา (ลงชื่อ) บริษัทพันธ์

ผลิตภัณฑ์ SPENCER รุ่น SUPER BLUE HP (ลงชื่อ) พยาน (นางกัครกุมล ทองใบ)

๑.๓ ชุดแผ่นรองหลังผู้ป่วย (Long Spinal Board) จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

๑.๓.๑ ทำด้วยพลาสติก ทนแรงกระแทก และสามารถกันน้ำได้

๑.๓.๒ มีช่องสำหรับสอดมือหรือหัวได้ทุกด้านโดยรอบ ๑๔ ช่อง มีแกนพลาสติกหล่อขึ้นเป็นชิ้นเดียวกับแผ่นกระดาษรองหลังเพื่อไว้สำหรับล็อกกับสายรัดตัวผู้ได้รับบาดเจ็บ ๘ แกน กลางแผ่นกระดาษรองมีช่อง ๔ ช่อง สำหรับใช้ล็อกสายรัดตัวผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นเด็ก

๑.๓.๓ ขนาดความยาว ๑๙๕ ซม. ความกว้างส่วนช่วงลำตัว ๔๐.๕ ซม. น้ำหนัก ๗ กก. ความสูงจากพื้นถึงช่องมือหัวแม่ของราบกับพื้นสูง ๔.๕ ซม. สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ ๑๕๐ กิโลกรัม

๑.๓.๔ สามารถทำ CPR ผู้ป่วยได้ทันที

๑.๓.๕ มีสายรัดผู้ป่วยที่ปรับขนาดและมีอุปกรณ์ล็อกได้ จำนวน ๓ เส้น สายรัดผู้ป่วย ผลิตภัณฑ์ PROMEDIC


คณานุรักษ์การ e-bidding

เมื่อวันที่..... - ๕ ก.ป. ๑๕๖

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

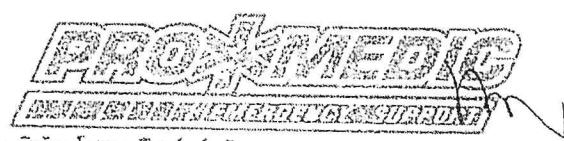

บริษัท พรอมเด็กส์ จำกัด PROMEDIC CO., LTD.

สำเนาถูกต้อง

(นางกัครกุมล ทองใบ)

- ๑.๓.๖ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และ ISO ๙๐๐๑ พร้อมแบบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย
ชุดแผ่นรองหลังผู้ป่วย ผลิตภัณฑ์ SPENCER รุ่น B-BAK PIN MAX
- ๑.๔ ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบ Manual Resuscitator บรรจุในกระเป๋าสำหรับพยาบาล Ambubag
- ๑.๔.๑ มีอุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจทางปาก (Oral Airway) จำนวน ๖ ขนาด พร้อมแท่งพลาสติกสำหรับกดลิ้น✓
- ๑.๔.๒ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และ ISO ๙๐๐๑ พร้อมแบบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย✓
สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๑ ชุด✓
- ๑.๔.๓ ถุงชีลิโคนชนิดขันเดียวทำด้วยยางชีลิโคน มีความยืดหยุ่น✓
- ๑.๔.๔ ตัวถุงชีลิโคนความจุ ๑๗๕ ซีซี พร้อมถุงไนโตรเจนออกไซด์ชนิดขันเดียว จำนวน ๑ ถุง เลขที่..... ๑๗๕/๑๗๕
- ๑.๔.๕ หน้ากากสำหรับผู้ใหญ่ เบอร์ ๓, ๔, ๕ พัฒนาโดยต่อห้องเชิงแขวนแขวนแบบ..... ในจำนวน ๑๖ แผ่น
สำหรับเด็ก จำนวน ๑ ชุด✓
- แบบรายละเอียดประกอบสัญญาซื้อ/ขาย ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๔
- ๑.๔.๖ ถุงชีลิโคนชนิดขันเดียวทำด้วยยางชีลิโคน มีความยืดหยุ่น✓ ๖
- ๑.๔.๗ ตัวถุงชีลิโคนความจุ ๖๓๕ มิลลิลิตร ๑ ชุด (พร้อมถุงไนโตรเจนออกไซด์ชนิดขันเดียว)
(Oxygen Reservoir Bag) ผู้ซื้อ/ผู้รับเจ้าของ
- ๑.๔.๘ หน้ากากแบบ..... ๒ พัฒนาโดยต่อห้องเชิงแขวนแขวนแบบ..... ๒ เมตร
สำหรับหัวรักษาชีว命ชีวิต (CPR) (ลงชื่อ) ๖๖๐๗ ผู้ขาย/ผู้รับเจ้าของ
- ๑.๔.๙ ถุงชีลิโคนชนิดขันเดียวทำด้วยยางชีลิโคน มีความยืดหยุ่น (ลงชื่อ) ๖๖๐๗ ผู้ขาย/ผู้รับเจ้าของ
- ๑.๔.๑๐ ตัวถุงชีลิโคนความจุ ๒๒๐ มิลลิลิตร ๑ ชุด (ปรับเปลี่ยนหัวสำหรับ Oxy-Reservoir Bag)
(นางสาววรรณ บุรีสพนธ์) พยาน
- ๑.๔.๑๑ หน้ากาก เบอร์ ๐ พัฒนาโดยต่อห้องเชิงแขวนแขวนแบบ..... ๒ เมตร
ผลิตภัณฑ์ Ambu® รุ่น Oval Plus (ลงชื่อ) พยาน
(นางภัครกุมล ทองใบ)
- ๑.๕ อุปกรณ์ดามหลังชนิดสัน (KED) สำหรับดามหลังผู้ได้รับบาดเจ็บที่ยังติดอยู่ในชาร์ก หรือใช้ดามกระดูกเชิงกรานผู้บาดเจ็บ ประกอบด้วยแท่งไม้เรียงกันเป็นแนวเชื่อมต่อกัน และหุ้มด้วยวัสดุพลาสติก (PVC) มีรูปทรงสอดคล้องกับร่างกายห่อนบนมีส่วนยื่นโอบรัดส่วนศีรษะและส่วนลำตัว มีรายละเอียดดังนี้
- ๑.๕.๑ ตัวฝีกมีความสูง ๘๓ ซม. กว้าง ๙๐ ซม./
- ๑.๕.๒ มีเข็มขัดรัดตัวผู้ป่วย ๓ เส้น แต่ละเส้นมีสีแตกต่างกัน และมีสายรัดใต้ขา ๒ เส้น✓
- ๑.๕.๓ บริเวณศีรษะมีหนามเตย สามารถติดสายรัดหน้าผากและคงของผู้บาดเจ็บให้ยึดติดกับตัวฝีกได้✓
- คณาจารย์การดูดดึง
- เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๔
- ลงชื่อ ประยานกรนกการ
- ลงชื่อ กรรมการ
- ลงชื่อ ผู้รับ
- สำเนาถูกต้อง
- (นางภัครกุมล ทองใบ)
- บริษัท ปอร์เมนิกส์ จำกัด
PROMENIC CO., LTD.

๑.๕.๔ มีหมอนสำหรับรองหังศีรษะในการนี้เหลืออย่างว่าง✓

๑.๕.๕ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และ ISO ๙๐๐๑ พร้อมแบบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย✓
ผลิตภัณฑ์ SPENCER รุ่น SED

๑.๖ เครื่องดูดของเหลว (Suction Pump) จำนวน ๑ เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

๑.๖.๑ ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๑๒ โวลท์ และกระแสสัมภับ ๒๒๐ โวลท์ และมีแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ภายในตัวเครื่อง น้ำหนักเบาสามารถถือยกได้✓

๑.๖.๒ มีปั๊มควบคุมแรงดูด พร้อมมาตรฐานวัดแสดงแรงดูด✓

๑.๖.๓ สามารถปรับแรงดูดสูงสุดได้ ๐.๘ บาร์ และอัตราการปั๊มน้ำออกต่อนาที

๑.๖.๔ ภาชนะบรรจุของเหลวมีขนาดปริมาตร ๔๐๐ มล. และต้องมีความสะอาดและไม่มีเชื้อรา ใช้ช้าใหม่ได้✓

๑.๖.๕ มีสายดูด (Suction Tubing)✓

๑.๖.๖ แบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องเป็นแบบที่สามารถทำการชาร์จไฟได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ไฟหมดโดยเมื่อแบตเตอรี่เต็มสามารถใช้งานได้ (๔๘๘ ก้อน) ผู้ซื้อ/ผู้รับผิดชอบฯ ๑ ก้อน/๔๘๘ ก้อน

๑.๖.๗ ข่ายด้เครื่องดูดเสมหะกับตัวรถ มีระบบชาร์จไฟอัตโนมัติในตัว เช่นเดียวกับเครื่องดูดของเหลวในวันเสนอราคาด้วย✓

๑.๖.๘ ปฏิเสธตัดต่อกันออกจากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ พร้อมแบบผู้ขาย/ผู้รับผิดชอบฯ เอกสารหลักฐานเนื้อหาเดียวกับวันเสนอราคาด้วย✓ (๔๘๘ ก้อน/๔๘๘ ก้อน)

๑.๖.๙ ปฏิเสธตัดต่อกันออกจากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ พยาน และ ISO ๙๐๐๑ พร้อมแบบเอกสารหลักฐานในวันเสนอของผู้ผลิต (บริษัทวีรุรุณ บุรีสพันธ์)

ผลิตภัณฑ์ WEINMANN รุ่น ACCUVAC (๔๘๘ ก้อน) พยาน (นางภัครกฤษ ห่องใบ)

๑.๗ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดฝาผนัง จำนวน ๑ เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

๑.๗.๑ เป็นแบบ Wall Aneroid ติดตั้งยึดกับผนังรถพยาบาล✓

๑.๗.๒ สามารถวัดความดันโลหิตได้จาก ๐ - ๓๐๐ มิลลิเมตรปรอท โดยขีดแสดงตัวเลข ๘๐ - ๑๖๐ มีสีแท่งต่างเด่นชัดจากตัวเลขอื่น✓

๑.๗.๓ มีผ้าพันแขนเป็นชนิดประดิ (Velcro Fastener)✓

๑.๗.๔ สายยางต่อจากผ้าพันแขนเป็นแบบ Coiled Tubing มีความยาว ๘ ฟุต✓

๑.๗.๕ ลูกยางสำหรับอัดลมผ้าพันแขน พร้อมลิ้นปิด - เปิด สะดวกต่อการควบคุม✓

คณะกรรมการ e-bidding

เมื่อวันที่..... ๖ ก.ย. ๒๕๖๔

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ



สำเนาถูกต้อง

(นางภัครกฤษ ห่องใบ)

- ๑.๗.๖ ข่าย์ตเครื่องวัดความดันกับตัวรถผลิตจากวัสดุอุบมิเนียม แข็งแรงผ่านการรับรอง มาตรฐานการทดสอบการชนด้วยแรง ๑๐G ตามมาตรฐาน EN ๑๔๒๕ และ EN ๑๗๘๙ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย✓
- ๑.๗.๗ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และ ISO ๔๕๐๑ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย✓
คุ้มครองในเว็บไซต์สูญเสียหัวใจ/สัญญาจ้างเลขที่ ๙๗/๖๔๒๔
ผลิตภัณฑ์ SPENCER รุ่น VISO BUMPER แผ่นที่ ๖ แผ่นที่ ๑๐ ในจำนวน ๑๖ แผ่น
- ๑.๘ หูฟัง (Stethoscope) จำนวน ๑ ชุด
 ๑.๘.๑ หูฟังสามารถฟังได้ทั้งสองด้าน โดยวิธีหมุนเพียงครึ่งรอบก็จะเปลี่ยนหัวฟังไปอีกหัวได้แล้ว ผู้เชื้อ/ผู้รับเข้ามา (นางสาวเร่อน เทียนทอง)
 ๑.๘.๒ หูฟัง (Chest Piece) ทำจากโลหะไวรัสนิมประกอบเป็น ๒ ด้าน ด้าน Bell มียางหุ้ม เครื่องยนต์เพื่อไม่ให้เกิดความเย็นเกินไปเมื่อพกพาคนไข้และศัลป์ฯ ออกห้องผ่าตัด.....ผู้ชาย/ผู้รับเข้ามา
- ๑.๘.๓ คานาฟฟ์สำหรับอากาศยาน Aerospace Alloy น้ำหนักเบา (น้ำหนักตัว ๑.๕ กก.)
- ๑.๘.๔ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ พยาน และ ISO ๔๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย✓
ผลิตภัณฑ์ SPENCER รุ่น DGX 602 (ลงชื่อ) พยาน (นางกัครกมล ทองใบ)
- ๑.๙ เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดเข็นได้สามารถพับเก็บได้สะดวก (Stair Chair) มีรายละเอียดดังนี้
 ๑.๙.๑ เป็นเก้าอี้โครงสร้างอุบมิเนียมแบบมีพนักพิง สามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน ส่วนที่รองรับผู้ป่วยเป็นผ้าใบอย่างดี สามารถถอดทำความสะอาดได้✓
- ๑.๙.๒ มีล้อสำหรับเข็น จำนวน ๔ ล้อ โดยสองล้อหน้าสามารถล็อกป้องกันล้อหมุนได้✓
- ๑.๙.๓ มีมือจับยกด้านหลังพนักพิง ๒ จุด และด้านหน้าเก้าอี้บริเวณเท้าผู้ป่วยมีแกรนเมื่อจับแบบซักยึดความยืดได้ ๒ จุด✓
- ๑.๙.๔ น้ำหนักรวม ๕.๕ กก. สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ ๑๕๐ กก✓
- ๑.๙.๕ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และ ISO ๔๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย✓
- ๑.๙.๖ ชุดฐานยืดเก้าอี้ผ่านการรับรองมาตรฐานการทดสอบการชนด้วยแรง ๑๐G ตามมาตรฐาน EN ๑๔๒๕-๑ EN ๑๗๘๙ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย✓
ผลิตภัณฑ์ SPENCER รุ่น 4BELL Silver✓

คณะกรรมการ e-bidding

เมื่อวันที่ - ๕ ก.ย. ๒๕๖๕
 ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..... ผู้จัดการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ



สำเนาถูกต้อง

(นางกัครกมล ทองใบ)

๑.๓๐ ชุดเฟือกลม (Vacuum Splint Set) จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

๑.๓๐.๑ เป็นเฟือกแบบไข้ระบบสุญญากาศ โดยใช้การสูบลมออกเพื่อให้เฟือกแข็งตัว

๑.๓๐.๒ มีสายรัด เพื่อรัดให้เกิดความกระชับกับอวัยวะผู้บาดเจ็บ สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

๑.๓๐.๓ ระบบมีว่าล์วเปิด - ปิด อากาศเข้า - ออก /

๑.๓๐.๔ แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้ (Transparent) /


๑.๓๐.๕ ในแต่ละชุดประกอบด้วยเฟือกขนาดเล็ก - ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

๑.๓๐.๖ มีที่สูบลมทำจากวัสดุ Aluminunum มีสำหรับผู้ที่มีข้อเสื่อมทางประสาทศีรษะและขากรรไห์ที่ ๗๙ | ๒๕๕๖
เดียวกับตัวเฟือก ผู้ช่วย.....๙๙ ในจำนวน ๑๒ แผ่น

๑.๓๐.๗ ตัวเฟือกขนาดเล็กมีลักษณะเป็นรูปตัว T เพื่อมาตรฐานนี้จะให้สำหรับเมืองไทยทั้งหมด ๗๙ ก.ย.

ตามข้อศอกหรือข้อเท้าหรือข้อมือ /

๑.๓๐.๘ ภายในเฟือกขนาดกลางและขนาดใหญ่ (ลงชื่อ)๗๙ แบบภาษาไทยจีนเรียบภาษาไทยหนังซอง ผู้ชื่อ/ผู้รับช้า

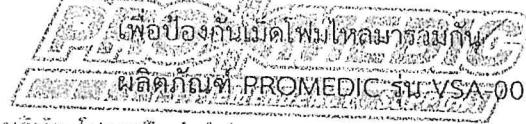

เพื่อป้องกันเม็ดไฟในกรณีการเผาไหม้

ผลิตภัณฑ์ PROMEDIC รุ่น VS-A-003 (ลงชื่อ)๗๙ ก.ย.

บริษัท ไพรเมดิกส์ จำกัด PROMEDIC CO., LTD.

(๑๑๙.๗๙.๗๙.๑๔.๙๙.)

ผู้ขาย/ผู้รับช้า

๑.๓๑ ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน (Cervical Collar) จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้ พยาน

๑.๓๑.๑ โครงกายนอกเป็นพลาสติก ส่วนภายในเป็นโฟมอ่อน (นางสาววรรณ บุริสพันธ์)

๑.๓๑.๒ ประกอบติดกัน โดยสายรัดแบบประติด (สายรัด) / พยาน

๑.๓๑.๓ ส่วนหน้ามีช่องสำหรับการเจาะหลอดลม (นางสาวกฤณล ทองใบ)

๑.๓๑.๔ ใน ๑ ชุด ประกอบด้วย ผู้ใหญ่ ๒ ชิ้น เด็ก ๒ ชิ้น

๑.๓๑.๕ มีกระเบ้าผ้าในคอนอย่างดี จำนวน ๑ ใบ สำหรับใส่อุปกรณ์ทั้งหมด /

๑.๓๑.๖ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และ ISO ๙๐๐๑ พร้อมแบบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย

ผลิตภัณฑ์ Ambu® รุ่น Perfit ACE™

๑.๓๒ กระเบ้าพยาบาลชนิดสะพายพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลบาดแผล ห้ามเลือด ตามกระดูก ตัวกระเบ้ามีน้ำหนักเบา สามารถหัวหรือสะพายเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เมื่อเปิด ออกมีการแบ่งช่องชั้นที่บรรจุของต่างๆ อย่างชัดเจน อุปกรณ์พยาบาลต้านในบรรจุในถุงที่สามารถหยิบใช้งานได้สะดวก

ผลิตภัณฑ์ AEROcase®

คุณสมบัติการ Anti-bleeding

- ๖ ก.ป. ๒๕๕๖

เมื่อวันที่.....

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ



บริษัท ไพรเมดิกส์ จำกัด PROMEDIC CO., LTD.

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกฤณล ทองใบ)

๑.๓๓ เครื่องส่องกล่องเสียง (Laryngoscope) จำนวน ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ตั้งต่อไปนี้

๑.๓๓.๑ หลอดไฟเป็นแบบ LED ตัวมีอพาร์ทเม้นส่องตรวจ✓

๑.๓๓.๒ แผ่นส่องตรวจ (Blade) จำนวน ๓ ขนาด✓

๑.๓๓.๓ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕

และ ISO ๘๐๐๑ พร้อมแบบเอกสารหลักฐานในวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลิตภัณฑ์ SPENCER รุ่น Laryngoscope Fibre Optic แผ่นที่ ๑๗ ในจำนวน ๑๖ แผ่น

๑.๓๔ เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ

แบบร้าบต้องดูแลอย่างระมัดระวัง ๑๘๗/๑๘๘ ๑๗๗ ก.ย. ๒๕๖๔

เป็นเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ มีขนาดกะทัดรัด (เล็กมาก) สำหรับการใช้งานลำเลียงผู้ป่วย หรือ

ใช้ในการฉีกเฉินโดยสามารถปรับตั้งอัตราการหายใจและปรับอัตราความชื้นให้เหมาะสมกับผู้ป่วย

เข้าออกได้ผลลัพธ์ดีรับมาตรฐาน

(ลงชื่อ) ๗๔๐๑ ผู้ขาย/ผู้รับซื้อ

๑.๓๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง

(๑๖๘๘๗ ๑๗๗๘๔)

๑.๓๔.๑.๑ เครื่องช่วยหายใจทำงานด้วยระบบผสมของ Pneumatic หรือ

Electronic Control (นางสาววรรณ บุรีสพันธ์) พยาน

๑.๓๔.๑.๒ เป็นเครื่องช่วยหายใจที่สามารถรับและควบคุมปริมาณอากาศในการหายใจ เข้า-ออก (Tidal Volume) ได้ (นางภัครกมล ทองใบ) พยาน

๑.๓๔.๑.๓ สามารถตั้งอัตราการหายใจของผู้ป่วยได้ในช่วง ๕-๓๐ ครั้งต่อนาที✓

๑.๓๔.๑.๔ สามารถกำหนดเวลาในการหายใจเข้า สำหรับเด็ก หรือ สำหรับผู้ใหญ่ ได้เพื่อความสะดวกในการใช้งาน✓

๑.๓๔.๑.๕ มีระบบสัญญาณเตือนเมื่อมีการทำงานผิดปกติ✓

๑.๓๔.๑.๖ เครื่องใช้พลังงานจากแบตเตอรี่✓

๑.๓๔.๑.๗ มีสวิทซ์เปิด-ปิด ปุ่มการตั้งปริมาตรอากาศหรือสวิทซ์ตั้งอัตราการหายใจอยู่ด้านหน้าเครื่อง มองเห็นได้อย่างชัดเจน✓

๑.๓๔.๑.๘ ขอแสดงผลในภาคการแสดงอัตราการหายใจหรือค่าแรงดันภายในทางเดินหายใจ (Airway Pressure),✓

๑.๓๔.๒ อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน

จำนวน ๑ เครื่อง✓

๑.๓๔.๒.๑ เครื่องช่วยหายใจแบบอัตโนมัติ

จำนวน ๑ เส้น✓

๑.๓๔.๒.๒ สายห่อออกซิเจนชนิด Disposable


จำนวน ๑ ชุด✓

๑.๓๔.๒.๓ วัลว์ใช้สำหรับกับเครื่องช่วยหายใจ

จำนวน ๑ อัน✓

๑.๓๔.๒.๔ หน้ากากช่วยหายใจ

คณการรบการ e-bidding ผลิตภัณฑ์ Allied รุ่น EPV200

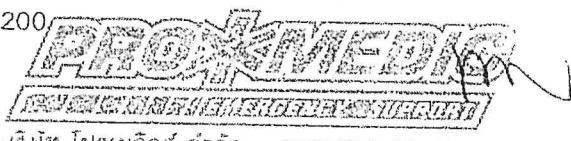

เมื่อวันที่..... - ๖ ก.ย. ๒๕๖๔

ลงชื่อ..... ประธนากรรมาทร

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

.....
(นางภัครกมล ทองใบ)

๑.๑๕ เครื่องกระตุกหัวใจ

มีคุณสมบัติที่สำคัญ

๑. เป็นเครื่องกระตุกหัวใจแบบพกพา

๒. มีสีสันสะกดตา มองเห็นได้ชัดเจน ทำให้สะดวกต่อการพบเห็น

๓. สามารถใช้งานร่วมกับ Batteries ชนิด **(๑๗๓A Photo Flash Lithium Manganese Dioxide)**

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้างเลขที่ ๙๖/๒๕๓๘
 ผู้ขาย..... ผู้ซื้อ..... แผ่นที่ ๑/๑ ในจำนวน ๑๒ แผ่น

๔. น้ำหนักของตัวเครื่อง ๗๐ กิโลกรัม

๕. สามารถแนะนำการใช้งานให้กับผู้ใช้ทั้งแบบเสียงพูดข้อความและรูปคลิปวิดีโอ

คุณสมบัติทางเทคนิค

๖. ใช้รูปคลื่นในการกระตุกหัวใจ Rectilinear Biphasic (ลงชื่อ) (นางสาวรุ่งเรือง เทียนทอง)

๗. สามารถประจุไฟฟ้าแบบบอร์ดเน็ต เมื่อพบร่องรอยความผิดปกติที่ต้องการการกระตุกหัวใจ และสามารถตรวจสอบการทำงานของไฟฟ้าในตัวเครื่อง (ลงชื่อ) ผู้ขาย/ผู้รับซื้อ

๘. สัมภาระเปลี่ยนร่องดับพลังงานได้เองโดยอัตโนมัติ โดยมีพลังงานสูงสุดที่ ๒๐๐ Joule Biphasic

๙. สามารถประจุไฟฟ้าไปยังระดับพลังงานที่เครื่องเสียหายได้ (ลงชื่อ) พยาน

๑๐. สามารถใช้งานร่วมกับแผ่นนำไฟฟ้าแบบใช้ครั้งเดียวได้ และแผ่นนำไฟฟ้ามีอายุการเก็บ

รักษาได้นาน ๕ ปี (ลงชื่อ) (๑๑) พยาน

๑๑. แผ่นนำไฟฟ้าที่ใช้กับตัวเครื่อง สามารถติดตามสภาพการทำงาน CPR ของผู้ช่วยเหลือและสามารถรายงานผลทั้งในรูปแบบเสียงพูด ข้อความและสัญลักษณ์บนหน้าจอ

๑๒. ตัวเครื่องสามารถตรวจสอบระบบการทำงานของตัวเครื่องได้ด้วยตัวเองในขณะที่เริ่มเปิดเครื่อง และแสดงความพร้อมของตัวเครื่องด้วยสัญลักษณ์

๑๓. Battery ที่ใช้กับตัวเครื่องมีอายุการใช้งาน ๕ ปี หรือสามารถการกระตุกหัวใจได้ ๒๒๕ ครั้ง หรือสามารถทำการติดตามการทำงานของหัวใจผู้ป่วยได้ ๑๓ ชั่วโมง

๑๔. ตัวเครื่องมีหน้าจอ LCD

๑๕. ตัวเครื่องผ่านการทดสอบทาง MIL Std. ๔๑๐F, Min. Helicopter Test อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๑๖. แผ่นนำไฟฟ้าแบบมี CPR SENSOR

จำนวน ๑ ชุด

๑๗. แบตเตอรี่แบบ **(๑๗๓A Photo Flash Lithium Manganese Dioxide)**

จำนวน ๑๐ ก้อน

๑๘. กระแสไฟฟ้าสำหรับใส่ตัวเครื่อง

จำนวน ๑ ใบ

ผลิตภัณฑ์ ZOLL รุ่น AED Plus®

คณะกรรมการ bidding

๘ ก.ย. ๒๕๖๗

เมื่อวันที่..... ประจำกรรมการ

ลงชื่อ..... ประจำกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ



สำเนาถูกต้อง

(นางกัครกุล ทองใบ)

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ ตัวรถบริษัทผู้ผลิตต้องรับประกันคุณภาพในระยะเวลา ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กม. สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในการณ์ใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่มีคิดมูลค่า เว้นแต่เกิดกรณีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ
- ๔.๒ การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาระยะยาวในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร
- ๔.๓ โรงงานผู้ตอกแต่ง ตัดแปลงรถพยาบาลจะต้องมีมาตรฐานและขั้นทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้ โดยต้องแนบสำเนาเอกสารใบอนุญาตมาพร้อมใบเสนอราคา
- ๔.๓.๑ โรงงานผู้ตอกแต่งรถพยาบาลต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมสรรพาณิช พร้อมทั้งแสดงใบอนุญาตฯ ที่ออกโดยหน่วยทักษิณฯ จังหวัดที่..... ๙๗/๒๖๔
- ๔.๔ รับประกันอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมทั้งหมดภายในรถพยาบาลเป็นครั้งเดียว ในจำนวน ๑๖ แผ่น
- ๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องยื่นรูปแบบหรือแคตตาล็อกห้ารูปแบบและส่งมอบคุณภาพตามที่ตกลงไว้กับ ก.ย. ๔๘ สำหรับตัวรถ และอุปกรณ์ตามท้ายนี้
- ๔.๕.๑ ไฟฉุกเฉิน (ลงชื่อ) ผู้ขอ/ผู้รับจ้าง
(นางสาวเรือน เพียงทอง)
- ๔.๕.๒ ชุดใช้เรนเครื่องขยายเสียง (ลงชื่อ) ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(นายชัยวุฒิ พานิช)
- ๔.๕.๓ เทียบเชิงผู้ป่วย (ลงชื่อ) ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(นายชัยวุฒิ พานิช)
- ๔.๕.๔ ชุดแพทย์ของห้องผู้ป่วย (ลงชื่อ) ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(นายชัยวุฒิ พานิช)
- ๔.๕.๕ อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมือเป็น (ลงชื่อ) พยาน
(นางสาววรรณ บุรีสพันธ์)
- ๔.๕.๖ หูฟัง (ลงชื่อ) พยาน
(นางภัครกุมล ทองใบ)
- ๔.๕.๗ เครื่องวัดความดันโลหิต (ลงชื่อ) พยาน
- ๔.๕.๘ ชุดฝึกอบรม (ลงชื่อ) กรรมการ
- ๔.๕.๙ ชุดป้องกันกระดูก colloclion (ลงชื่อ) คณะกรรมการ e-bidding
- ๔.๕.๑๐ เครื่องดูดเสมหะ (ลงชื่อ) ผู้อ้วนที่..... -๔ ก.ย. ๒๕๖๔ ประธานกรรมการ
- ๔.๕.๑๑ อุปกรณ์ดามหลังชนิดสัน (KED) (ลงชื่อ) กรรมการ
- ๔.๕.๑๒ เครื่องส่องกล้องส่องเดียง (ลงชื่อ) กรรมการ
- ๔.๕.๑๓ เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ (ลงชื่อ) กรรมการ
- ๔.๕.๑๔ เครื่องกระตุกหัวใจ (ลงชื่อ) กรรมการ
- ๔.๕.๑๕ รถยนต์
- ๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ตอกแต่งรถพยาบาลในข้อ ๔.๓ ให้เป็นตัวแทนยื่นเสนอราคา โดยมีหนังสือยืนยันยื่นมาพร้อมใบเสนอราคา



(นางวัชริกา ทองใบ)

๔.๗ หากคณะกรรมการฯ ประสงค์ขอศูนย์ค้าตัวอย่างของรายการอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และ อุปกรณ์ดิตตี้ตั้งประจำพยาบาล ผู้เสนอราคาต้องนำส่งศูนย์ค้ารายการที่คณะกรรมการร้องขอ ภายใน ๓ วันทำการ✓

๔.๘ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารยืนยันการสำรองของให้จากโรงงานผู้ผลิตในการซ่อมบำรุงและ อุปกรณ์สิ้นเปลืองเป็นเวลา ๕ ปี นับจากวันส่งศูนย์ค้า ของเครื่องมือแพทย์ตามรายการดังนี้ เตียงเข็ม ผู้ป่วย เก้าอี้เด็กน้อยผู้ป่วย เครื่องดูดเสมหะ เครื่องกระดูกหัวใจ✓

๔.๙ ครุภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องเป็นของใหม่ไม่เป็นของเก่าเก็บไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่น ที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน✓

เอกสารแนบท้ายทั้งสัญญาซื้อขาย/สัญญาซื้อ-ขายที่ ๑๗/๒๕๖๔
ผู้เสนอ..... ๑๕ แผ่นที่ ๑๕ ในจำนวน ๐๖ แผ่น

แบบรายละเอียดประกอบสัญญาซื้อ/ขาย ลงวันที่ ๖ ก.ย. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ/ผู้รับจำนำ
(นางชัยเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ) ผู้ขาย/ผู้รับจำนำ

(ลงชื่อ) พยาน
(นางนวีวรรณ บุรีสพันธ์)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางภัครกนล ทองใบ)


คณะกรรมการ e-bidding

เมื่อวันที่ ๖ ก.ย. ๒๕๖๔

ลงชื่อ ประธานกรรมการ


ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

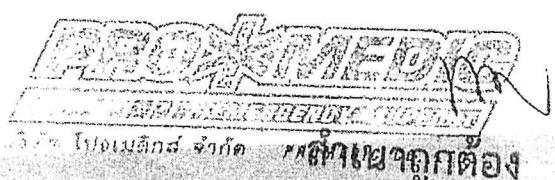

๑๑
(นางภัครกนล ทองใบ)

PRO-MEDIC
บริษัท โปรเมดิค จำกัด

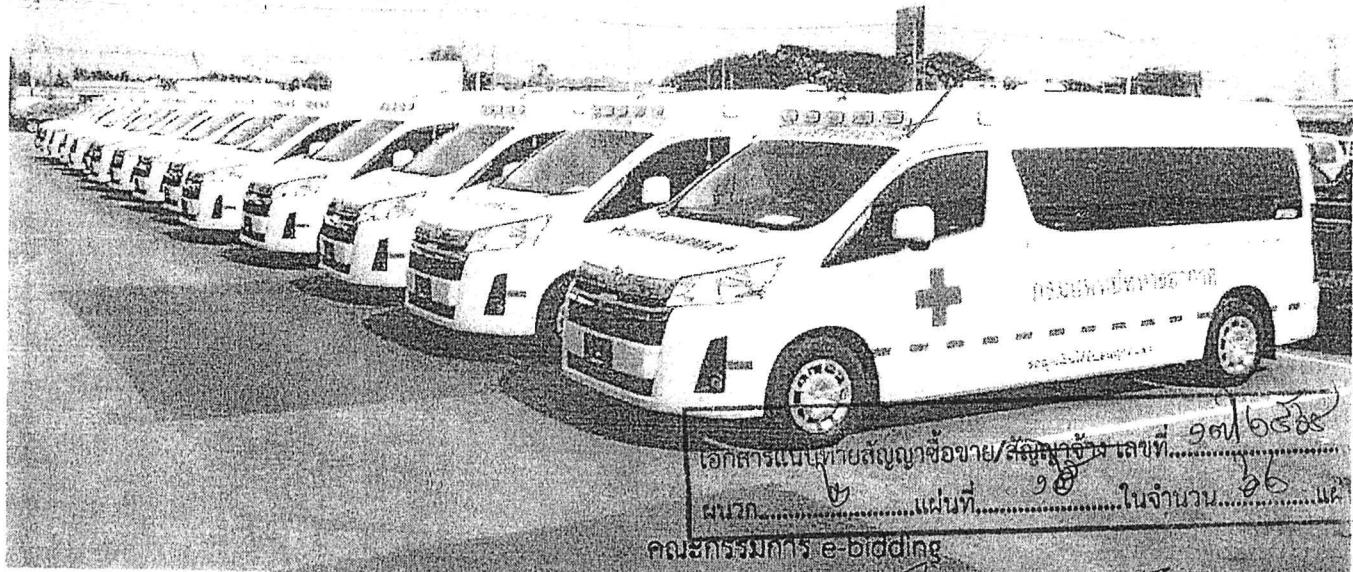

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัมภาระเลขที่..... ๑๗/๖๘๕
ผู้ร่วม..... แผ่นที่..... ๙๓ ในจำนวน ๖๖ แผ่น

โดยกรรมการบริหาร

เมื่อวันที่..... ๔ กันยายน๒๕๖๘ บริษัทฯ จ.ก.ย. ๖๘


ลงชื่อ..... (ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ..... ผู้จัด/ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ..... (ลงชื่อ)..... (นายพานิชเรือง เทียนนาคร)
ลงชื่อ..... (ลงชื่อ)..... (นายวิวัฒน์ วงศ์วนิช)..... ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ)..... (นายพันธุ์รุ่ง วงศ์วนิช)..... พยาน
(ลงชื่อ)..... (นายวิวัฒน์ วงศ์วนิช)..... พยาน




บริษัท โปรเมดิค จำกัด ๑๗๘๕

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกฤกล ทองใบ)

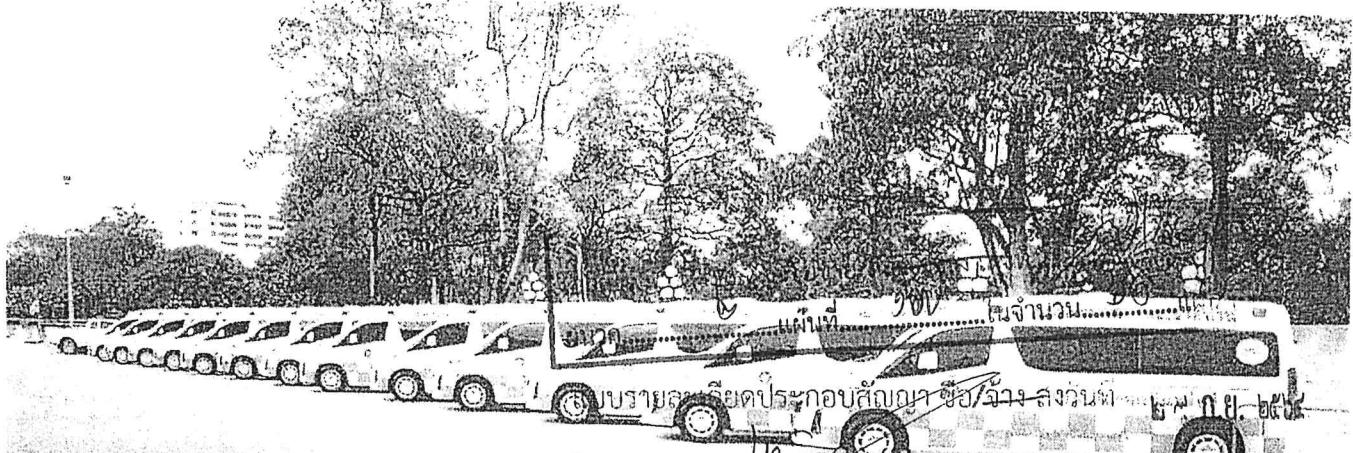

(ลงชื่อ) ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(นางสาวณัฐเรือน เทียนทอง)

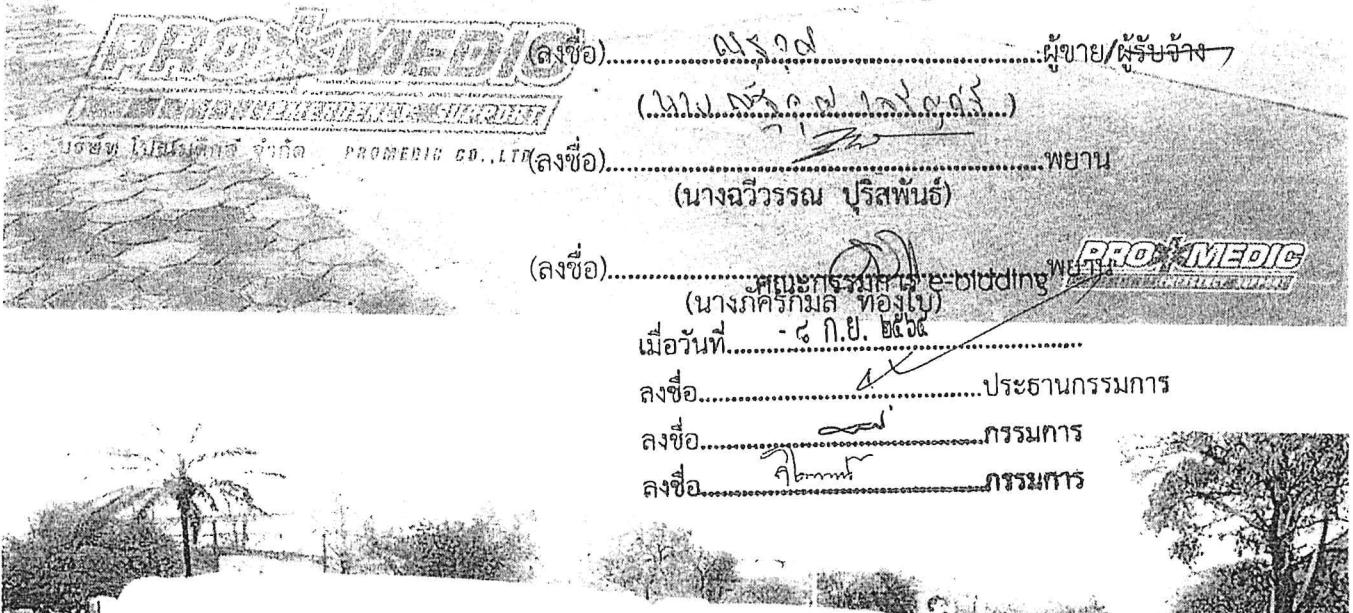

(ลงชื่อ) ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(นาย พันธุ์ศักดิ์ ใจดี)
บรษท ไพรเมดิค จำกัด PROMEDIC CO., LTD
(ลงชื่อ) พยาบาล
(นางสาววรรณ บุรีสพันธ์)

(ลงชื่อ) พยาบาล
(นางสาวกานต์ ทองใบ)
เมื่อวันที่ - ๘ ก.ย. ๒๕๖๓
ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ



PROMEDIC
บริษัท ไพรเมดิค จำกัด PROMEDIC CO., LTD.

PROMEDIC

สำเนาถูกต้อง[✓]
(นางกานต์ ทองใบ)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์



แบบฟอร์มการซื้อขายของทางราชการ


๑๙ ก.ย. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ขาย/ผู้รับซื้อ
(นางสาวณัฐเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ) ๐๘๙๗๑ ผู้ขาย/ผู้รับซื้อ

(ลงชื่อ) (นางสาววรรณ บุริสพันธ์)
..... พยาน

(ลงชื่อ) (นางภัครกุมล ทองใบ)
..... พยาน

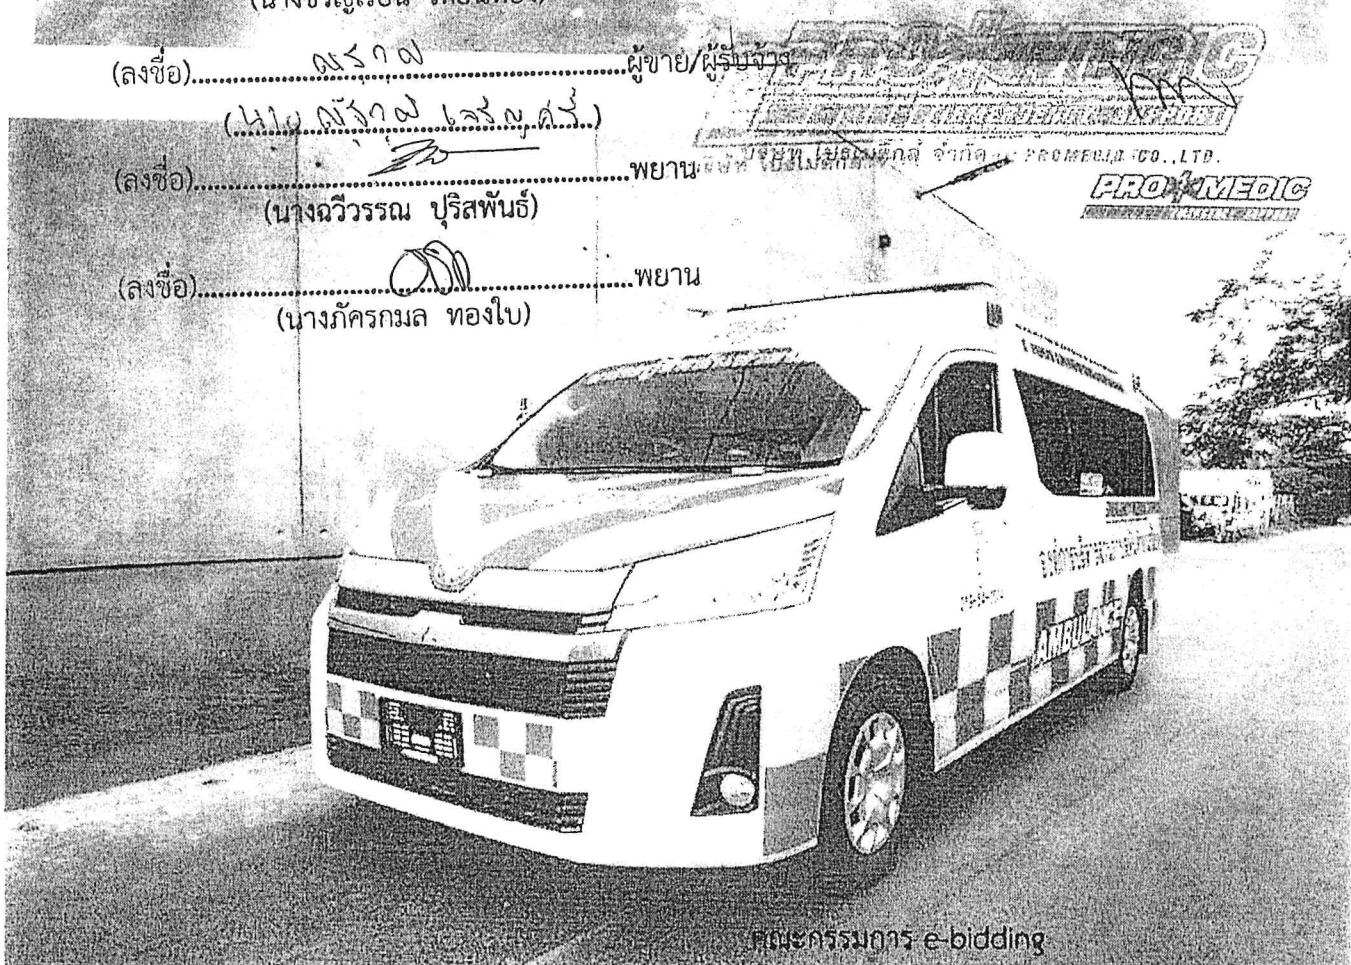

คณะกรรมการ e-bidding

เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๔

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นางภัครกุมล ทองใบ)

PRO-MEDIC

เอกสาร.....
ผู้รับ.....
แบบขอซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ดินตั้นหยา ชือจังหวันที่ ๑๔๗/๑๙๓
(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ/ผู้

(ลงชื่อ) ก.ก.ก.

(๖๖๘ บ้านท่าทราย ๑๒๓๔๕)

(ลงชื่อ) อ.พ.ย. พ.ย. ๘๘
(นายนวารรรณ ปริสพนธ์)

(ลงชื่อ) พ.ย. ๘๘
(นางภัครกุล ทองใบ)

PRO-MEDIC

กระบวนการ e-bidding

เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๒

ลงชื่อ ประธานกรรมการ


ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

คู่เนื้อหาต้อง

คู่ คู่

(นางภัครกุล ทองใบ)

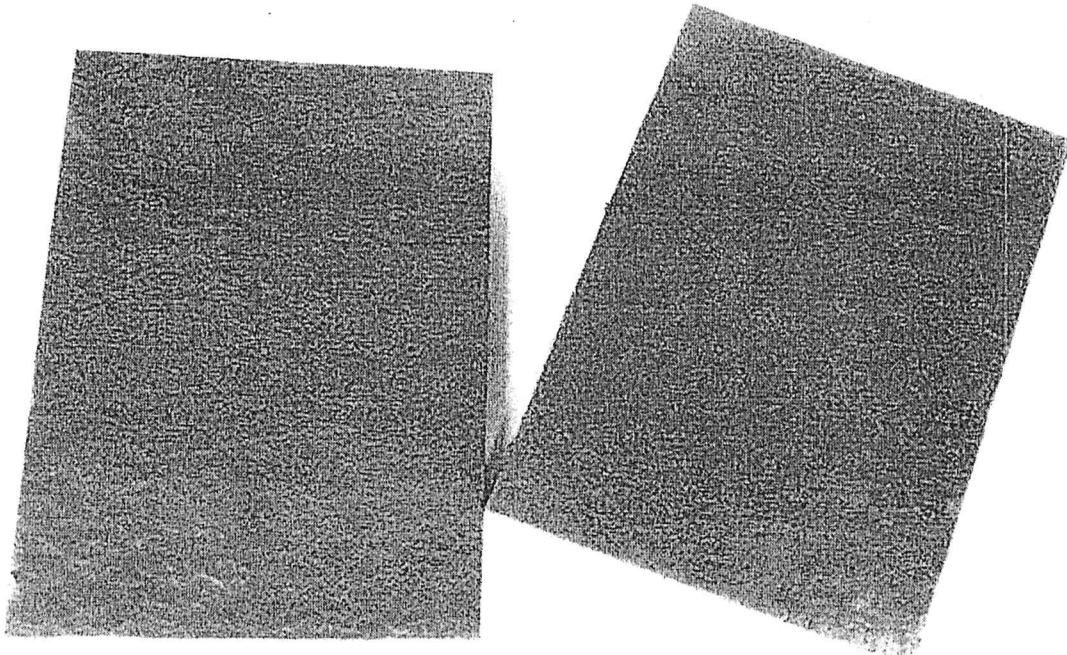

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัมภาระ เลขที่... กทว/๑๖๗๙
แผ่นที่... ๓๖ ในจำนวน... ๓๖ แผ่น

ประกอบปฏิบัติ ๑๗๙/๒๕๖๘ วันที่ ๙ ก.ย.

ผู้ซื้อ/ผู้รับค้า
(นางชวัญเรือน เพียงทอง)

ผู้ขาย/ผู้รับค้า
(ห้าง กทว กทว ใจดี)

พยาน
(นางฉวีวรรณ บุรีสันธ์)

พยาน
(นางกัครกนถ ทองใบ)

๑.๖ พลาสติกแผ่นเรียบเสริมแรง

(ลงชื่อ) พยาน

Fiber Reinforced Plastic (FRP) หนา 8 มิลลิเมตร

สำหรับใช้ปูพื้นภายในรถพยาบาล ให้ความแข็งแรงสูง

คณะกรรมการ e-bidding

เมื่อวันที่..... ๙ ก.ย. ๖๘๙๘

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

สำเนาถูกต้อง




.....
(นางกัครกนถ ทองใบ)



บริษัท ไพรเมเน็ติกส์ จำกัด PROMETHEUS CO., LTD.

คณะกรรมการ e-bidding

เมื่อวันที่..... ๖ ก.ย. ๒๕๖๖
 ลงชื่อ..... ประ不然กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ

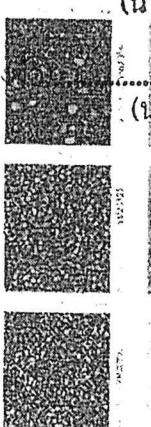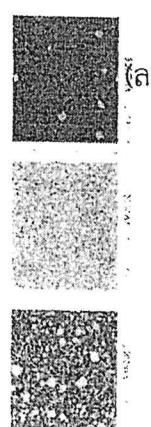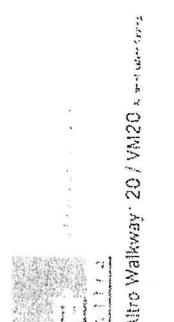

ก่อการแบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างห้องน้ำข้างเลขที่ ๑๗/๑๘๙๔		๑๗/๑๘๙๔
จำนวน ๐๖ แผ่น		
(ลงชื่อ) นางสาวอรุณ เทียนทอง		ผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) นางสาวอรุณ เทียนทอง		พยาน
(ลงชื่อ) นางสาววรรรณา ปริสพันธ์		พยาน
(ลงชื่อ) นางสาววรรณา ปริสพันธ์		พยาน


สำเนาดูคดีอย่าง

 (นางภัครกมล หล่อใบ)



the future is safer with altro

altro



Altronics Walkway™ 20 / VM20 Patent No. GB 2 462 167 Altronics XpressLay™ Patent No. GB 2 462 167

Flooring type Tipo de pavimento Belagsart		EN 13845/ EN 13553	Safety flooring Suelo de seguridad antideslizante Sicherheitsbelag
Classification for use Áreas de uso Einsatzbereiche		EN 685	34 & 43 34 y 43 34 & 43
Slip resistance Resistencia al deslizamiento Rutschsicherheit*		TRRL EN 13845 EN 13893 DIN 51130	≥ 36 FSI DS R10
Thickness Espesor total Gesamtdicke		EN 428	VM20 2mm XpressLay 2.2mm
Wear layer Capa de uso Nutzschicht		EN 429	VM20 2mm XpressLay 0.8mm
Flexibility Flexibilidad Flexibilität		EN 426	EN 426 EN 20105-B22 (ลักษณะ) ISO 14038 (ลักษณะ)
Weight Peso Flächengewicht		EN 426	EN 426 EN 20105-B22 (ลักษณะ) ISO 14038 (ลักษณะ)
Roll dimensions Dimensiones del rollo Rollenabmessungen		EN 426	EN 426 EN 20105-B22 (ลักษณะ) ISO 14038 (ลักษณะ)
Light fastness Resistencia a la luz Lichtechtheit		EN 426	EN 426 EN 20105-B22 (ลักษณะ) ISO 14038 (ลักษณะ)
Sound insulation Aislamiento acústico Trütschal		EN 426	EN 426 EN 20105-B22 (ลักษณะ) ISO 14038 (ลักษณะ)
Wear resistance Abrasion Verschleißverhalten		EN 13845	EN 13845 EN 13553 (ลักษณะ) EN 13501-1 EN ISO 4236-1 EN 13553 (ลักษณะ)
Indentation Punzonamiento Restendruck		EN 423	EN 423 (น้ำหนัก) EN 12667 EN 1315 EN 1081
Fire performance Reacción al fuego Brandverhalten		EN 423	EN 423 (น้ำหนัก) EN 12667 EN 1315 EN 1081
Chemical resistance Resistencia a los productos químicos Chemikalieneinwirkung**		EN 423	EN 423 (น้ำหนัก) EN 12667 EN 1315 EN 1081
Castor chair abrasion Huellas de sillas de ruedas Stuhrollenbeanspruchung		EN 425	EN 425 (น้ำหนัก) EN 12667 EN 1315 EN 1081
Under floor heating Calefacción por el suelo Fußbodenheizung		EN 425	EN 425 (น้ำหนัก) EN 12667 EN 1315 EN 1081
Electrical behaviours Características eléctricas Elektrisches Verhalten		EN 425	EN 425 (น้ำหนัก) EN 12667 EN 1315 EN 1081

* Information is correct at the time of publication. It is the responsibility of the user to check the relevant regulations and standards for their specific application. This product has been certified by a third party.

คณิการรัมการ e-bidding

เมื่อวันที่..... ๗ ก.ย. ๒๕๖๓

ลงชื่อ..... บริษัทฯ ในการรัมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

ผู้จัดการขาย พ.ศ.๒๕๖๓

Certificate GB90/277

The management system of

Altro Limited

Works Road, Letchworth, Hertfordshire, SG6 1NW, UK

48 Pinbush Road, South Lowestoft Industrial Estate,
Suffolk, NR33 7NL, UK

Unit 3, Station Road Industrial Estate, Maiden Newton,
Dorchester, Dorset, DT2 0AE, UK



has been assessed and certified as meeting the requirements of

1-6.4 ISO 9001:2015

For the following activities


Development manufacture, stock, distribution and sale of contract
flooring materials and epoxy and polyurethane resin based industrial
flooring materials and stock, distribution and sale of wall cladding,
ceiling systems and associated products.

This certificate is valid from 12 February 2021 until 02 February 2024
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
Recertification audit due a minimum of 60 days before the expiration date.

Issue 16. Certified since 10 October 1990



Authorised by

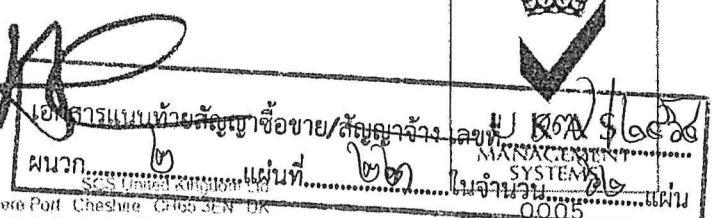

คณะกรรมการ e-bidding

เมื่อวันที่..... ๖ ก.ย. ๒๕๖๘

ลงชื่อ..... ประยานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ



บริษัท ไมโครเมติกส์ จำกัด PROMETIC CO., LTD

This document is a Web version of SGS certificate for electronic use exclusively. It shall only be available by clicking on SGS Certification Mark which has been posted on Your website. It shall not be printed in anyway. This document is copyright protected. No content or appearance may be reproduced without the express written permission of SGS. Any misuse alteration, forgery or falsification is unlawful.


ลงชื่อ..... ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๘ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(นางสาวณัฐเรือน เทียนทอง)

ลงชื่อ..... ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๘ ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นายชวีวรรณ ปริสพันธ์) พยาน

ลงชื่อ..... ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๘ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(นางภัครกุมล ทองใบ) พยาน

สำเนาถูกต้อง

๔. (นางภัครกุมล ทองใบ)

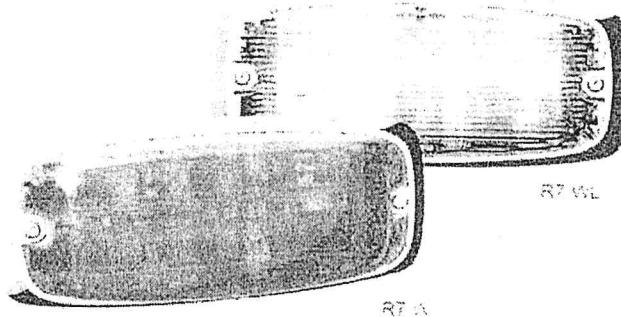

1.7 / สัญญาณไฟฉุกเฉิน ผลิตภัณฑ์ AXIOTECH รุ่น R7

1.7.1 / - ดวงไฟ ความกว้าง 8 ซม. ยาว 17.8 ซม. และหนา 2.7 ซม. ฝ้าครอบไฟเป็นแบบสีแดงหรือ

1.7.2 / สีน้ำเงิน หรือแบบใส ใช้วัสดุทนความร้อนชนิด Polycarbonate ทนต่อแสงแดดได้ดี

- สำหรับติดตั้งรถฉุกเฉินทุกประเภท ได้แก่ รถพยาบาล รถตำรวจ รถดับเพลิง รถกู้ภัย

รถจักรยานยนต์

1.7.3 / - ในชุดสัญญาณไฟ LED ใช้หลอด LED จำนวน 24 ดวง

- สัญญาณไฟผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001 , CE และ SAE J84

- เป็นผลิตภัณฑ์ประทุมสัมภาระของบริษัท
 บริษัท บีโรสเมติก จำกัด PBROSMEIC CO., LTD.

คณะกรรมการ e-bidding

เมื่อวันที่..... ๕ ก.ย. ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....*นายวิวัฒน์ เทียนทอง* ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....

ลงชื่อ.....*นายวิวัฒน์ เทียนทอง* กรรมการ

ลงชื่อ.....*นายวิวัฒน์ เทียนทอง* กรรมการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้างเลขที่..... ๙๗/๑๘๒๖
 ผู้รับ..... ๖๗ แผ่นที่..... ๗๗ ในจำนวนทั้งหมด ๖๗ แผ่น

๖๗ ก.ย. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....*นายวิวัฒน์ เทียนทอง* ผู้ซื้อ/ผู้จ่าย
 (นางสาววรรณ บุรีสพันธ์) พยาน

(ลงชื่อ).....*นายวิวัฒน์ เทียนทอง* ผู้ขาย/ผู้รับซื้อ

(นางสาววรรณ บุรีสพันธ์) พยาน



(ลงชื่อ).....*นายวิวัฒน์ เทียนทอง* ผู้ขาย/ผู้รับซื้อ
 (นางกัครกมล ทองใบ) สำเนาถูกต้อง

นางภัครกมล ทองใบ

AXIYTECH™
BROOKING
Industries Inc.

R 4/6
responder-E Series
LED Warning Lighthead

12-24VDC

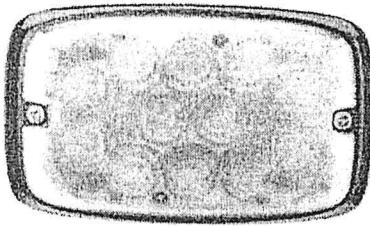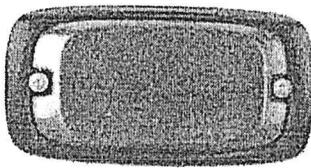

1.8/ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ที่ติดล้อที่ AXIYTECH รุ่น R4

1.8.1 // - ดวงไฟ ความกว้าง 7 ซม. ยาว 12.2 ซม. และหนา 2.2 ซม. ฝาครอบไฟเป็นแบบสีแดงหรือ

1.8.2 // สีขาวเงินหรือ แบบใส ใช้วัสดุทนความร้อนชนิด Polycarbonate ทนต่อแสงแดดได้ดี

- สำหรับติดตั้งรถอุบัติเหตุทุกประเภท ได้แก่ รถพยาบาล รถตำรวจ รถดับเพลิง รถภัย

1.8.3 // รถจักรยานยนต์ โดยชุดตั้งสัญญาณไฟ LED 1 ชุด ใช้หลอด จำนวน 12 ดวง **สำเนาถูกต้อง**

- สัญญาณไฟผ่านการรับรองมาตรฐาน SAE J845 / ISO9001		(นางภัครกนล ทองใบ)
เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อหา/สัญญาซื้อขายที่ระบุไว้ในจำนวน..... แผ่น		คณะกรรมการ e-bidding
ผูกภาระ..... เรียนมาตราฐานทางการค้าของประเทศไทย ๗๖ ๗๗ ในจำนวน..... แผ่น		๕ ก.ย. ๒๕๖๔
หมายเหตุ: รายการดังนี้เป็นรายการที่ต้องห้ามนำเข้าประเทศฯ		๕ ก.ย. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)..... ๖๕ พูดชื่อ/ผู้รับจ้าง
(นางสาวอรุณ เทียนทอง)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... ๑๙๐๙ พูดชื่อ/ผู้รับจ้าง
(นางสาวอรุณ ใจสันติ)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... ๒๒ พยาน
(นางดร.วีรวรรณ ปริสพันธ์)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... ๑๑ พยาน
(นายกัลยาณ์ ทองใบ)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ



ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

R^{4/6} responder-E Series

LED Warning Lighthead

AP27108

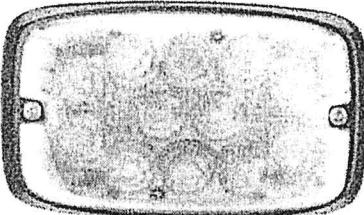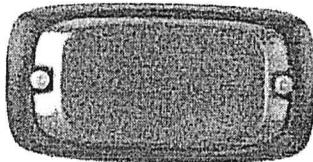

1.9 สัญญาณไฟฉุกเฉินผู้ติดกัณฑ์ AXIOTECH รุ่น R6 ✓

1.9.1 - ความกว้าง 10.5 ซม. ยาว 15.5 ซม. และหนา 3 ซม. ฝาครอบไฟเป็นแบบสีแดงหรือ

สีน้ำเงินหรือ แบบใส ใช้วัสดุทนความร้อนชนิด Polycarbonate ทนต่อแสงแดดได้ดี

- สำหรับติดตั้งรถจุกเมินทุกประเภท ได้แก่ รถพยาบาล รถตำรวจ รถดับเพลิง รถกู้ภัย

รถจักรยานยนต์

คณะกรรมการ e-bidding

เมื่อวันที่..... ๕ ก.ย. ๒๕๖๗

1.9.3 - ในชุดสัญญาณไฟ LED ใช้หลอด LED จำนวน 24 ดวง

ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ

- สัญญาณไฟผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001 , CE และ SAE J579 แผ่นที่..... ๔๕ ในจำนวน ๔๕ แผ่น

ลงชื่อ.....

กรรมการ

- เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทสหัสกรีก้า

ลงชื่อ.....

กรรมการ


 บริษัท ไบรอกิงส์ จำกัด
 BROCING CO., LTD.

(ลงชื่อ)..... ผู้เชื่อ/ผู้ร่วมงาน
 (นางชวัญเรือน เทียนทอง)


(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย/ผู้รับมอบหมาย
 (นายพงษ์รุ่ง ลลวัฒน์)

(ลงชื่อ)..... พยาน
 (นางสาวรุ่งอรุณ บุญสันต์)

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)..... พยาน
 (นางภัครกมล ทองใบ)

(ลงชื่อ).....
 (นางภัครกมล ทองใบ)

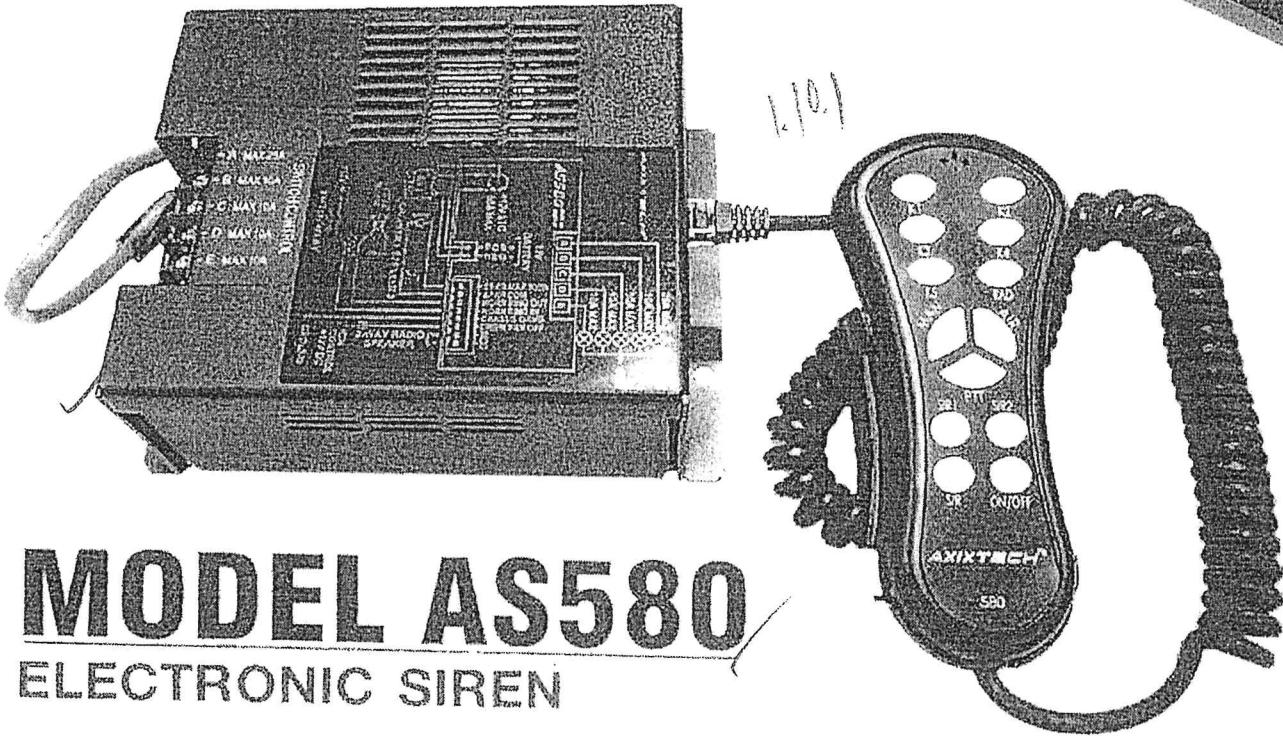

1.10

MODEL AS580 ELECTRONIC SIREN

- กล่องเสียงไซเรนขนาด 200 วัตต์ ✓
- มีไมโครโฟนชนิด Dynamic มีสวิทซ์สำหรับควบคุมการพูด (Push to talk) ✓
- สายไมโครโฟนเป็นแบบ Coiled Tubing พร้อมที่ยืดไมโครโฟน
- ใช้กับกระแสไฟ 12 โวลต์

คณะกรรมการ e-bidding

- 1.10.3 ● สามารถปรับเสียงได้ 4 เลvels มีวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔
- เป็นผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์อเมริกา เลขที่ ๙๐๗๘๓๒๒๔ ประธานกรรมการ
- ผู้ผลิต.....กรรมการ
- รองงานผ่านการรับรองมาตรฐานสากล กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจุนทรีย์ เพียบทอง)


 บริษัท ปอร์เมเดียค จำกัด PROMEDIC CO., LTD.

(ลงชื่อ).....

๐๘๙๗

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

สำเนาจดตัวอย่าง

Brooking Industries Inc. (บรูคิง อินดัสตรีส์ อินโค.)

๙๐๕๙ หมู่ ๑ ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดมหาสารคาม ๑๖๐๐๐ (ลงชื่อ).....

<http://www.brookingindustries.com>

(นางสาวจุนทรีย์ บุรีสพันธ์)

พยาน

(ลงชื่อ).....


(นางสาวศรีรุ่งสิน ห้องใบ)

พยาน

(นางสาวกัลยา ห้องใบ)

Siren speaker

AS150

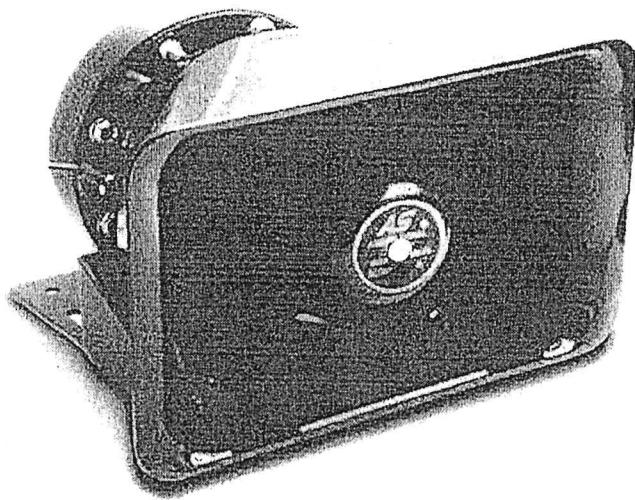

คณะกรรมการ e-bidding

เมื่อวันที่.....๕ ก.ย. ๒๕๖๔
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ

ผู้ดูแลระบบฯ

- Light weight, small size, compact structure
- Water proof, Aquosity proof. Corrosion resistant
- Adopting Nd-Fe-B magnet with high electroacoustic transmission rate and wide frequency range
- Computer aided design with excellent workmanship and high reliability
- Technical specification are in accordance with international standard

คุณสมบัติเบื้องต้น เลขที่.....๗๗/๖๖๘
 Rated power: 100W ๑๐๐ ในงานนี้. Dimension: ๑๖x ๑๖x ๑๖ cm
 ผู้มาก.....
 電子元件: ๑๐๐ แมกนิต: ๑๐๐

Net weight: 2.6 kg.

Sound frequency range: 200-8000Hz รีซูต: 16x139x203 mm.
 แบบรายละเอียดประับถูกต้อง ที่ติดต่อ: ๑๐dB
 Fed voltage: <33V

Sound pressure level: ≈129 dB

(ลงชื่อ).....
 (นางชรุณเรือน เพียงทอง)

ผู้ซื้อ/ผู้ร่วมซื้อ

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวอรุณ เจริญฤทธิ์)

ผู้ขาย/ผู้รับซื้อ

(ลงชื่อ).....
 (นางสาววรรณ บุรีสพันธ์)

พยาน

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวศรีรุ่ง ทองใบ)

พยาน

PROMEDIC
 บริษัท พรอมเด็ค จำกัด PROMEDIC CO., LTD.


PROMEDIC
 บริษัท พรอมเด็ค จำกัด PROMEDIC CO., LTD.

สำเนาถูกต้อง

(นางภัคราช ทองใบ)

SPENCER

1-17

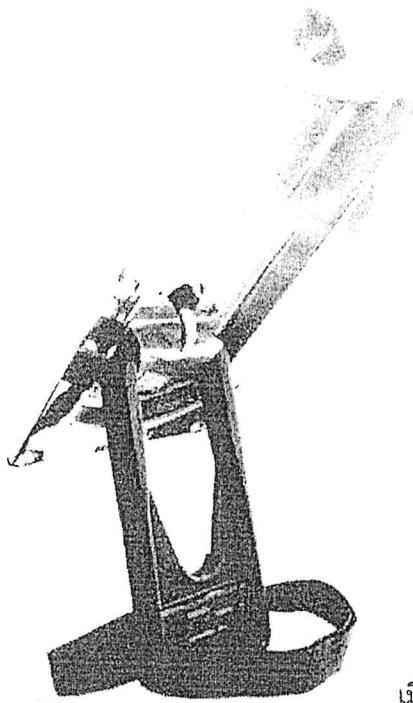

คณะกรรมการ e-bidding

เมื่อวันที่..... ๕ ก.ย. ๒๕๖๔
ลงชื่อ..... ประชานกรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ

อุปกรณ์แขวนน้ำเกลือสำหรับผู้ป่วยในรัตพยาบาลแบบพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน ผลิตจากยางหล่อ
เพื่อบังกันการกระแทกขณะปฏิบัติหน้าที่ ผ่านการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน EN 1789
ด้วยการทดสอบด้วยแรงกระแทก 10G

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาซื้อขายที่..... ๙๖/๒๕๖๔
ผู้เสนอ..... ๗๘ แผ่นที่..... ๗๘ ในจำนวน..... ๑๖ แผ่น

บริษัท โปรดเมดิกอล จำกัด PROMEDIC CO., LTD.
Strada Cavi, 7
43044 Collecchio PR Italy
Tel. +39.521.541111 - Fax +39.521.541222

(ลงชื่อ)..... ๙๖/๗๘ ผู้ขาย/ผู้รับค้า
(นางชรัสเรือน เพียงทอง)

(ลงชื่อ)..... ๙๖/๗๘ ผู้ขาย/ผู้รับค้า
(นายณัฐพงษ์ ใจดี)

(ลงชื่อ)..... ๙๖/๗๘ พยาบาล
(นางจิวรรณ บุริสพันธ์)

(ลงชื่อ)..... ๙๖/๗๘ พยาบาล
(นางสาวครกมล ทองใบ)


PROMEDIC
บริษัท โปรดเมดิกอล จำกัด PROMEDIC CO., LTD.
สำเนาถูกต้อง

(นางภัครกมล ทองใบ)



LINKCHAMP / LINKCHAMP CO., LTD

DC-AC

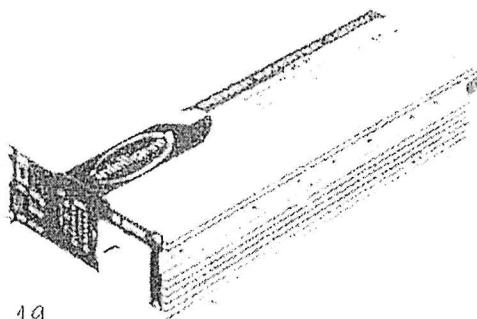

1.19

SPECIFICATION

ITEM	SN-1000
OUTPUT POWER	<u>CONTINUOUS POWER 1000W</u> 1200W 10mini 2000W
SURGE POWER	
STANDBY CURRENT	DC 12V < 1A DC 24V < 0.8A
GREEN POWER MODE	DC 12V < 0.1A DC 24V < 0.1A
INPUT VOLTAGE	DC12V : 10V~15V DC24V : 20V~30V
OUTPUT VOLTAGE	AC 100V, 110V, 120V, 220V, 230V, 240V
OUTPUT WAVEFORM	Pure Sine Wave
EFFICIENCY	> 85%
INITIAL CHECKING	AUTO-DETECTING WRONG BATTERY CONT. ex. 12V / 24V
TOTAL HARMONIC DISTORTION	< 3%
OUTPUT REGULATION	< ± 5% INTELLIGENT PWM
OUTPUT FREQUENCY	50Hz, 55Hz, 60Hz CRYSTAL CONTROLLED.
(ลงชื่อ)..... (นางสาวกานดา ทัยสกุล) ผู้จัดการฝ่ายขาย	33 แผ่น AUTO-OPERATION FAN
	OUTPUT SHORT CIRCUIT PROTECTION
LOW BATTERY..... OVER HEATING..... OVER LOAD..... (ลงชื่อ)..... (นางสาวกานดา ทัยสกุล) ผู้จัดการฝ่ายขาย	10.5V or 20V PRE-ALARM < 9.5V or 20V ± 0.5V SHUT DOWN & ALARM > 60°C PRE-ALARM > 65°C SHUT DOWN & ALARM > 120W SHUT DOWN & ALARM
FUSE..... AC OUTLET..... (ลงชื่อ)..... (นางสาวกานดา ทัยสกุล) ผู้จัดการฝ่ายขาย	BY FUSE DC 12V : 25A * 6PCS DC 24V : 20A * 6PCS 2 AC OUTLETS - EUROPEAN TYPE G (3000mA) 60136-20mA
	PHOTONIC INDUSTRIAL CO., LTD.

(ลงชื่อ)..... (นางสาวกานดา ทัยสกุล) ผู้จัดการฝ่ายขาย	ANSWER BY WORKER ANSWER BY WORKER
(ลงชื่อ)..... (นางสาวกานดา ทัยสกุล) ผู้จัดการฝ่ายขาย	ANSWER BY WORKER ANSWER BY WORKER
(ลงชื่อ)..... (นางสาวกานดา ทัยสกุล) ผู้จัดการฝ่ายขาย	ANSWER BY WORKER ANSWER BY WORKER
(ลงชื่อ)..... (นางสาวกานดา ทัยสกุล) ผู้จัดการฝ่ายขาย	ANSWER BY WORKER ANSWER BY WORKER

CE E

REACH คุณภาพรัฐการ e-bidding

ANSWER BY WORKER

ANSWER BY WORKER

ANSWER BY WORKER

ANSWER BY WORKER

เมื่อวันที่ - ๖ ก.ย. ๒๕๖๓

ลงชื่อ ประชานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

1-20

⑥ APOLLO (SVCW)

- Choice of 3 different light angles
- Integrated switch option
- Quick and easy to install
- Power LED version available
- E-type approved

สำเนาถูกต้อง


(นางกัครกมล ทองใบ)

คณะกรรมการ e-bidding

เมื่อวันที่ ๔ ก.ย. ๒๕๖๔

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ


ลงชื่อ..... กรรมการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๗๗ | ๒๕๖๔
ผนวก..... แผ่นที่ ๐๑ ในจำนวน ๐๘ แผ่น

แบบรายละเอียดประกอบสัญญาซื้อ/จ้างลงวันที่ ๔ ก.ย. 
(ลงชื่อ)  ผู้ซื้อ/ผู้จัดจ้าง บริษัท โปรดเมดิกส์ จำกัด PROMEDIC CO., LTD.
(นางชวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)  ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(นายฉวีวรรณ บุรีสพันธ์) พยาน

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางกัครกมล ทองใบ)

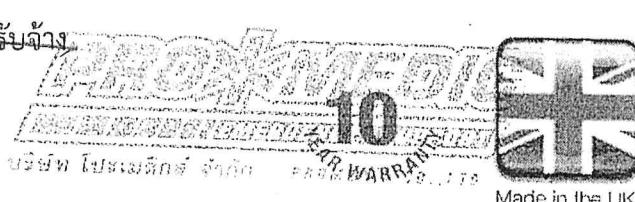

See technical specs overleaf >>>

- High concentration of LEDs - This new product has been designed to offer a choice of up to 48 LEDs per 500mm, and 96 LEDs per 1000mm LED strip, to substantially increase light output.
 - Choice of 3 different light angles - The internal LED strip can be positioned in 3 different angles by the user to direct the light exactly where it is needed.
 - Integrated switch option - The Apollo can be switched remotely or is available with an integrated on/off rocker switch which fits neatly into the end cap.
 - Quick and easy to install - The Apollo is simply fixed into place by the end caps, making it suitable for both new vehicle specifications and retrofitting into existing vehicles.
 - Power LED version available - Power LED strips are available for this product to provide more light output for areas where a more concentrated light source is required.
- ເອກສາງແນວທາງເຕັມຢາຊ້ອ່າຍ/ຮັກມາດວັດ ທີ່ ၂၀၁၇
ກວດ ໄປວິດ
ພັນທິ ໃນຈຳນວນ.....ແມ່ນ

ແບບຮາຍລະເອີດປະກອບສັນຄູາ ຕົວ/ຈັງ ຄົງວັນທີ ၂၅ ກ.ຍ. ໨໬໬

(ລັງຊື່)
(ນາງຂວັງເວັນ ເທິຍິນທອງ)

(ລັງຊື່)
(ນາງຈຸວຣະນ ບຸຮສພນອີ)

(ລັງຊື່)
(ນາງກົດກົມດ ທອງໄນ)

1. 20.2 (ລັງຊື່)
(ນາງກົດກົມດ ທອງໄນ)

APOLO (SVCW)

ຄົນະກົຽມການ e-bidding

ມີອວັນທີ 25 ກ.ຍ. ໨໬໬

ລົງຊື່
ປະກາດກົມດ ປະກາດກົມດ

PROMEDIC

ASIAN LEADER IN THE REFERENCE OF SUPPORT
PROMEDIC CO., LTD.

Specification ລັງຊື່	ກຽມການ		ກຽມການ				ຖານາຄາດກອງ SVCW 0.5
	250-24	SVCW 500-48	250-24	SVCW 500-48	250-24	SVCW 500-48	
Supply Voltage	VDC	12	24	12	24	12	24
Voltage Range	VDC	10-14	20-28	10-14	20-28	10-15	20-32
Average Current	A	0.28	0.14	0.56	0.28	0.33	0.16
Light Output	lm	288	288	576	576	300	300
LED Power	W	3.7	3.7	7.4	7.3	6 x 0.5	6 x 0.5
Weight	kg	0.09	0.09	0.13	0.13	0.09	0.09
Temp. Range	°C	-30 to +40	-30 to +40	-30 to +40	-30 to +40	-30 to +40	-30 to +40

Calculations based on average LED values @ 13.2V (for 12V models) and @ 23V (for 24V)

E & OE

LABCRAFT IS THE LEADING EUROPEAN DESIGNER, DEVELOPER AND MANUFACTURER OF INNOVATIVE LOW VOLTAGE LIGHTING SOLUTIONS

1.21
ICOM

VHF AND UHF DIGITAL/ANALOG TRANSCEIVERS

IC-F6123D IC-F6123D

VHF Transceiver

UHF transceiver

Everything you'd expect in a business radio ... Plus Digital!



(ลงชื่อ) ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(นามสกุล) นายนิติพงษ์ พูลสวัสดิ์

(ลงชื่อ) ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
IDASS ICOM DIGITAL ADVANCED SYSTEM

(ลงชื่อ) ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
IDAS (ไบบี.ดี.เอ.ส.) Single-site Trunking

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาววรรณ บูรพาพันธ์) Mode Operation

(ลงชื่อ) พยาน
(นายภัคราชต์ ทองใบ) Built-in 2-Tone, 1-Tone,
RSSE and DTMF

MDC 1200 Compatible

MIL-STD-810 E
Rugged Construction

↑ ↑ (ท.y.p.) Front
Mounted Speaker



คณภาพการ e-bidding
เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๔

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

PROMEDIC
SYSTEMS FOR EMERGENCY SURVIVAL

บริษัท พรอมเดิค จำกัด PROMEDIC CO., LTD.

สำเนาถูกต้อง

(นางภัคราชต์ ทองใบ)

MIL-STD-810

MDC 1200
Limited functions

More than Just Smooth Digital Migration!

Ample 128 channel capacity allows most companies plenty of room to grow. Up to 8 zones lets you group together channels in logical fashion.

The tough aluminum die-cast chassis and polycarbonate front panel have been tested to the MIL standard 810 F.

With optional D-SUB 25-pin ACC cable OPC-2078, an external GPS receiver or PC can be connected.

* No digital modulation "IN" using accessory cables.

Select from 4 levels of mic gain, for clearer transmission.




Photo shows optional OPC-2078 installed on high power version.



เอกสารแนมน้ำท้ายลัญญาจือขาย/สัญญาจ้าง เลขที่..... ๙๘/๑๖๗๘

An 8-character alphanumeric LCD will provide easy access to often used functions. User-friendly icons show a variety of information and operating status such as caller's name, received message text, date/time, late backlit for night time operation.

4 watts (typ.) front facing speaker delivers clear and loud audio throughout a vehicle's cabin. Digital modulation adds distinct clarity to received voices.

(ลงชื่อ) ผู้ขอ/ผู้รับฟัง
(นางสาวกานต์ เทียนทอง)

(ลงชื่อ) ผู้ขาย/ผู้รับฟัง
(นายธนกร คง พัฒนา)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาววรรณ บริสพันธ์)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางกัครกมล ทองใบ)

สำเนาอุปกรณ์

(นางกัครกมล ทองใบ)



บริษัท อะดิทีฟ จำกัด ๐๘๑-๔๒๒๕๖๖๖๖


คณะกรรมการ e-bidding
๐๘๑-๔๒๒๕๖๖๖๖

เมื่อวันที่.....

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ


ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

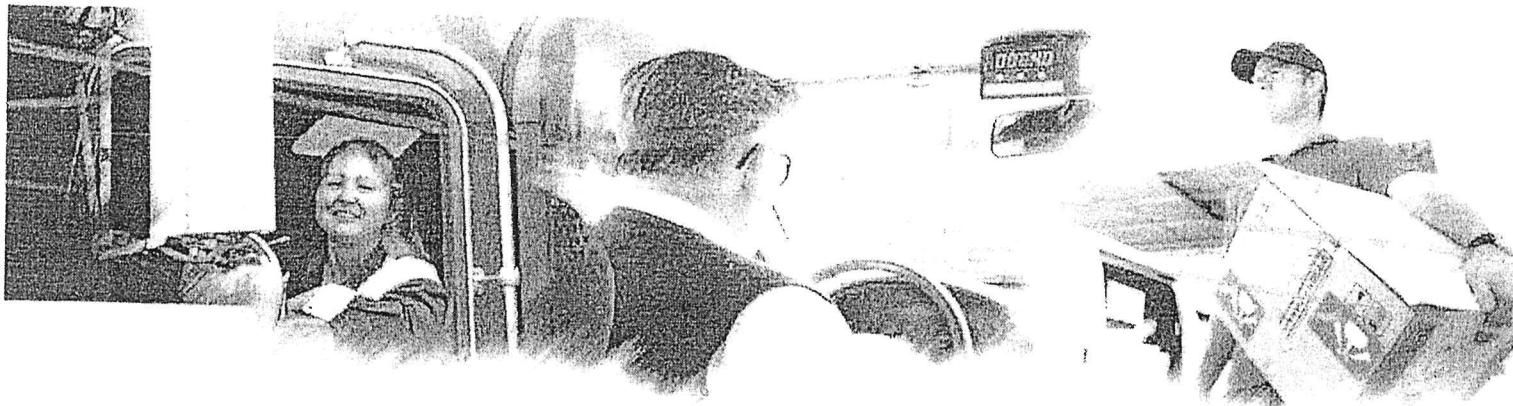


The IC-F5123D series : A multitude of advantages because it's IDAS™

Digital/analog Mixed Mode

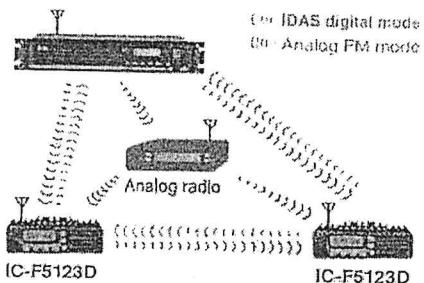

The IC-F5123D series can receive both analog mode and digital mode signals on a single channel and automatically selects the received mode to reply to the received call, while the talk-back remains. It's a smart way to grow into digital radio at your own pace, your budget and comfort allow.

Digital and Analog Individual/group Call

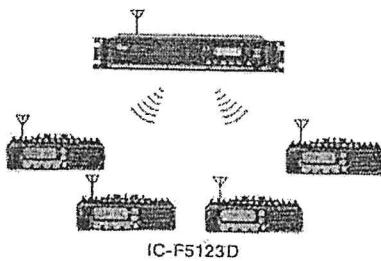

The IC-F5123D series allows you to call individual or group users. The radio automatically sends own ID number when the PTT button is held. The alias name or individual/group ID is displayed on the screen while receiving a message allowing you to identify who is calling.

Status Message and Short Data Message

Status message example

STAT (ID)
Preprogrammed status comments are displayed to match the status-number.

Short data message example

TEXT MES (SAGING)
The display shows longer messages by automatic vertical scrolling.

Up to 100 status conditions can be set and sent with voice call. Also, you can request another IDAS radio to send their status and receive it.

Up to 100-character of short data message can be sent and received. To send more than 9-character short data message, PC connection is required.


GPS Capability



When used with an external GPS receiver, the IC-F5123D series can transmit accurate position data for use with vehicle management applications.

When using the IC-F5123D series in IDAS multi-site conventional mode, the IC-F5123D can communicate with other IDAS radio users working with other repeater sites and/or virtual radio/PC dispatch stations on the IDAS network.

IDAS Single-site Trunking

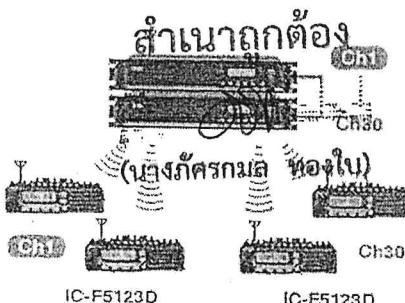

The IC-F5123D series can be used in an IDAS single-site trunking system. The IDAS trunking system is a distributed system with no dedicated control channel, so more voice traffic channels are available for increased system capacity.

คุณสมบัติ e-bidding

All advantages shown represent possible system configurations. Ask your Icom dealer to configure an IDAS system to fit your needs best for you.
*Note: Private IP Network or VPN Tunnels through the Internet with static endpoints.

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....


ประชารากรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

SL157 series

7 Inch Exterior Scene Light

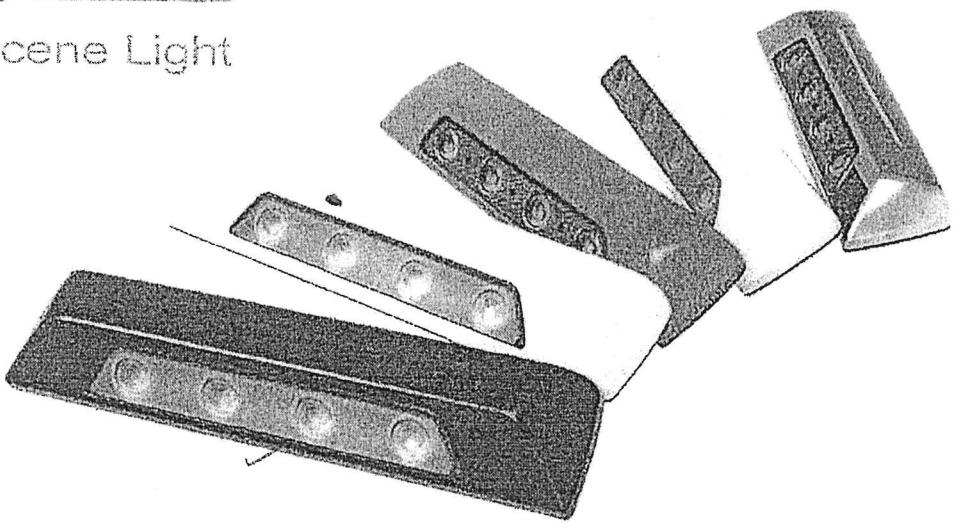

FEATURES

- Compact and simple design wherever you need illumination.
- Over 1400 Lumen output; Luminous intensity ≥ 660 Lux at 1 meter.
- Certified ECE R10 and CISPR 25.
- 12~24V wide range input.
- Reverse polarity protection.
- Available in black, white, chrome, yellow, or red bezel.
- Die-cast aluminium base for efficient heat dissipation and high LED durability.
- Weatherproof and vibration resistant for both internal or external use.

SPECIFICATIONS

Compliance: ECE R10 1.22.6
CISPR 25 Class 1 for 12V
CISPR 25 Class 2 for 24V

1.22.8 IPX7

Operating Voltage: 12~24VDC 1.22.2

Beam Type: Flood (ลางซื้อ) 1.22.9

LED Element: High Power LED x 4 pcs 1.22.10

Raw Lumen: 1400 lm 1.22.3

Effective Lumen: 890 lm (ลางซื้อ) 1.22.11

Max. Current: 1.2A @12VDC / 0.6A @24V (流明วิวัรรณ ปริสพันธ์)

Max. Power: 14.4 Watt 1.22.4

Wires: Red-VDC: 21cm (20AWG)

Black-GND: 21cm (20AWG)

Fuse Rating: 2A

LED Colour: White


Lens Colour: Clear

Storage Temp. (°C): -40° ~ +75°

Working Temp. (°C): -30° ~ +65°

Weight : 108g

DIMENSIONS

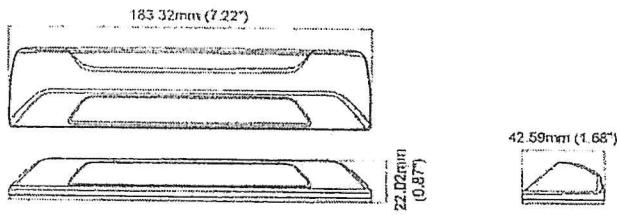

PART NO

W012X00-000 (refer to R10 label)

ผู้ผลิต.....แผ่นที่.....ในทำนอง.....

.....refer to Bezel Kit 1.22.12

.....0 = w/ Black Bezel 1 = w/ White Bezel 2 = w/ Chrome Bezel


.....3 = w/ Red Bezel 4 = w/ Yellow Bezel *

* Special request, please contact to your sales representatives

ILLUMINANCE PATTERN



สำเนาถูกต้อง



(นางกัครกมส ท่องไถ) Intensity height

ACCESSORIES

99-W012X00-000 (Bezel, Black) 1.22.13

99-W012X01-000 (Bezel, White) 1.22.14

99-W012X02-000 (Bezel, Chrome) 1.22.15

คงซื้อ.....ประชานกรรมการ

คงซื้อ.....กรรมการ

คงซื้อ.....กรรมการ






YuJie Electronics Co.,Ltd.

1.23.2

USB Type

12V

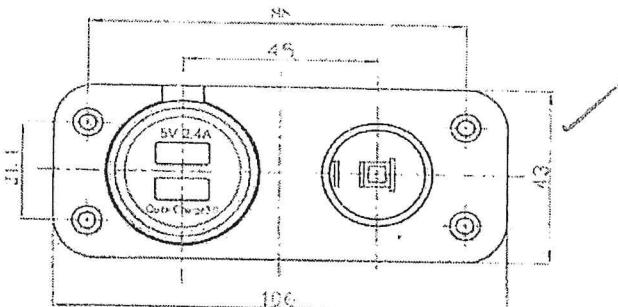

1.23

Model : DS5-2022/3004

1.23.1

QC3.0+2.4A USB Socket

- : Quick Charge 3.0: Charge compatible devices up to 4 times faster than conventional charging
- : Compatible with all USB-powered devices including Quick Charge 3.0 2.0 Smart phones & tablets

Universal Compatibility

- : Plastic + Metal
- : Black
- : Blue, Red, Green (optional)
- : DC 12V - 24V
- : DC 5V 3.6A, 9V 2.1A, 9V-12V 1.5A
- : DC 5V 2.4A
- : 36.8*50*28.6 mm

Material


Product Color

LED Indicator light color

Power Input


QC 3.0 USB Output

2.4A USB Output

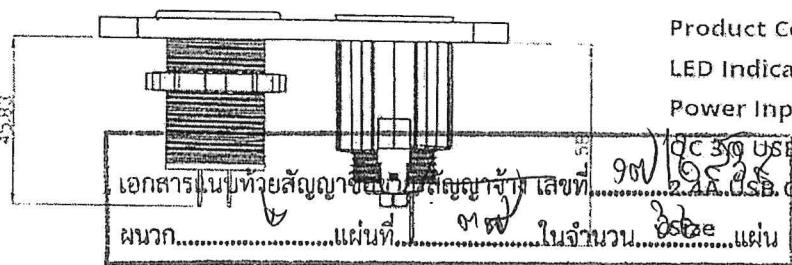

แบบรายละเอียดประกอบลักษณะชิ้น/จ้าง ลงวันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๘

รายการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับจำนำ
1. Input (นางขวัญเรือง 2V-24V DC)	พยาน
2. USB Output 1 (จ่ายไฟชาร์จเบ้าชาร์จ)	ผู้ขาย/ผู้รับจำนำ
3. USB Output 2 (จ่ายไฟชาร์จเบ้าชาร์จ)	
4. Fireproof (หุ้นส่วนติดต่อไฟฟ้า)	
5. Waterproof (หุ้นส่วนติดต่อไฟฟ้า)	
(จ่ายไฟชาร์จเบ้าชาร์จ)	
6. Temperature range (นางนิรบุรี บุรีพันธุ์)	

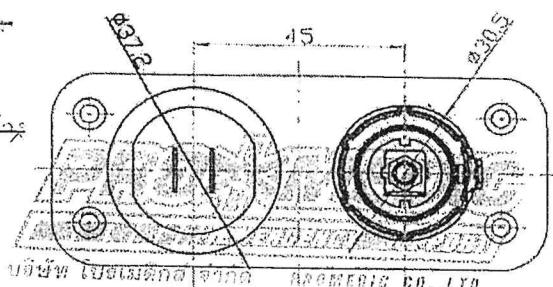

(ลงชื่อ) พยาน
 (นางวัชริกา ทองใบ)

Cigarette Lighter Socket:

- Built-in heat resistant ceramic protector.
- Fit for most cars as direct lighter replacement
- Professional custom cigarette lighter plug-in ports, the use of safety holster, Anti rust, ล็อกเขม่าถูกต้องตัวตัด anti-off, with fuse, safe and secure, waterproof.
- The cigarette lighter is a high-grade cigarette lighter assembly, lightweight.
- Over-heated, over-current, over-charging protection, charging will be automatically stop when battery is full, easy to use and install.



บริษัท ปอร์เมดิค จำกัด PROMEDIC CO.,LTD.

ลงชื่อ..... ประชานกรณการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ

คณะกรรมการ e-bidding

ลงชื่อ..... ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๘


ลงชื่อ..... ประชานกรณการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

BATTERY MANAGEMENT

1. 24

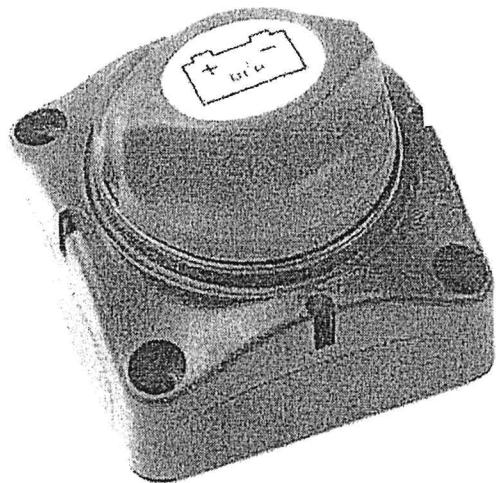



Contour Battery Master Switch Part #701

- Patented Contour Locking System allows switch to be a stand alone unit, or locked together with other switches
- Control knob can be removed by switching to counter-clockwise 45° position
- Three removable side plates for access of up to 1/0 cables plus a rear cover insulating the rear terminals against any short circuits. This ensures the switch meets ABYC requirements
- 2.1" (52 mm) hole for mounting
- Available with house knob (OEM # 701B-HB) or with chassis knob (OEM # 701B-CH)

Specification - All recessed or surface mount, tin-plated copper studs & nuts, ignition-protected

Part	OEM	Dimensions (mm)	Current Rating (Amp)	Break Time (ms)	Voltage (V DC)	Operation	Stud size	Cable to meet rating (AWG/mm²)		
701	701B 2.75 x 2.75 x 3"	69x69x75	275	455	1250	11.0	48	On/Off	2x3/8" / 10 mm	3/0 / 95 mm²

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ/ผู้รับของ
 (ลงชื่อ) ผู้ขาย/ผู้รับของ
 (ลงชื่อ) พยาน
 (ลงชื่อ) (นางสาววิรรณ ปริสพันธ์)
 (ลงชื่อ) SIDE PLATE BACK PLATE พน. เน
 (ลงชื่อ) (นางวัครกมล ทองใบ)

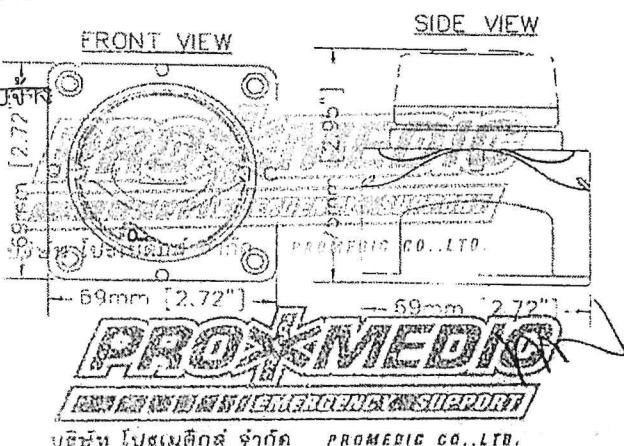

▶ POWERtip

BEP Battery Switch Construction

All BEP battery switches are molded in a high strength, fiber reinforced plastic which provides excellent high temperature performance, and the greatest resistance to chemicals that damage other plastic types.

สำเนาถูกต้อง

ผู้อ้วนที่ ๖ ก.ย. ๒๕๖๔
 ลงชื่อ ประชานการรบกการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ


นายวัครกมล ทองใบ

4.26

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาซื้อรักษาที่.....	กบ/๖๙๒
ผู้ว่าฯ.....	ผู้อำนวยการฯ
ผู้ชื่อ.....	ผู้รับจ้าง
ผู้ชื่อ.....	ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
ผู้ชื่อ.....	ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
ผู้ชื่อ.....	พยาน
ผู้ชื่อ.....	พยาน


แบบรายละเอียดประกอบยลสัญญาซื้อขายลงวันที่ ๔.๘ ก.ย. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ).....
 (นางขวัญเรือน เทียนทอง)
 (ลงชื่อ).....
 (นางสาวนรรดา ใจกลางวัน)
 (ลงชื่อ).....
 (นางวีวรรณ บุริสพันธ์)
 (ลงชื่อ).....
 (นางภัคราภรณ์ ทองใบ)

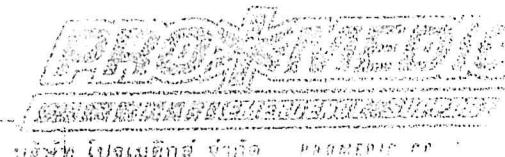

สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเทศไทย

คณหกรรมการ e-bidding
 เมื่อวันที่..... ๔ ก.ย. ๒๕๖๒
 ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ

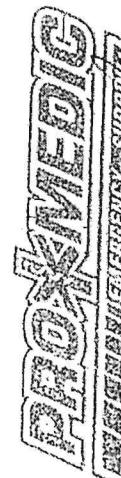

สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง^๑
 (นายกฤษณะ พัฒนาวงศ์ ทักษิณ)

๑ ๑

TITLE : ROOM PRESSURIZATION TEST POINT	Q.C.
LOCATION : ห้องบำบัด PCPOSITIVE PRESSURE	บริษัทไบโอไซด์ จำกัด

1. 26

1765 mm

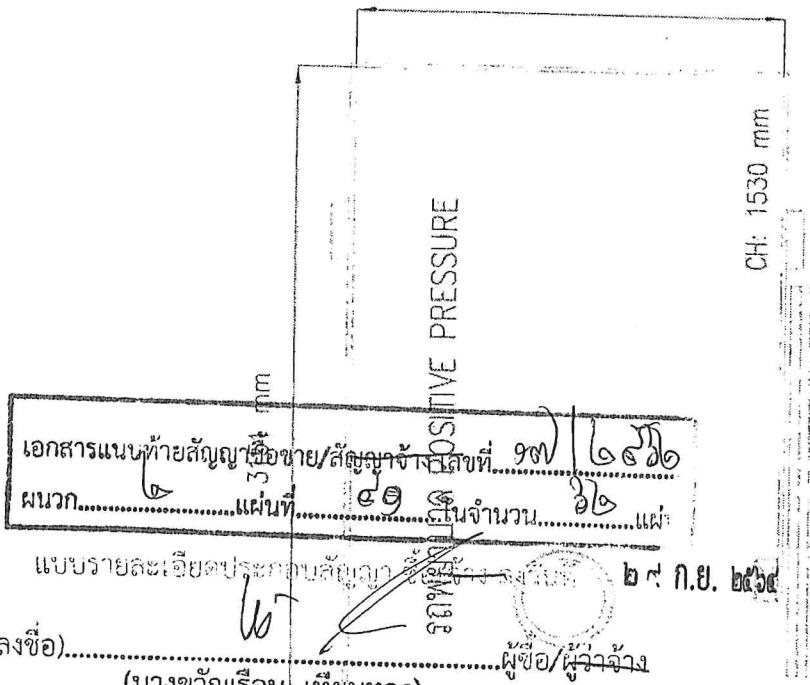

(ลงชื่อ) ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(นายปงษ์สวัสดิ์ ใจดี)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางฉวีวรรณ บุรีสพันธ์)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางภัครกฤตา ทองใบ)



สำเนาถูกต้อง

(นางรัชกรกฤตา ทองใบ)

คณะกรรมการ e-bidding
เมื่อวันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๔
ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

Summary of Specification & Test Result

1.26

No.	Test Description	Specification รหสพยาบาล Positive Pressure	Test Result รหสพยาบาล Positive Pressure	Remark
1	Airflow Volume Test • Total Airflow Volume (CFM) • Air Change Rate (Cycles/hr.)	174 ≥ 20	174 20	Within specification
2	Room Pressurization Test • W.r.t. Outside Environment (Pa) Point 1	***	3.4	For data
3	Airflow Visualization Test • Smoke Pattern Test	***	Please refer to Section E Airflow Visualization Test & Clip Video (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....	For data แบบรายละเอียดประกอบสัญญาซื้อ/ขาย-คงวันที่ ๙๖/๑๖๕๘ ผู้ขาย/ผู้รับซื้อ ^{ก.ย. ๒๕๖๔} (นางสาวณัฐเรือน เทียนทอง) ผู้ขาย/ผู้รับซื้อ ^{ก.ย. ๒๕๖๔} (นางสาววรรณ ปริสพันธ์) ผู้ขาย/ผู้รับซื้อ ^{ก.ย. ๒๕๖๔} (นางภัครกุล ทองใบ)

Notes : *** Not Applicable/Not Specify

อกศ่างและทายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้างเลขที่ ๙๖/๑๖๕๘
ผู้ขาย..... แผ่นที่ ๖ ในจำนวน ๖ แผ่น

แบบรายละเอียดประกอบสัญญาซื้อ/ขาย-คงวันที่ ๙๖/๑๖๕๘
ผู้ขาย/ผู้รับซื้อ^{ก.ย. ๒๕๖๔}
(นางสาวณัฐเรือน เทียนทอง)

ผู้ขาย/ผู้รับซื้อ^{ก.ย. ๒๕๖๔}
(นางสาววรรณ ปริสพันธ์)
ผู้ขาย/ผู้รับซื้อ^{ก.ย. ๒๕๖๔}
(นางภัครกุล ทองใบ)

คณะกรรมการ e-bidding
เมื่อวันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๔
ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ



กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานมาตรฐานสุขภาพ

สำเนาถูกต้อง

(นางภัครกุล ทองใบ)

เอกสารแนบมายังสัญญาซื้อขายที่ดิน ที่ดินเลขที่ ๑๙
ผนวก..... แผ่นที่

แบบรายละเอียดประจำ

(ลงชื่อ).....
(นางขวัญเรือน)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวรุ่งอรุณ)

(ลงชื่อ).....
(นางสาววรรณ บุญมา)

(ลงชื่อ).....
(นางวัตรกมล ทองใบ)

คณะกรรมการ e-bidding

ผู้อ้วนที่..... - ๕ ก.ย. ๒๕๖๖

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นางวัตรกมล ทองใบ)

สัญญาซื้อขายและการจัดทำ

ด้วยโศรังสระน้ำที่ขอแบบใหม่ นำพร้อมบุญปรม
ก้ายอนอ่าก์ครบครัน ขอบความปลดตัว
ใบอนุญาตซื้อขาย

(ลงชื่อ).....

แบบรายละเอียดประกอบสัญญาซื้อขาย/สัญญาจัดทำ
ใบอนุญาตซื้อขาย

.....๐๔๕๗๐

(นางสาวนภัสรา ใจดี)

(ลงชื่อ).....

(นางฉวีวรรณ บุริสพันธ์)

(ลงชื่อ).....

(นางภัครกมล ทองใบ)

กระทรวงมหาดไทย
ใบอนุญาตซื้อขาย



กระทรวงมหาดไทย
ใบอนุญาตซื้อขายล้อลากหนังสือ
เพิ่มจุดสักจิ้นอ่อนเมืองยานนาวา
ประกอบห้องเรียนจังหวัดเชียงใหม่

ไฟฟ้าบ้านเดิร์ฟเล็กเกอร์
เพื่อการซ่อมส่วนตัวของเดียว
เพียงบ้านเดียวที่ให้การติดไฟ



กระทรวงมหาดไทย
ร่วมมือให้การอบรมหลักสูตร

ล็อก ๑๖ ผู้ใหญ่


คณิตกรรมการ e-bidding
พย. เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๘

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นางภัครกมล ทองใบ)

ไฟฟ้า ๓ ดาว
เพิ่งกว่าบล็อกด้วย
รถรับส่งน้องกันปั๊ดซัดซับ

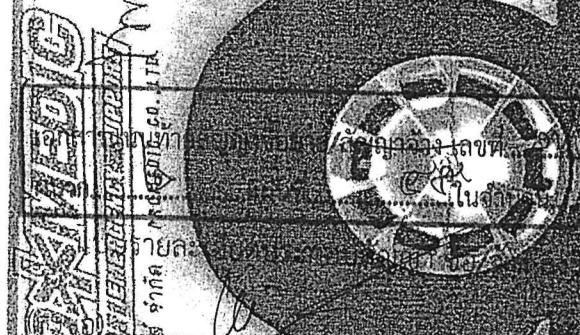

(ลงชื่อ)

(นางสาวรุ่งรัตน์ ปรีดพันธ์)

(ลงชื่อ)

(นางกัครกุล ทองใบ)

คณะกรรมการ e-bidding

เมื่อวันที่..... ๘ ก.พ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ..... ประชารักษ์

ลงชื่อ..... กรรมการ


ลงชื่อ..... กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

.....
(นางกัครกุล ทองใบ)

ผู้ที่เก็บของน้ำมือศรีสุรัส ลดาภิษัพพ์ ศรีสุรัส ผู้ดูแลน้ำสีและน้ำเงิน บริษัทสีและน้ำเงินไทยจำกัด

ผู้ที่เก็บของน้ำมือศรีสุรัส ลดาภิษัพพ์ ศรีสุรัส ผู้ดูแลน้ำสีและน้ำเงิน บริษัทสีและน้ำเงินไทยจำกัด

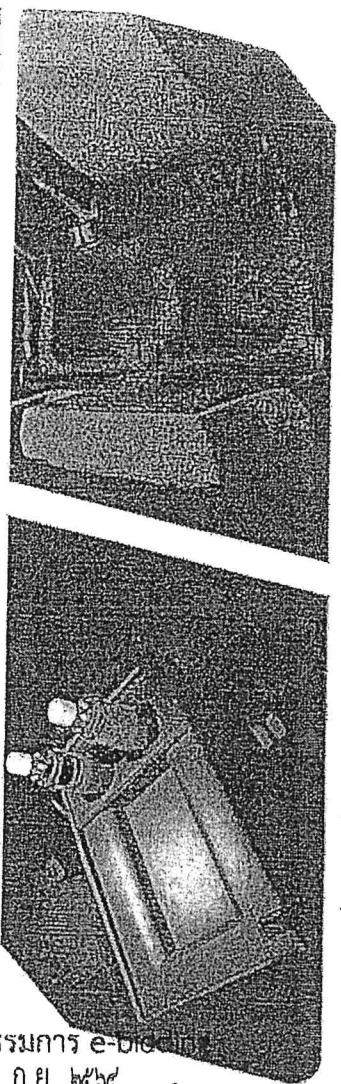

กรรมการ e-เบอร์
๘ ก.ย. ๒๕๖๔

ประธานกรรมการ


กรรมการ

ใบอนุญาตจัดทำหน้าอ่อนนุช

กรรมการ e-เบอร์
๘ ก.ย. ๒๕๖๔

ประธานกรรมการ

กรรมการ

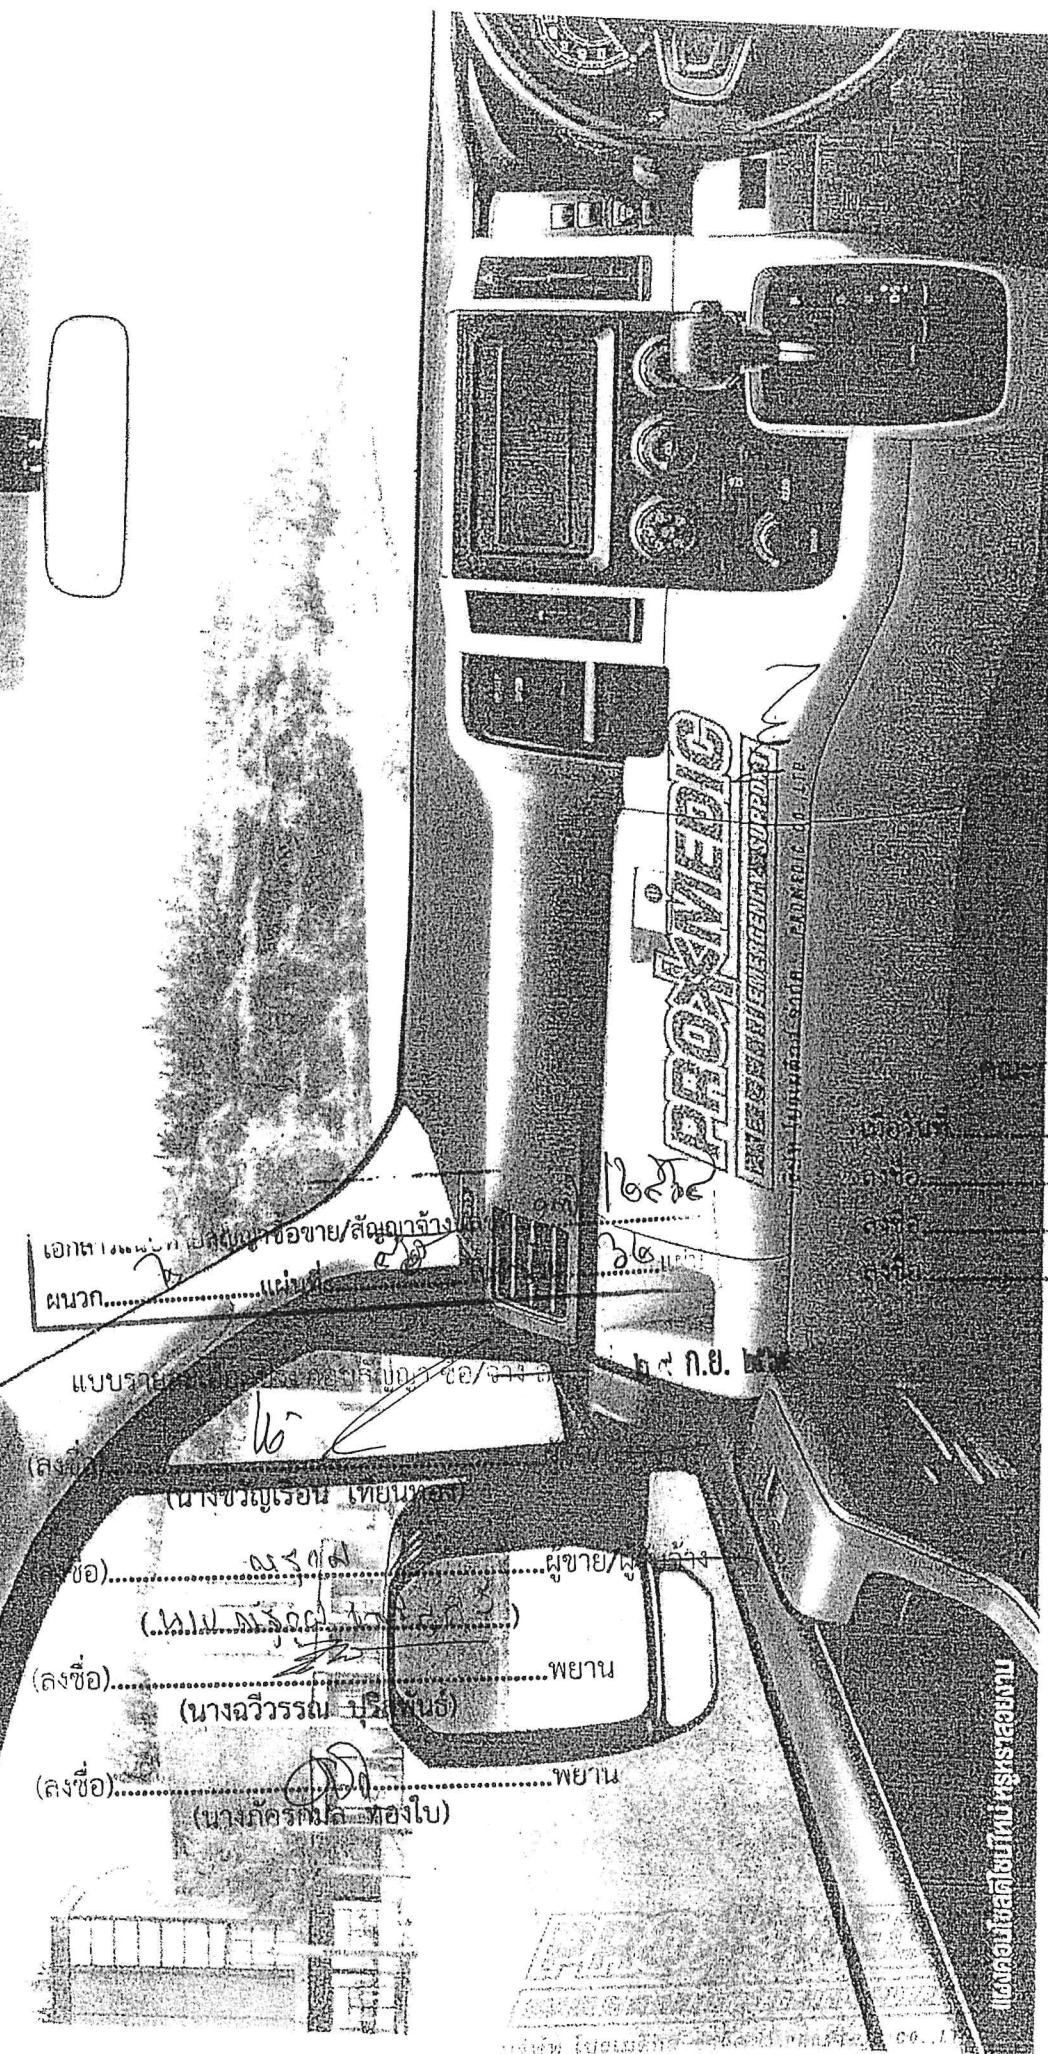

ผู้ที่เก็บของน้ำมือศรีสุรัส ลดาภิษัพพ์ ศรีสุรัส ผู้ดูแลน้ำสีและน้ำเงิน บริษัทสีและน้ำเงินไทยจำกัด

คณะกรรมการฯ ๖๖๖๖

เมื่อวันที่ ๖ ก.ย. ๒๕๖๖

ลงชื่อ..... ประจวบคีรีขันธ์ ภูมิพล ประจวบคีรีขันธ์

ลงชื่อ..... ภูมิพล ประจวบคีรีขันธ์ ภูมิพล ประจวบคีรีขันธ์

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ตัวอย่างสังเคราะห์งบดินทร์และงบดี้เสียได้ใช้ไปเท่านั้น
ก่อนพักร้อนจะสักจำนำของเดือนกันยายนครับ

ต่อไปนี้คืองบประมาณเบ็ดเตล็ด

(ลงชื่อ)

(นางสาวรุ่งเรือง เทียนทอง)

(ลงชื่อ)

ผู้ขาย/ผู้รับซื้อ
(นางสาวอรุณ เลิศศักดิ์)


(ลงชื่อ)

(นางสาวรุ่งเรือง พยาน
(นางสาวรุ่งเรือง พยาน)

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัมล ทองใบ)

บัญชีรายรับ-รายจ่ายต้อง^{๖๖๖๖}
(นางสาวรุ่งเรือง พยาน)
บานด์วันเดือนเชิงที่๖ ก.ย. ๒๕๖๖
บัญชีรายรับ-รายจ่ายต้อง^{๖๖๖๖}
๖๖๖๖

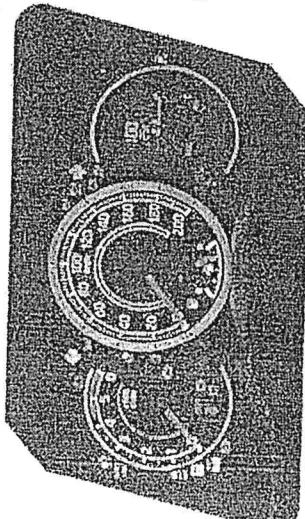


การซื้อขายมือสอง

คุณภาพดีเยี่ยม
มาตรฐานเดียวกับ
รถรุ่นใหม่!
ด้วยระบบ
ตรวจสอบรถเดิมทุกอย่าง

เครื่องยนต์ CD
2.8 ลิตร

เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด
พร้อมระบบ Sequential Shift
ที่ช่วยลดจราจรหายใจ
ทำให้รถมีความเร็วและแรงมากขึ้น

ระบบเบรกดีไซน์ใหม่ล่าสุด
ให้ประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม
ลดแรงกระแทกเมื่อเบรก

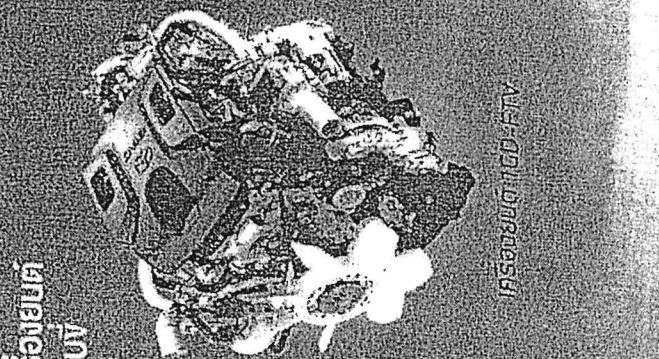

เครื่องยนต์ 2.8 V

ผู้ผลิต บริษัท Toyota Motor Corporation
ประเทศไทย จำกัด จำกัด จำกัด

ประเทศไทย

ผู้จัดจำหน่าย บริษัท PROMETIC CO., LTD.

SUSPENSION



(ลงชื่อ) แบบรา Wertburg ชุด ก. แบบรา Wertburg ชุด ก.
แบบรา Wertburg ชุด ก. แบบรา Wertburg ชุด ก.

(ลงชื่อ) แบบรา Wertburg ชุด ก. แบบรา Wertburg ชุด ก.

(ลงชื่อ) แบบรา Wertburg ชุด ก. แบบรา Wertburg ชุด ก.

(ลงชื่อ) แบบรา Wertburg ชุด ก. แบบรา Wertburg ชุด ก.

(ลงชื่อ) แบบรา Wertburg ชุด ก. แบบรา Wertburg ชุด ก.

(ลงชื่อ) แบบรา Wertburg ชุด ก. แบบรา Wertburg ชุด ก.

(ลงชื่อ) แบบรา Wertburg ชุด ก. แบบรา Wertburg ชุด ก.

(ลงชื่อ) แบบรา Wertburg ชุด ก. แบบรา Wertburg ชุด ก.

(ลงชื่อ) แบบรา Wertburg ชุด ก. แบบรา Wertburg ชุด ก.

(ลงชื่อ) แบบรา Wertburg ชุด ก. แบบรา Wertburg ชุด ก.

(ลงชื่อ) แบบรา Wertburg ชุด ก. แบบรา Wertburg ชุด ก.

(ลงชื่อ) แบบรา Wertburg ชุด ก. แบบรา Wertburg ชุด ก.

(ลงชื่อ) แบบรา Wertburg ชุด ก. แบบรา Wertburg ชุด ก.

(ลงชื่อ) แบบรา Wertburg ชุด ก. แบบรา Wertburg ชุด ก.

(ลงชื่อ) แบบรา Wertburg ชุด ก. แบบรา Wertburg ชุด ก.

(ลงชื่อ) แบบรา Wertburg ชุด ก. แบบรา Wertburg ชุด ก.

(ลงชื่อ) แบบรา Wertburg ชุด ก. แบบรา Wertburg ชุด ก.

เอกสารแนบท้ายที่ ๑/๒๔๙
จำนวน.....แบบรา Wertburg ชุด ก.
แบบรา Wertburg ชุด ก.
แบบรา Wertburg ชุด ก.
แบบรา Wertburg ชุด ก.

แบบรา Wertburg ชุด ก.
แบบรา Wertburg ชุด ก.
แบบรา Wertburg ชุด ก.

แบบรา Wertburg ชุด ก.
แบบรา Wertburg ชุด ก.

แบบรา Wertburg ชุด ก.
แบบรา Wertburg ชุด ก.

แบบรา Wertburg ชุด ก.
แบบรา Wertburg ชุด ก.

แบบรา Wertburg ชุด ก.
แบบรา Wertburg ชุด ก.

แบบรา Wertburg ชุด ก.
แบบรา Wertburg ชุด ก.

แบบรา Wertburg ชุด ก.
แบบรา Wertburg ชุด ก.

แบบรา Wertburg ชุด ก.
แบบรา Wertburg ชุด ก.

แบบรา Wertburg ชุด ก.
แบบรา Wertburg ชุด ก.

แบบรา Wertburg ชุด ก.
แบบรา Wertburg ชุด ก.

แบบรา Wertburg ชุด ก.
แบบรา Wertburg ชุด ก.

แบบรา Wertburg ชุด ก.
แบบรา Wertburg ชุด ก.

แบบรา Wertburg ชุด ก.
แบบรา Wertburg ชุด ก.

แบบรา Wertburg ชุด ก.
แบบรา Wertburg ชุด ก.

แบบรา Wertburg ชุด ก.
แบบรา Wertburg ชุด ก.

แบบรา Wertburg ชุด ก.
แบบรา Wertburg ชุด ก.
แบบรา Wertburg ชุด ก.
แบบรา Wertburg ชุด ก.

แบบรา Wertburg ชุด ก.
แบบรา Wertburg ชุด ก.
แบบรา Wertburg ชุด ก.

แบบรา Wertburg ชุด ก.
แบบรา Wertburg ชุด ก.

แบบรา Wertburg ชุด ก.
แบบรา Wertburg ชุด ก.

แบบรา Wertburg ชุด ก.
แบบรา Wertburg ชุด ก.

แบบรา Wertburg ชุด ก.
แบบรา Wertburg ชุด ก.

แบบรา Wertburg ชุด ก.
แบบรา Wertburg ชุด ก.

แบบรา Wertburg ชุด ก.
แบบรา Wertburg ชุด ก.

แบบรา Wertburg ชุด ก.
แบบรา Wertburg ชุด ก.

แบบรา Wertburg ชุด ก.
แบบรา Wertburg ชุด ก.

แบบรา Wertburg ชุด ก.
แบบรา Wertburg ชุด ก.

แบบรา Wertburg ชุด ก.
แบบรา Wertburg ชุด ก.

แบบรา Wertburg ชุด ก.
แบบรา Wertburg ชุด ก.

แบบรา Wertburg ชุด ก.
แบบรา Wertburg ชุด ก.

แบบรา Wertburg ชุด ก.
แบบรา Wertburg ชุด ก.

อีก壹代 ใหม่ ภาระน้ำหนักลดลง

สูงมาตรฐานใหม่ของยานยนต์ เดียวที่ระบบช่วงล่างแบบเดียว
ให้รูปแบบให้คุณมีได้ยิ่งกว่าที่เคยในทุกการเดินทาง

ASSIVE

SAFETY

ดูแลความปลอดภัย 3 ด้านหนึ่ง
ที่พร้อมปกป้องคุณในการเดินทาง
ด้วยกล้องด้านบนคันที่ 2 ตำแหน่ง
และผู้โดยสารตัวหน้าหัว 1 ตำแหน่ง

ACTIVE

SAFETY

โครงสร้างห้องโดยสารที่ถูกออกแบบมาเพื่อคุณ
ให้ช่วยเบี่ยงกันการชนห้องโดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกฤกษณา หล่อใบ)

Annular Frame Structure
โครงสร้างห้องโดยสารที่ถูกออกแบบมาเพื่อคุณ
ช่วยเบี่ยงกันการชนห้องโดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

ใช้สิทธิ์การ e-bidding

ผู้อւนท์ ๖ ก.ย. ๒๕๖๔

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ACTIVE

จ.เชียงราย

ไฟฟ้าชาร์จเมืองท่องเที่ยว
(Emergency Stop Signal)

ระบบป้องกันการขโมยรถ
(Immobilizer Alarm)

สั่งสั่งการทำงานเพื่อยกเว้นการห้องคราร์ม

ระบบช่วยออกกำลังกายเดินขึ้น
HAC (Hill-start Assist Control)

ป้องกันรถหลื่นบนทางลาด斜坡

เพิ่มความเร็วเมื่อเทียบกับรถแข่ง

ออกสารเคมีต้านแมลงสาบ

ในงานเกษตร



ดูแลความปลอดภัย 3 ด้านหนึ่ง

ที่พร้อมปกป้องคุณในการเดินทาง

ด้วยกล้องด้านบนคันที่ 2 ตำแหน่ง

และผู้โดยสารตัวหน้าหัว 1 ตำแหน่ง

ACTIVE

SAFETY

โครงสร้างห้องโดยสารที่ถูกออกแบบมาเพื่อคุณ
ช่วยเบี่ยงกันการชนห้องโดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

ผู้อุ่นท์ ๖ ก.ย. ๒๕๖๔

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

TRC

ระบบป้องกันล้อหมุนหยุด TRC (Traction Control)
ช่วยควบคุมล้อ-ป้องกันการเบิดห้องโดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ส่งไปยังศูนย์ศูนย์บริการของ Toyota

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/ตั้งบัญชีว่าง
 ผู้เสนอ.....
 ผู้ซื้อ.....
 จำนวน.....๖๖๘๘๘

(ลงชื่อ).....
 (นางขวัญเรือน เนียมพวง)

(ลงชื่อ).....
 (นายธนกร ใจดี)

(ลงชื่อ).....
 (นางจวีวรรณ บุรีสุขุม)

(ลงชื่อ).....
 (นางภัครกนล ทองใบ)

๖๖๘๘๘ ก.ย. ๒๕๖๔

ผู้จ่าย

ผู้รับค่าใช้จ่าย

บันทึก ใบเชมเมติก จันทร์

คณะกรรมการ e-bidding
 เมื่อวันที่.....๖ ก.ย. ๒๕๖๔
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....

สำเนาถูกต้อง

(นางภัครกนล ทองใบ)



FIRE EXTINGUISHER

We care for you like family

เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง 2A-2B
ยี่ห้ออิมพีเรียล ขนาด 5 ปอนต์

รับรองคุณภาพโดย МОК.332-2537



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง สามารถดับเพลิงไฟได้ทุกประเภท อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง 5 ก.ป. ๒๕๔๗
- ใช้หลักการดับเพลิงโดยการลดอุณหภูมิ และตัดปฏิกิริยาของไฟ เมื่อผงเคมีสูตรชั้นใหม่ไป接触จะไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาฟอกขาวรวมการระหว่างเชื้อเพลิง ความร้อน และออกซิเจน ทำให้ไฟดับลง

ความสามารถในการดับเพลิง เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้งสามารถดับไฟได้ 3 ประเภท คือ A, B, C กรณีการ

- CLASS A วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง และโลหะต่างๆ กรณีการ
- CLASS B วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน สารไวไฟทุกชนิด และแก๊สติดไฟต่างๆ
- CLASS C วัตถุเชื้อเพลิงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าตู้ ไฟฟ้าบ้าน ไฟฟ้าทุกชนิด

เหมาะสมสำหรับติดตั้ง : บ้านพักอาศัย และภายในรถยนต์



รับประกันคุณภาพ 5 ปี

ข้อควรระวัง หลังจากการใช้งาน นำยาดับเพลิงจะให้หมุดหรือไม่หมุดตาม บริษัท โปรดูมติดส์ จำกัด จ.กาญจนบุรี ๑๐๘๖๐๐ ดูแลรักษาอย่างดี ไม่เสียหาย

สำนักงานยกเว้นที่, จ.พากลังกระเมนาวใหญ่, บัวชัย ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท ชีวานิยมไทย จำกัด เป็นที่นี้ (มหาชน), บริษัท พ. ก.ช. จำกัด (มหาชน), บริษัท ให้อิฐรุ่ง จำกัด (มหาชน), ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน), บริษัท มนต์ศิลป์ จิรเวชร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ชาห์นอลห์ฟลาร์แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท แอด.พี. เทค. เทสท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท มิชูริช ออฟ จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด, ฯลฯ

1.1 CARRERA XL

Sell-Loadin~~g~~ stretcher

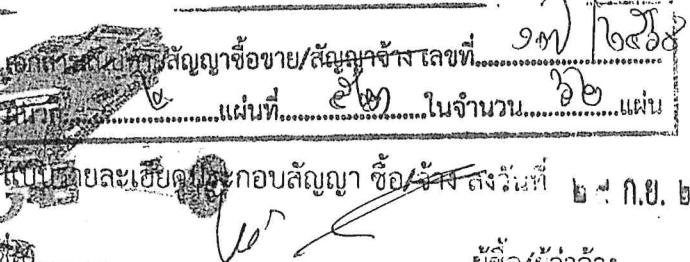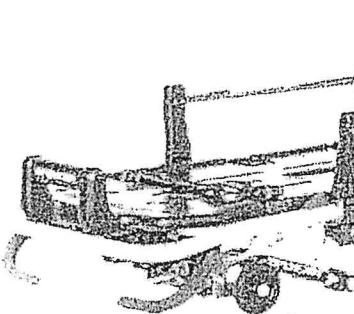

แบบแปลงเบี้ยคุณกอบลัมญา ชื่อ/ชัก ลงวันที่ ๔ ก.ย. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)ผู้ชื่อ/ผู้ว่าจ้าง

(นางขัญเรือน เทียนทอง) ต้องนองบูรณะแบบเบื้องต้น รุ่น Carrera XL

(ลงชื่อ)๔๕๐๗ ออกแบบบางเพื่อใช้งานกับช่าง/ผู้ช่วย/ผู้ช่วยพยาบาล

ทางเดินบ้านก็เป็นทางเดินที่คุ้มครองได้ดี ไม่ต้องห่วงจากภัย

(ลงชื่อ)๑๑๐๗ ลงทิพยาบาลได้ดีด้วยตัวเอง

(ลงชื่อ)๑๑๐๗ ทางเดินที่คุ้มครองได้ดี ไม่ต้องห่วงภัย

(นางสาววรรณ บุรีสพาร์บ)

(ลงชื่อ)๑๓ พ.ย. ๒๕๖๔

(นางก้ารกรรม ทองใบ)

- 1.1.1 • โครงสร้างเตียงห้าจากเหล็กซึ่งสามารถทำ CPR ได้ทันที
 - 1.1.3 • แผ่นรองด้วยผ้าป้ายจากพลาสติก Polyethylene สามารถเขัดหัวลักษณะความสะอาดได้
 - 1.1.3 • หนังหิ้งหลังสามารถปรับความซัมเมตต์ ๐ - ๗๐ องศา
 - สามารถปรับให้อยู่ในท่านอนศีรษะต่ำปลายเท้าสูง (Trendelenburg Anti-shock position)
 - มีล้อสำหรับเข็นขึ้นรถพยาบาล ๔ ล้อ โดยขาเดียวคู่หน้าเป็นแบบแป้นตาย (fixed wheels) ๒ ล้อ ขาคู่หลังเป็นแบบแป้นหมุน ๒ ล้อ
 - เส้นผ่าศูนย์กลางล้อขนาด ๑๘-๑๙ ซม. ซึ่งล้อที่มีขนาดใหญ่กว่าให้เข็นเดียวกันได้สะดวกแม้ญี่ปุ่นที่หันที่ห้ามส่วนต่อไป
 - เบรกล้อกั้นป้องกันเดียงให้ล้อติดตัวที่ล้อคู่หลัง
 - มีเสาน้ำเกลือ แบบปรับความสูงได้ ๑ เสา
- 1.1.5 • ผู้ใช้ป้องกันผู้ป่วยตกเตียง (Safe ban) ทั้ง 2 ด้าน พับเก็บได้ มีเบาะรองนอนผู้ป่วยลดความเสี่ยงของเตียง เนื่องหุ้มด้วยวัสดุ PVC สูงที่ความสะอาดได้ หรือสายรัดตัวผู้ป่วย ๒ เส้น
 - 1.1.6 • มีระบบป้องกันการกระตก (Anti-Capsizing system) คือเมื่อผู้ป่วยนั่งบริเวณปลายเตียง เตียงจะไม่กระดกหรือพลิกคว้า ขาเดียงคู่หน้าและคู่หลังแยกควบคุมอย่างอิสระ มีด้านลับคันบังคับขาเดียงให้พับราบไปกับฐานเตียง โดยแยกพับที่ละขา ด้านลับมีสีแตกต่างกันชัดเจน
 - 1.1.7 • เมื่อต้องเดินทางจากรถ ขาเดียงคู่หน้าและคู่หลังจะทำการออกใจโดยอัตโนมัติ (Automatic Loading Stretchers)
 - ผู้ผลิตผ่านเกณฑ์การทดสอบการชน ๑๐G ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน EN1865 และ EN1789
 - ผู้ผลิตได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO13485 และ ISO9001

สำเนาถูกต้อง

Technical data	
Length x Width	1970 mm x 570 mm (.10cm)
Weight	45 kg (.10kg)
Leading capacity	170 kg (.1kg)
Wheels	Ø160 mm (.10mm)
Height loading carriage wheel	68 cm
Side bars length	680 mm (.10mm) โบเมติกส์ จำกัด PROMETIC CO., LTD.
Side bars height	200 mm (.10mm)

คณะกรรมการ e-bidding

เมื่อวันที่ ๔ ก.ย. ๒๕๖๔

ผู้จัดประมูล บริษัท ก้ารกรรมการ


ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

1.2

SUPER BLUE HP

Universal head immobilizer

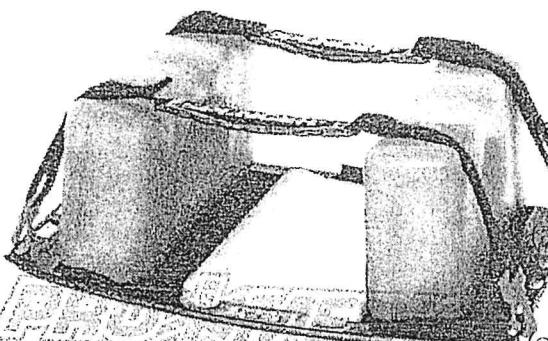

บริษัท ไบโอเมดิคส์ จำกัด PROMEDIC CO., LTD.

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัมภารัถ เลขที่ ๑๗ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒
ผู้ร่วม..... ๗ แผ่นที่ ๒๔ ในจำนวน ๓๒ แผ่น

- แบบรับสั่งโดยประกอบลักษณะ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๒
 1.2.1 ใช้สำหรับสือมติการระงับความเรื้อรังกับแผ่นกระดาษรองหลัง (Spinal Board) หรือเฟล็คติก (Pick Up Board) สำหรับชั่วคราว (long term).
 1.2.2 (หน้าหรือศีรษะที่มีสภาพเสื่อมทรุด) สามารถลาก-เขย่าได้กับชั่วคราว (long term).
 1.2.3 ใช้เพื่อยกหัวคู่ความสะอาดได้ทุกเชิงลับ
 ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๒ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
 (นาย พล ฤทธิ์ คงกระถาง X- Ray ดำเนินได้โดยชั่วคราว)
 (ลงชื่อ) พยาน

(นางฉวีวรรณ ปริสพันธ์)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางภัครกุมล ทองใบ)

หนอนประคองค้างห้ามศีรษะผ้าตาเจ็บ

- 1.2.1 เป็นเก้อนโฟม 2 ชั้น กรองสีเหลี่ยม จำกัดไฟฟ์ความหนาแน่นสูง (High density foam)
 1.2.2 ด้านนอกห้อนไฟฟ์หุ้มด้วยโพลีэтиลีนเคลือบเหลว (PE) เป็นวัสดุกันน้ำหล่อขึ้นรูปเป็นชั้บเดียวกันไฟฟ์มีรอยต่อหรือช่องกีดขวางห้องเหลวซึ่งม่านเจ้าไปปิดด้านใน จึงไม่ทำให้ไฟฟ์หลังสูงสูงของช่องโรค
 1.2.2 ด้านบนก้อนไฟฟ์มีร่องบาง 2 ร่อง สำหรับป้องกันสายรัดศีรษะ-ผ้าปูที่นอนหลังสีสันของช่องโรค
 1.2.2 ด้านล่างก้อนไฟฟ์มีแผ่นหูบานเทียบบีดประติด (Velcro) สำหรับยึดติดเข้ากับฐานรอง

ฐานรอง

คณะกรรมการ e-Board ๕

- ใช้สำหรับยึดติดหมอนประคองศีรษะเข้ากับแผ่นกระดาษรองหลัง (Spinal board) เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๒
 1.2.3 ผลิตจากพลาสติกทึบสีขาวรองป้องกันหูบานด้วยแบบประติด (Velcro) สำหรับยึดติดกับไฟฟ์ ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 1.2.3 มีสายสำหรับยึดตึงฐานรองกับแผ่นกระดาษรองหลัง ลงชื่อ..... กรรมการ
 สายรัด ลงชื่อ..... กรรมการ
 1.2.4 มีสายสำหรับรัดหัวใจ และคามัยบีดเด็บ จำนวน 2 เส้น สายรัดมีหัวกาวที่หนาแน่น แข็งแรง และมีแผ่นรองสับผู้สกัดบุ่มก้าวให้ยึดศีรษะได้กระชับมากยิ่งขึ้น

Technical data	
Base dimensions	445x260x15 mm
Pillow dimensions (1 piece)	260x20x155 mm
Hole for ear inspection	670 mm
Base weight:	700 ± 10g
One pillow weight	500 ± 30g
Overall weight	1,83 ± 0,3 kg
Materials	PE, PVC, Nylon

สำเนาถูกต้อง

(นาย พล ฤทธิ์ คงกระถาง ทองใบ)

น.ส. พล ฤทธิ์ คงกระถาง จำกัด PROMEDIC CO., LTD.

Rev.2 (18/07/2017)


UNCHECKED COPY - further revisions will be available on <http://www.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Isola Baganzo, P.R. Italia Tel. +39 0521541111 Fax. +39 0521541222www.spencer.it

Copyright © 2017 Spencer Italia S.r.l. All rights reserved. This document contains confidential information of Spencer Italia S.r.l. It is the sole property of Spencer Italia S.r.l. and must not be reproduced or disclosed without the express written consent of Spencer Italia S.r.l.

เอกสารแนบห้ายสัญญาซื้อขาย/สัมภารัณ์เลขที่.....	๑๗๐๙๒๔
ผู้ขาย.....	ผู้ซื้อ.....
ผู้รับ.....	ผู้จัดการ.....

1.3 B-BAK PIN MAX

Spinal board with Pin

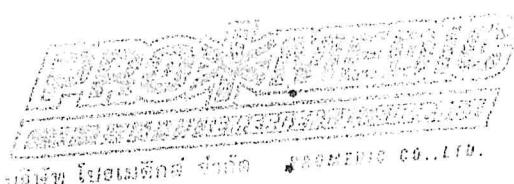

แบบชี้ช่องและอิมบูร์บะกอบลั่นญ่า ชุด/ชิ้น ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) ๖๖ (ลงชื่อ) ๖๖
ผู้จัดการ/ผู้ดูแล

(นางสาวนุรีรัตน์ เทียนทอง)

(ลงชื่อ) ๘๘๗๗ (ลงชื่อ) ผู้ขาย/ผู้รับซื้อ

(นางสาวนุรีรัตน์ เทียนทอง)

(ลงชื่อ) ๖๖ (ลงชื่อ) พยาน
(นางสาววรรณ บุรีพันธ์)

(ลงชื่อ) ๖๖ (ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวกฤกษ์ ทองใบ)

ชุดแผ่นรองหลังผู้ป่วย (Long Spinal Board)

1.3.1

- วัสดุทำจากพลาสติก บ้ำหนักเบา โครงสร้างแข็งแรง ทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้ และกันน้ำได้ ✓
- พับผิวเรียบทำให้ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค สะดวกต่อการทำความสะอาด และขอบที่โค้งมนทำให้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย
- รุปทรงที่ไม่หนาเทอะทะทำให้สะดวกต่อการจัดเก็บและใช้งาน
- พับผิวด้านในตัวออกแบบให้ลื่น เพื่อช่วยในการเลือบได้ดี

1.3.2

- มีช่อง 14 ช่อง อยู่ที่โดยรอบของแผ่นรองหลัง สำหรับสอดมือหัวใจกดด้าน สะดวกต่อการใช้งาน

1.3.2

- มีแกนสำหรับเก็บสายรัดตัวผู้บาดเจ็บ 8 แกน ทำจากพลาสติกหล่อเป็นชิ้นเดียวทึบแต่ไม่ร้าวหัก

1.3.3

- มีช่องสำหรับเก็บสายรัดตัวผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นเด็กอยู่กับตัวของแผ่นรองหลัง จำนวน 4 ช่อง

1.3.3

- ขนาดความยาว 184 ซม. ความกว้างช่วงลำตัว 40.5 ซม. ความสูงจากพื้นถึงช่องมืออ่อน 4.5 ซม.


1.3.4

- พับสูง 4.5 ซม. สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ 180 กิโลกรัม
- แสง X-ray สามารถผ่านได้ และสามารถทำ CPR ผู้ป่วยได้กับตัว
- ส่วนปลายของแผ่นกระดานรองหลัง มีช่องสำหรับใส่ป้ายชื่อหน่วยงานเพื่อป้องกันการสูญหาย
- ผู้ผลิตได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO 13485 และ ISO 9001

Technical data	
Dimensions (L x W x H)	1840 x 405 x 45 mm.
Material	PE
No. Handles	14 Point
No. Pin	8 Pin
Loading capacity	180 kg.
Weight	7 kg.

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกฤกษ์ ทองใบ)

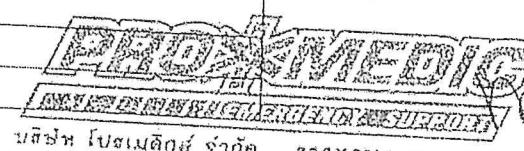

บริษัท โบโนเมติกส์ จำกัด PROMEDIC CO., LTD.

Rev.2 (25/08/2017)

UNCHECKED COPY further revisions will be available on <http://www.spencer.it>
Spencer Italia Srl - Salita Baganzza 1/P - Italia Tel. +39 0521.541111 Fax. +39 0521.541222

เอกสารนี้ออกขึ้นที่ ๕ ต.ป.๒ บ้านที่ ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๐ ประเทศไทย


ลงชื่อ.....

ลงชื่อ..... ประวิท วราวนครุกุ

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ..... ธรรมกานต์ วราวนครุกุ

STYLISH LUGGAGE STYLERS

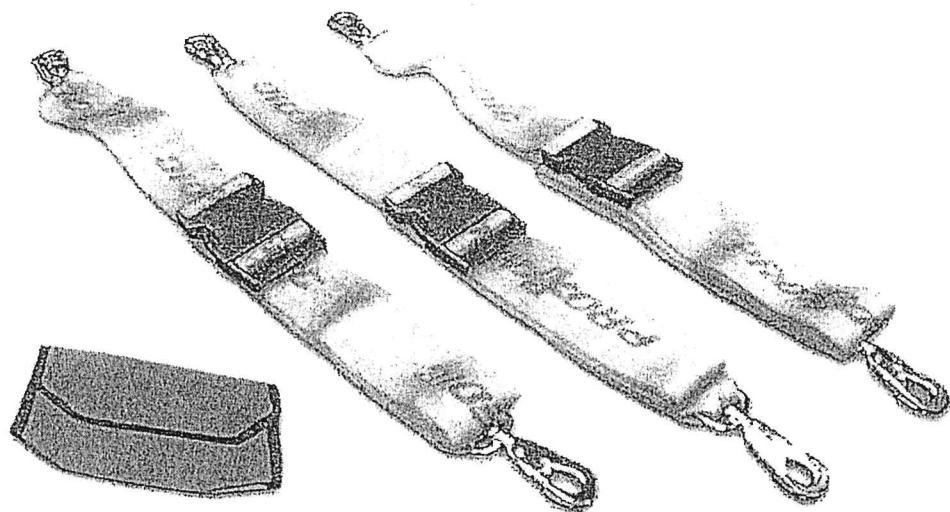

1.35 ✓

เข็มขัดรัดตัวผู้บาดเจ็บ

วัสดุ: Vinyl-coated polyester มีความเหนียว ทนทาน
ปลายทึบสองข้างมีตะขอเกี่ยว แบบลิ๊อกอัตโนมัติ

ตัวสามารถเกี่ยว กับ แบนพลาสติก ที่ช่องมือจับของแผ่นกระดานรองหลังได้
มีตัวลิ๊อกเข็มขัดแบบสวมเร็ว Instant snap-lock buckle ช่วยให้การนำไปต่ออย่างรวดเร็ว

สายเข็มขัดสามารถปรับให้ระดับกับร่างกายด้วยปุ่มกดที่ด้านหลัง ขนาด 90-130 cm
ผนวก..... แผ่นที่..... ๔๗ ในจำนวน..... ๑๖ แผ่น

ใบอนุญาตประกอบด้วย: เข็มขัด 3 เส้น

กรมป่าไม้อุบลราชธานี ใบแบบรายละเอียดประกอบสัญญาซื้อ/จ้าง ลงวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๔๘

(ลงชื่อ).....

(นางชัยพร ใจดี) ผู้จัดการฝ่ายขาย/ผู้รับจ้าง

บริษัท โปรเมดิค จำกัด PROMEDIC CO., LTD.

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นาย พล. ส. ใจดี) พยาน

(นางสาวรรณ บุริสพันธ์)


(ลงชื่อ).....

(นางกัลยา ห้องใหม่)

สำเนาถูกต้อง

PROMEDIC
(นางภัครกมล หอยเปน)

4.4 Ambu® Oval Plus Silicone Resuscitators

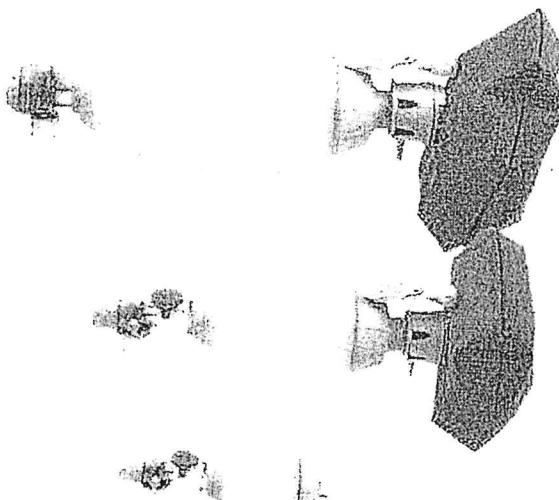

Key Benefits

- Reduced fatigue during manual ventilation
The silicone bag design ensures optimal user handling and support during extended ventilation. The bag has a smooth surface and grip properties. The hand strap features a wide gap between loops to reduce fatigue.
- Free positioning of the bag
The patient's neck with a swivel enables free positioning of the bag without removing the mask from the patient.
- Easy to clean and sterilize
The Ambu Oval Silicone resuscitator is easy to clean and sterilize. An effective procedure for cleaning and sterilization can be used, such as autoclaving at 134 °C.
- Low weight
Optimal usage during prolonged resuscitation during prolonged ventilation.

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาซื้อขายเดทที่.....
พนวก..... แผ่นที่..... ๙๗/๙ ในจำนวน..... ๑๖

ลงรายการและอีดประกอบสัญญาซื้อขาย/จ้าง ลงวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๘

Ambu® Oval Plus รุ่น IC (ไข่างข้าวหลើន) ให้เช่า/ผู้รับเช่า (ลงชื่อ) ผู้เช่า/ผู้รับเช่า

(ลงชื่อ) ๗๙๐๔ ผู้ขาย/ผู้รับเช่า
บริษัท ไพรเมติกส์ จำกัด (PROMERIC CO., LTD.)
ที่อยู่ ๑๓๐ หมู่ ๑๗ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๔๒๙๗๐๐๐ โทรสาร ๐๘๑-๖๔๒๙๗๐๐๑
(ลงชื่อ) นางสาววรรณ บุรีสพันธ์

Description
Ambu Oval Plus Silicone Resuscitator, after cleaning, sterilization and use, it must be stored in a dry place.
(ลงชื่อ) นางสาววรรณ บุรีสพันธ์

Features

The Ambu Oval Plus Silicone Resuscitator is designed for manual ventilation of patients. It features a soft, smooth silicone bag that provides a comfortable fit around the patient's nose and mouth. The handle is ergonomically designed for easy grip and control. The strap is adjustable and includes a quick-release buckle for easy removal.

PROMERIC CO., LTD.
PROMERIC CO., LTD.
บริษัท ไพรเมติกส์ จำกัด PROMERIC CO., LTD.

คณหกรรมการ e-bidding
เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๘
ลงชื่อ ประทานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ


สำเนาถูกต้อง

○ Ambu
(นางภัครกนล ทองใบ)

Specifications

	1.4.4	1.4.7	1.4.10
Weight	720 g	650 g	550 g
Patient weight	> 30 kg - 60 kg (adult)	> 20 kg - 40 kg (adult)	> 15 kg - 25 kg (adult)
Flow rate (volume)	1675 ml	693 ml	220 ml
Dimensions (length x diameter)	291 mm x 125 mm (11.45 in. x 5 in.)	245 mm x 99 mm (9.65 in. x 3.86 in.)	162 mm x 120 mm (6.38 in. x 4.72 in.)
Delivery rates (in and out)	150 ml/sec	150 ml/sec	150 ml/sec
Spine connector (inside)			
Delivery connector (inside)			
Expiration valve (for PEEP valve - optional)			
Delivery and back vent valve			
Operating temperature			
Storage temperature	-20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F) at humidity below 90% RH -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F) at humidity below 40% RH up to 100%	-20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F) at humidity below 90% RH -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F) at humidity below 40% RH up to 100%	-20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F) at humidity below 90% RH -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F) at humidity below 40% RH up to 100%

The adult version is available
with either a standard or a
pneumatic mechanism.

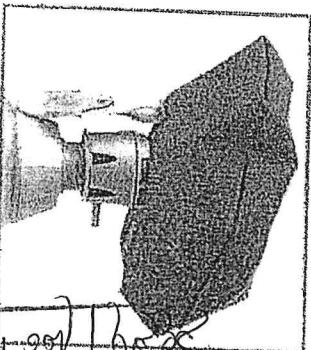

9011650

86

ในจำนวน.....

.....หน่วย.....

.....แบบ.....

.....ผู้ชื้อ/ผู้รับจ้าง

.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

.....พยาน

.....(นางสาววรรณ ปริสพันธ์)

.....(นางสาววรรณ ปริสพันธ์)

.....พยาน

.....(นางสาวกฤณล ทองใบ)

.....สำเนาถูกต้อง

.....(นางกฤณล ทองใบ)



คณะกรรมการ e-bidding ของ ใบเมเดกส์ จำกัด

PROMEDIC CO., LTD.

เมื่อวันที่..... ๕ ก.ย. ๒๕๖๓

ลงชื่อ..... ประชานกรนุชาร

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กิตติรัตน์

CE US: Rx only


Ambu A/S

Customer Support
Distributor Support
Customer Support

1-800-222-2222
800-222-2222
1-800-222-2222

SED

Extrication spine immobilization

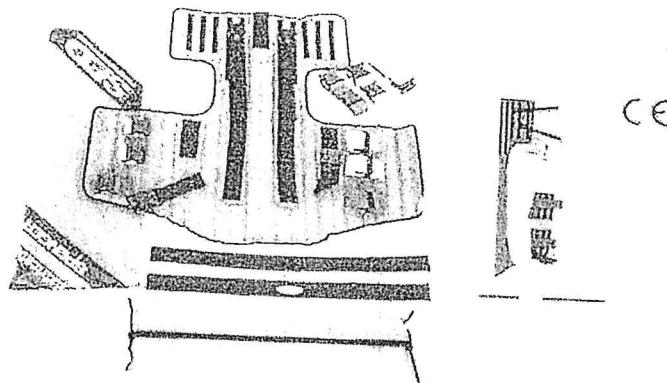

1. ✓ อุปกรณ์ดามหลังชนิดสัน (Kendrick Extrication Device: K.E.D.)

1. ✓ • สำหรับดามหลังผู้ได้รับบาดเจ็บที่ยังติดอยู่ในชานกรถ หรือใช้ตามกรณีฉุกเฉินกรณีผู้บาดเจ็บ เพื่อป้องกันกระดูกและป้องกันไม่ให้มีการบาดเจ็บเพิ่มเติม
1. ✓ • ภายในประกอบด้วยแท่งไม้เรียงต่อ กันเป็นแนว และหัวด้วยพลาสติก (PVC) สามารถบีบกันแน่นและของเหลวซึ่งผ่านได้ จึงล้างทำความสะอาดง่าย
1. ✓ • มีรูปทรงสอดคล้องกับร่างกายท่อนบน โดยมีส่วนที่ขึ้นอยู่กับมาโดยรัดส่วนศีรษะและส่วนลำคอไว้อีกด้วย
กระชับ มีรายละเอียดดังนี้:

1. 5.1 - ขนาดตัวเสื้อกางเกง สูง 83 ซม. / กว้าง 90 ซม.

1. 5.2 - เก็บชั้ดตัวผู้ป่วยพร้อมตัวถือแบบสามเร้า 3 เส้น โดยแต่ละเส้นมีสีแตกต่างกัน เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

1. 5.3 - สายรัดตัวข้า 2 เส้น, สายรัดหน้าผากและคาง 2 เส้น

1. 5.4 - บริเวณศีรษะมีสายรัดแบบปลอก (Velcro) สามารถติดสายรัดหน้าผากและคางของผู้บาดเจ็บ เอ็กเพรสบาร์เกยสกู๊ปเปอร์/สเมลต์วาร์เดนท์ ให้ดูภูมิคุ้มกัน ในจำนวน แผ่น

1. 5.5 - หนา 4 mm. น้ำหนัก 2 kg. น้ำหนักตัวผู้ป่วย 60 kg. แบบรายละเอียดบังคับบัญญัติ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๔ คณิตกรรมการ e-bidding

(ลงชื่อ).....	นางสาวลิรุณรัตน์ ใจดี	ผู้เช่า/ผู้รับ	ลงชื่อ.....	เมื่อวันที่..... ๕ ก.ย. ๒๕๖๔	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	(นางสาวลิรุณรัตน์ ใจดี)	เทียนทอง	ลงชื่อ.....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	(นายวิวัฒน์ พยาน)	ผู้เช่า/ผู้รับ	ลงชื่อ.....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	(นางสาววิวรรณ ปรีสพันธ์)	ผู้เช่า/ผู้รับ	ลงชื่อ.....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	(นางกัครกมล ทองใบ)	ผู้เช่า/ผู้รับ	ลงชื่อ.....	กรรมการ

Date: 18.07.2017.
UNCHECKED COPY further revisions will be available on <http://support.spencer.it>

(นางกัครกมล ทองใบ)

Spencer Italia Srl - Via Cavigliano, 10 - 20090 Cernusco sul Naviglio (MI) Tel. +39 0521 541111 Fax +39 0521 541222

www.spencer.it

Copyright. This document is property of SPENCER ITALIA srl and can be reproduced, stored and disclosed without the written approval of SPENCER ITALIA srl.

เอกสารแนบท้ายต่อบัญชีขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๙๗๑๖๘
ผู้ร่วม..... ผู้ที่..... จำนวน..... หน่วย.....

แบบรายละเอียดประกอบสัญญาซื้อ/ขาย ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
WEINMANN

(ลูกค้า)..... ผู้ซื้อ/ผู้ร่วม.....
(นางสาวเรือน เทียนทอง)


(ลงชื่อ)..... พญ.กิตติ์ คลินิกการแพทย์ชั้นนำ
(นางนรรดา ใจดี)..... อายุ.....

(ลงชื่อ)..... ศ.ดร. ประชานกรรมการ
(นางสาวรุณี ปริสพนธ์) อายุ.....

(ลงชื่อ)..... ดร. ภานุ ภูมิการ
(นางภัครกุล ทองใบ) อายุ.....

ACCUVAC Lite
Simple Strong - Simple Made Easy



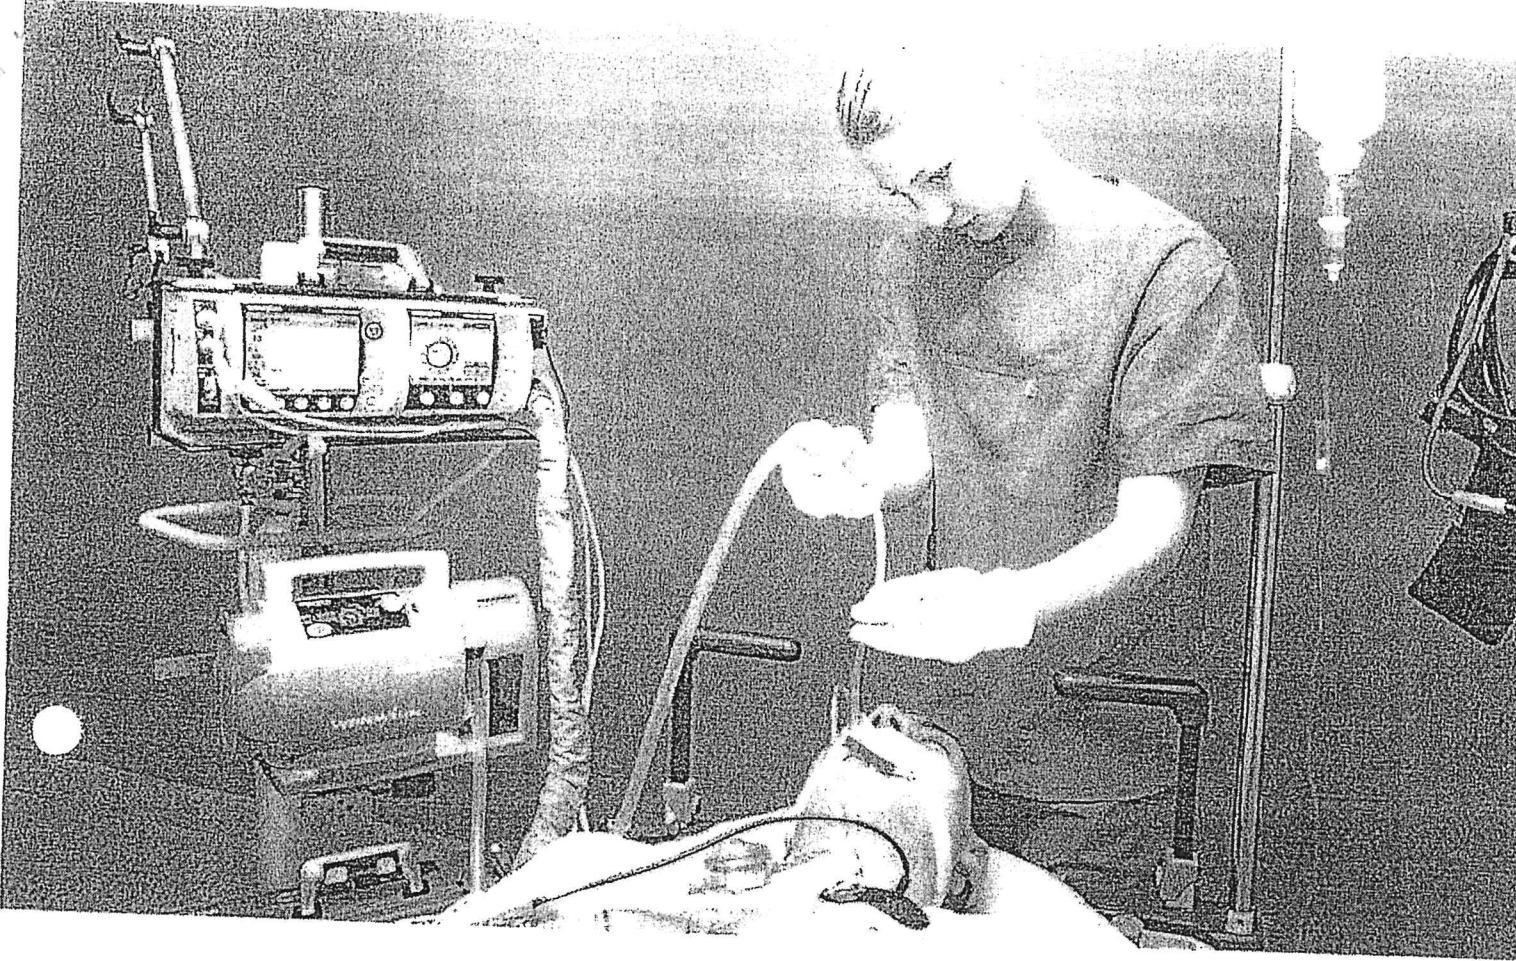

◎ Simply Strong – Suction Made Easy

In an emergency situation, the patient's survival depends on fast and effective suctioning. ACCUVAC has been the standard for airway suction for several decades, ensuring safe airways with suctioning of the patient's mouth and throat or endotracheal or bronchial suction. High suction capacity and simple operation guarantee fast and effective treatment in the shortest time, in the most cost-effective manner.

ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ

Broad Range of Uses, Flexible Operation

The negative pressure range of ACCUVAC Lite can be infinitely set and adjusted with the easy-to-use vacuum regulator. The range of settings allows the pump's use for babies, children and adults. In addition to suctioning in airway, ACCUVAC Lite can also create vacuum



เอกสารแนะนำถ่ายสัญญาช้อปขาย/สัมภาระจ้าง เลขที่ ๙๗ ก.ย. ๖๒๖๘
ผู้ขาย..... แผ่นที่ ๐๑ ในจำนวน ๐๖ แผ่น

Your Benefits คุณประโยชน์ มีดังนี้ จำกัด บริษัท พรอมเดค จำกัด PROMEDIC CO., LTD.

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอรุณ พิษณุโลก)

ผู้ขาย/ผู้รับซื้อ

(ลงชื่อ).....
(นายพัฒนา ใจดีรัตน์)

พยาน

(ลงชื่อ).....
(นางสาววรรณ บุรีสพันธ์)

พยาน

(ลงชื่อ).....
(นางสาวคริษณ ทองใบ)

พยาน




Intubation Circuit Use Pump Emergency Ventilation

..... ภูมิคุณต้อง



(นางสาวภูมิคุณ ทองใบ)

∅ ACCUVAC Lite

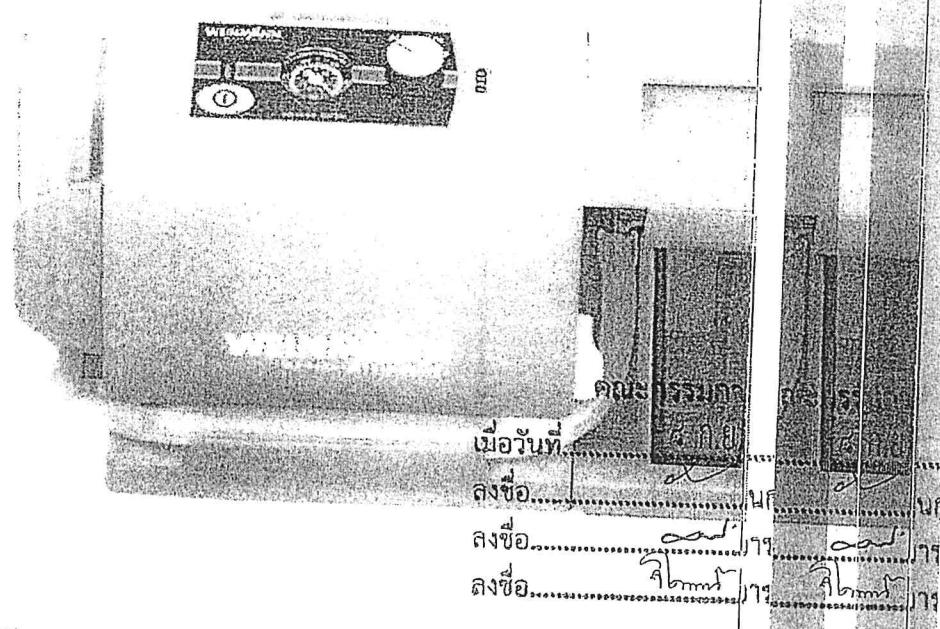

Convenient Operation, Broad Application Spectrum

- High-capacity suction of about 26 liters/minute at -0.8 bar (at device inlet)
- Infinitely adjustable vacuum setting to -0.8 bar with easy-to-use vacuum regulator
- Negative pressure can be read from gauge
- Safe suction of secretions by means of auto-clavable reusable secretions canister with disposable bacteria filter and flow restriction valve (available separately)
- With integrated bacteria filter

เอกสารแนบท้ายต่ำงๆอย่างดีที่สุด
ของไทย สำหรับการรักษาพยาบาลและศูนย์การแพทย์
โดย บริษัท โปรเมดิคอล จำกัด
จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

- Infinitely adjustable vacuum setting to -0.8 bar (at device inlet)
- With integrated bacteria filter

เอกสารแนบท้ายต่ำงๆอย่างดีที่สุด
ของไทย สำหรับการรักษาพยาบาลและศูนย์การแพทย์
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....

เอกสารแนบท้ายต่ำงๆอย่างดีที่สุด
ของไทย สำหรับการรักษาพยาบาลและศูนย์การแพทย์
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....

เอกสารแนบท้ายต่ำงๆอย่างดีที่สุด
ของไทย สำหรับการรักษาพยาบาลและศูนย์การแพทย์
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....

Ideal Operation in Everyday Medical Services

- Optimum accommodation (accommodation) in border on side of device
- One-handed release from vs. release from both sides of a button
- Compatible with existing Amsino existing Amsino
- Optional carrying bag, large a, suitable with a protective bag and/or shoulder bag and/or shoulder bag

เอกสารแนบท้ายต่ำงๆอย่างดีที่สุด
ของไทย สำหรับการรักษาพยาบาลและศูนย์การแพทย์
โดย บริษัท โปรเมดิคอล จำกัด
จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

- Endotracheal tube holder and tracheostomy tube holder
- Inflation of vacuum splints (vacuum splints)

เอกสารแนบท้ายต่ำงๆอย่างดีที่สุด
ของไทย สำหรับการรักษาพยาบาลและศูนย์การแพทย์
โดย บริษัท โปรเมดิคอล จำกัด
จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

เอกสารแนบท้ายต่ำงๆอย่างดีที่สุด
ของไทย สำหรับการรักษาพยาบาลและศูนย์การแพทย์
โดย บริษัท โปรเมดิคอล จำกัด
จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

เอกสารแนบท้ายต่ำงๆอย่างดีที่สุด
ของไทย สำหรับการรักษาพยาบาลและศูนย์การแพทย์

เอกสารแนบท้ายต่ำงๆอย่างดีที่สุด
ของไทย สำหรับการรักษาพยาบาลและศูนย์การแพทย์
(ลงชื่อ).....