

สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบล/แขวง ท่าเกษม อำเภอ/เขต เมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยนายวิโรจน์ งามสุนทรรัตน์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ที่ ๑๐๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท บี แอนด์ บี โปรดักต์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๘๖/๗๖ ซอยรามคำแหง ๑๘๖ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยนายจรรุญ เจริญราษฎร์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ และมอบอำนาจให้ นายสมชาย ทองอัม ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๕๕๕๘๑๑๓๒๘๕ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ (สาม) รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นราคาทั้งสิ้น ๙๖,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖,๓๑๓.๐๘ บาท (หกพันสามร้อยสิบสามบาทแปดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ และผนวก ๒

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๓.๑ สำเนาใบเสนอราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๓.๒ สำเนารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ,แคตตาล็อก จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)

(นายวิโรจน์ งามสุนทรรัตน์)

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย ทองอัม)



ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้ง หีบห่อ หรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สระแก้ว ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออก หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุ ดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้อง จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดั้งเดิม ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอย ให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ)

(นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา)

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย ทองอม)



ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๔,๘๒๕.๐๐ บาท (สี่พันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็น หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกัน อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้น ข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด ทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุ ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของ ล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง มามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญา นี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้อง ค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อ สิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๓ (สาม) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญาผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ)

(นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา)

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย ทองอม)



ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าส่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าส่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าส่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว


(ลงชื่อ)



ผู้ซื้อ

(นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา)

(ลงชื่อ)

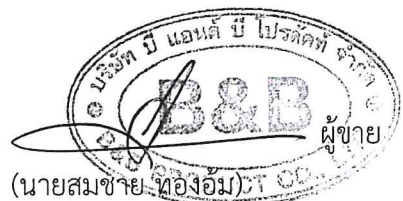

(นายสมชาย ทองอ้อม)

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อไม่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(นายวิโรจน์ งามสุนทรธรรมา)
(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(นายสมชาย ทองอัม)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวพิรญาณ์ พิมพ์พาคำ)

บันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา

สัญญาเลขที่ : CNTR-00126/66

โครงการเครื่องซึ่งนำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง, เครื่องวัดความดันโลหิต
ชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน, รถเข็นทำแผล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
-----------------	---	-------------	---------------------------------

รายละเอียดวงเงินทำสัญญา

อ้างอิงใบขอซื้อเลขที่ 66-45-00223-5410800-00001

ชื่อเจ้าหน้าที่ บริษัท บี แอนด์ บี โปรดักท์ จำกัด

ประเภทเจ้าหน้าที่ นิติบุคคลจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม

ที่อยู่ เลขที่ 86/76 ซอยรามคำแหง 186 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

วันที่ทำสัญญา 17 มกราคม 2566

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 30 วัน

วันที่ดำเนินการ 18 มกราคม 2566

วันที่สิ้นสุดสัญญา 16 กุมภาพันธ์ 2566

เหตุผลและความจำเป็น
ที่ดำเนินการก่อนวันที่
ทำสัญญา

วงเงินทำสัญญา 96,500.00 บาท ชำระเงิน 1 งวด

เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง

จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)

เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด

0.00 บาท

อัตราค่าปรับ ร้อยละ 0.20 ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

หลักประกันสัญญา เป็นเงินสด.....

รายละเอียดโครงการ

ชื่อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตน)

วันที่ 17 ม.ค. 2566

ลงชื่อ.....พยาน

(นางฉวีวรรณ บุรีสพันธ์)

วันที่ 17 ม.ค. 2566



ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นายคมกช นอญ)

วันที่ 17 ม.ค. 2566

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวพิรญาณ์ พิมพ์คำ)

วันที่ 17 ม.ค. 2566

สัญญาเลขที่ : CNTR-00126/66

รายละเอียดการจ่ายเงิน

งวดที่	เงินขอเบิก	มูลค่าสินค้า	เงินประกันผลงาน	หักเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	96,500.00	96,500.00	0.00	0.00	96,500.00
ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 96,500.00 บาท					
รวม	96,500.00	96,500.00	0.00	0.00	96,500.00

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นายวิโรจน์ งามสุคนธ์ธนา)

วันที่..... 17 ม.ค. 2565

ลงชื่อ.....พยาน
(นางฉวีวรรณ บุริสพันธ์)

วันที่..... 17/ม.ค. 2565 /



ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(นายสมเกียรติ นอนรัมย์)

วันที่..... 17 ม.ค. 2565

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวพิรณณ์ พิมพ์คำ)

วันที่..... 17 ม.ค. 2565

บริษัท บี แอนด์ บี โปรดักต์ จำกัด

B&B PRODUCT CO., LTD.

86/76 ซอยรามคำแหง 186 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรสาร 02 0198076 เลขผู้เสียภาษี 0105558113285

ใบเสนอราคา

เรื่อง เสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์

วันที่ 4 มกราคม 2566

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย คุณลักษณะเฉพาะพร้อมรูปแบบ

บริษัท บี แอนด์ บี โปรดักต์ จำกัด มีความยินดีขอเรียนเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์

ซึ่งมีรายการละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	จำนวนเงิน
1.	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบคอแขน	66,500.00	1 เครื่อง	66,500.00
2.	ยี่ห้อ AND รุ่น TM-2657P ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่นนำเข้าโดย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๑/๒๕๖๖			
2.	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง	19,000.00	1 เครื่อง	19,000.00
	ยี่ห้อ T-Scale รุ่น M301D			
3.	รถเข็นทำแผล (สแตนเลส)	11,000.00	1 คัน	11,000.00
	แบบรายละเอียดประกอบโดย/สัญญาจ้าง เลขที่ 17 ม.ค. 2565			
	(ลงชื่อ) นายวิโรจน์ งามสอนธรรมา			
	(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง			
	ราคาสินค้า			90,186.92
	ภาษี 7%			6,313.08
	(เก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) (ลงชื่อ) พยาน			96,500.00

ราคาสินค้าที่เสนอนี้กำหนดขึ้นราคา 120 วัน กำหนดส่ง ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อให้ท่านโปรดพิจารณาโดยทางบริษัท (ลงชื่อ) พยาน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสที่จะได้ร่วมทำการค้ากับท่าน (นางสาวพริดาภา งามสอนธรรมา)



(นายสมชาย ทองอ้อม)

ผู้เสนอราคา

092-494-6262

สำเนาถูกต้อง

(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)

นักบริหารงานการคลัง

รถเข็นทำแผล

.....

- 1.ความต้องการ รถเข็นทำแผล มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
- 2.วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้สำหรับบรรทุก อุปกรณ์ในการทำแผลผู้ป่วย
- 3.คุณสมบัติทั่วไป

3.1 ทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม

3.2 มีล้อสะดวกในการเคลื่อนย้าย

3.3 มีชั้นสำหรับวางของใช้ต่าง ๆ 2 ชั้น

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....๑๑/๒๕๖๖.....
ผนวก.....๒.....แผ่นที่.....๑.....ในจำนวน.....๑๑.....แผ่น

แบบรายละเอียดประกอบสัญญาซื้อ/จ้าง ลงวันที่ 17 ม.ค. 2566

4. คุณสมบัติทางเทคนิค

4.1 โครงทำด้วยเหล็กสเตนเลสมีพื้น 2 ชั้น

4.2 ชั้นบนมีที่วางขวดน้ำยาประมาณ 7 ขวด มีที่วางลิ้นชัก 3 ชั้น

4.3 ชั้นล่างมีลิ้นชัก 2 ช่อง (ลงชื่อ).....พยาน

4.4 มีราวสเตนเลสกันก้นของหล่น 3 ด้าน ทั้ง 2 ชั้น (นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)

4.5 ติดล้อขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ทั้ง 4 ล้อ (นางสาวพริษาณ์ พิมพ์คำ)

4.6 มีที่จับสำหรับเข็นเคลื่อนที่

4.7 ขนาดของตัวรถ กว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 17 x 29 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว รั้งน้ำหนักต้อง

4.8 อุปกรณ์ประกอบตัวรถ

4.8.1 TRAY สเตนเลสพร้อมฝาปิด 1 ใบ

4.8.2 อ่างกลมสเตนเลส 1 ใบ

4.8.3 ถังสเตนเลสพร้อมฝาปิด 1 ใบ

(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)
นักบริหารงานการคลัง

5.เงื่อนไขเฉพาะ

5.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสารติมาก่อน

5.2 รับประกันคุณภาพ 1 ปี



รถเข็นทำแผล

ตัวรถทำจากสแตนเลส มีขนาด 17x29x32 นิ้ว มีที่จับเข็นสะดวก

ใส่ล้อ 3 นิ้ว 4 ล้อ เคลื่อนที่สะดวก

มี 2 ลื่นชัก และชั้นวางของ 2 ชั้น พร้อมขอบกันทั้ง 3 ด้าน

มีช่องใส่ขวดน้ำยา 7 ช่อง ช่องใส่กระปุกสำลี 3 ช่อง

อุปกรณ์ มี TRAY พร้อมฝาปิด 1 ชุด, ถังกลมสแตนเลส, ถังสแตนเลสพร้อมฝาปิด 1 ชุด

ผนวก.....แผ่นที่.....ในจำนวน.....แผ่น

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ชื่อ/จ้าง ลงวันที่ 17 ม.ค. 2563



(ลงชื่อ)

นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รักษา

ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(นางสาววิมล งามสุคนธ์รักษา)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางฉวีวรรณ ปรีสพันธ์)


(ลงชื่อ)

(นางสาวพิรณณ์ ทิมพาสัก)

พยาน

สำเนาถูกต้อง

(นางฉวีวรรณ ปรีสพันธ์)
นักบริหารงานการคลัง

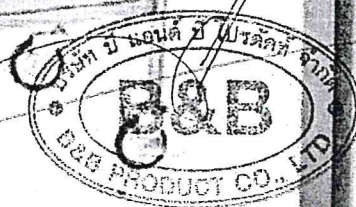

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง

1. ความต้องการ

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูงใช้สำหรับโรงพยาบาลทั่วไป

2. วัตถุประสงค์การใช้งาน

สำหรับช่างน้ำหนักและวัดส่วนสูง

3. คุณสมบัติทางเทคนิค

- 3.1 พิกัดน้ำหนัก 250 กิโลกรัม ค่าความละเอียด (0.1 kg)
- 3.2 มีหน้าจอแสดงผลแบบ 2 จอ หน้า-หลัง เพื่อสะดวกในการใช้งาน จอแสดงผลด้านหน้าขนาดตัวเลข LCD สีดำ ขนาดสูง 25 mm จอแสดงผลด้านหลังขนาดตัวเลข LCD สีดำ สูง 14 mm
- 3.3 มีอุปกรณ์วัดส่วนสูงได้ระหว่าง 89-204 cm
- 3.4 มีโปรแกรม ZERO (เคลียร์หน้าจอเป็นศูนย์) TARE (หักค่าน้ำหนักภาชนะ), HOLD (ล็อกค่าน้ำหนัก) BMI (แสดงค่าดัชนีมวลกายเป็นตัวเลข และแสดงค่าเป็นแถบกราฟ)
- 3.5 มีระบบปิดเครื่องเองอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน (ประหยัดพลังงาน)
- 3.6 พื้นที่ตั้งน้ำหนักไม่น้อยกว่า 350X355 mm
- 3.7 มีล้อสามารถเคลื่อนย้ายสะดวก และพื้นปรับความสมดุลได้
- 3.8 สามารถใช้กับ ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V. หรือ ถ่านขนาด AA 6 ก้อน

4.เงื่อนไขเฉพาะ

4.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

4.2 รับประกันคุณภาพ 1 ปี

4.3 ผู้เสนอราคามีหนังสือแสดงถึงตัวตนจากหน่วยงานภายในประเทศมาแสดง
ผนวก.....แผนที่.....
เพื่อสะดวกในการบริการหลังขาย

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ชื่อ/ชื่อลงวันที่ 17 มี.ค. 2563



.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) นายวิโรจน์ งามสุดนธิรัตน์

.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) (นางสาวศิริวรรณ น้อยงาม)

.....พยาน
(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)

.....พยาน
(นางสาวพิชญ์ญา พิมพ์คำ)

สำเนาถูกต้อง


(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)
นักบริหารงานการคลัง

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดความสูง และคำนวณค่า BMI ระบบดิจิทัล (2 จอ) " T-Scale " รุ่น M301D

- พิกัดน้ำหนัก 250 kg
- ค่าละเอียด 100 g (0.1 kg)
- จอภาพ 2 จอ (หน้า-หลัง) เพิ่มความสะดวกต่อการใช้งาน
จอด้านหน้า ตัวเลข LCD สีดำ สูง 25 mm (มี Backlight เรืองแสง)
จอด้านหลัง ตัวเลข LCD สีดำ สูง 14 mm (มี Backlight เรืองแสง)
- อุปกรณ์วัดส่วนสูง : 89 - 204 cm (ความละเอียด 1 mm)
- โปรแกรม : ZERO (เคลียร์ค่าหน้าจอบริการศูนย์).

TARE (หักค่าน้ำหนักภาชนะ), HOLD (ล็อกค่าน้ำหนัก)
BMI (แสดงค่าดัชนีมวลกายเป็นตัวเลขและแสดงค่าเป็นผลประกอบ) ในจำนวน... ๑๑... แผ่น

- ปิดเครื่องอัตโนมัติ เพื่อประหยัดพลังงาน (Auto-off)
- พื้นที่ชั่งขนาด : 355 x 360 mm
- มีล้อ เคลื่อนย้ายสะดวก
- สามารถปรับระดับความละเอียดได้
- อุปกรณ์มาตรฐาน RS-232C เชื่อมต่อกับ Computer, Printer
- พลังงาน : "AA" Drycells 6 ก้อน (หรือเลือกใช้ AC Adapter)
- น้ำหนักประมาณ : ~ 11.0 kg
- ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย
- รับประกันคุณภาพ 2 ปี

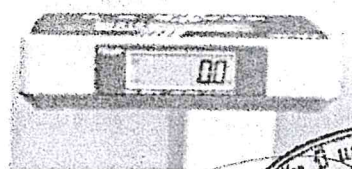

สำเนาถูกต้อง

(นางฉวีวรรณ บุรีสพันธ์)
ผู้จัดการแผนกคลัง


(Updated 17 มิ.ย 2565)

จัดทำโดย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน

1. ความต้องการ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน เหมาะสำหรับใช้วัดความดันโลหิต ในหน่วยงานที่มีผู้ป่วยมาก โดยการสอดแขนเข้าเครื่องวัดพร้อมกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวก็สามารถวัดความดันโลหิตได้พร้อมพิมพ์ผลอัตโนมัติ แสดงค่าความดันโลหิต และสามารถคัดกรองผู้ป่วยที่มีอัตราการเต้นของหัวใจไม่สม่ำเสมอได้ (IHB)
3. คุณลักษณะทั่วไป
 - 3.1. สามารถวัดความดันโลหิตและชีพจรอัตโนมัติชนิดสอดแขน พร้อมเครื่องพิมพ์ผล
 - 3.2. ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด มีน้ำหนักไม่เกิน 6 กิโลกรัม
 - 3.3. สามารถสอดแขนเพื่อวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ายหรือแขนขวา โดยใช้ Cuff แบบวงกลม
 - 3.4. จอภาพแสดงผล เป็นตัวเลข LED สีแดง ขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 - 3.5. เครื่องพิมพ์ผลด้วยกระดาษความร้อน (Thermal) สามารถเลือกรูปแบบการพิมพ์ได้ไม่น้อยกว่า 4 รูปแบบ
เช่น การใส่รูปภาพสัญลักษณ์ของหน่วยงาน, แสดงเลขหมายรุ่น, แสดง QR code, เลขที่.....๑๑/๒๕๖๖
 - 3.6. เครื่องพิมพ์ผลด้วยกระดาษความร้อน (Thermal).....๒.....แผ่นที่.....๕.....ในจำนวน.....๑๑.....แผ่น
 - 3.7. ใช้กับไฟฟ้า 100 - 240 โวลต์ 50 - 60 เฮิร์ตซ์
แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ชื่อ/จังหวัดวันที่ 17 ม.ค. 2565
 - 3.8. มีที่รองรับปลายแขนขณะทำการวัด.....นายวิโรจน์ งามสุนทรธนา.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
 - 3.9. มีระบบควบคุมการบีบของที่รัดแขนอัตโนมัติตามขนาดของแขน เพื่อให้ปริมาณลมที่สูบลมอัดมา
เหมาะสมตามขนาดแขน.....(นางสาวศิริวรรณ พิมพ์คำ).....
(ลงชื่อ).....พยาน
 - 3.10. ที่รัดแขนเป็นชนิดยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เชื้อดื้อยาได้ (Antibacterial arm cuff cover) ในวัสดุสังเคราะห์
 - 3.11. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แห่ง
สหรัฐอเมริกา (FDA) พร้อมแนบเอกสารยืนยัน.....(นางสาวศิริวรรณ พิมพ์คำ).....
สำเนาถูกต้อง
 - 3.12. มีเอกสารรับรองการผ่านการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวง
สาธารณสุข พร้อมแนบเอกสารยืนยัน.....(นางฉวีวรรณ บุรีสัมพันธ์).....
นักบริหารงานการคลัง
4. คุณลักษณะเฉพาะ
 - 4.1. ใช้เทคนิคการวัดแบบ Oscillometric
 - 4.2. สามารถแสดงค่าความดันได้ตั้งแต่ 0 - 299 มิลลิเมตรปรอท

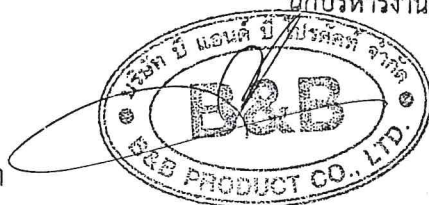

4.3. สามารถวัดค่าความดันได้ SYS ตั้งแต่ 20 - 280 มิลลิเมตรปรอท, DIA ตั้งแต่ 20 - 200 มิลลิเมตรปรอทและ
ค่าชีพจรได้ตั้งแต่ 30 - 240 ครั้งต่อนาที

4.4. เครื่องสามารถวัดค่าได้แม่นยำสูงโดยมีค่าความคลาดเคลื่อนของค่าความดันโลหิต +/- 3 มิลลิเมตรปรอท
และค่าชีพจรไม่เกิน +/- 5%

4.5. สามารถตั้งเวลา วันที่ เดือน และปีจนถึงปี ค.ศ.2050

4.6. สามารถใช้งานเครื่องเพียงกดปุ่มเดียว (One button operation)

4.7. มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน (FAST STOP) กรณีต้องการยกเลิกการวัดความดัน

4.8. สามารถเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต RS-232C หรือ Bluetooth (Optional)

4.9. เครื่องสามารถพิมพ์ผลออกมาเป็น QR Code และสามารถสแกนผลที่ได้ส่งเข้า Smart Phone ผ่าน
แอปพลิเคชันได้ทันที

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๑/๒๕๖๒
ผนวก.....๒.....แผ่นที่.....๒.....ในจำนวน.....๑๑.....แผ่น

5. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

5.1. สายไฟ AC

แบบรายละเอียดประกอบสัญญาซื้อ/จ้าง ลงวันจันทร์ 7 ม.ค. 2565

5.2. กระดาษบันทึก

นายวิโรจน์ งามคุณธรรณา ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง 10 ม้วน

5.3. บล็อกเชน

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 1 ผืน

5.4. เครื่องสำหรับวงเครื่อง มีเสาเดียว มีล้อ 4 ล้อ (ผลิตภายในประเทศ)

จำนวน 1 ตัว

5.5. แก้วสำหรับผู้ป่วยนั่ง

(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)

จำนวน 1 ตัว

5.6. คู่มือการใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(นางสาวพรญาณ์ พิมพ์คำ)

จำนวน 1 เล่ม

6. เงื่อนไขเฉพาะ

6.1. เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาริตที่ใดมาก่อน

6.2. ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพเครื่องเป็นเวลา 1 ปี


6.3. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศมาแสดง

เพื่อการรับรองบริการหลังการขาย (โดยมีหนังสือหลักฐานมาแสดง ณ วันเสนอราคา)

6.4. ผู้เสนอราคามีหนังสือรับรองมีอะไหล่แท้จากโรงงานผู้ผลิตสำหรับซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 5 ปี

สำเนาถูกต้อง

(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)
นักบริหารงานการคลัง

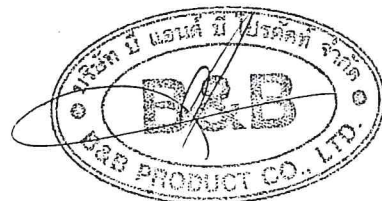

A&D
A&D Medical


Fully Automatic

Fully Automatic Blood Pressure Monitor TM-2657P

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่...๑๑/๒๕๖๖...
คนวก...๒...แผ่นที่...๓...ใบ...๑๑...แผ่น


Clinically
Validated

แบบรายละเอียดประกอบสัญญาจ้าง วันที่ 17 ม.ค. 2563

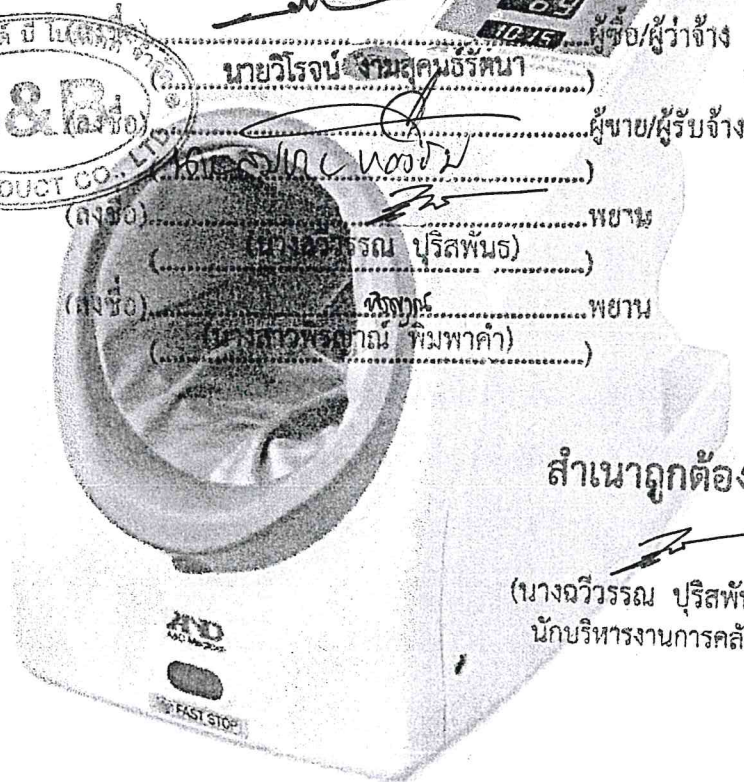

สำเนาถูกต้อง


(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)
นักบริหารงานการคลัง

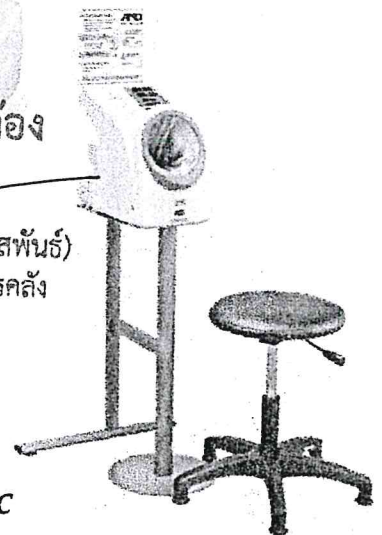

*Accurate measurement with sophisticated automatic
cuff size adjustment mechanism*

Easy operation

Small footprint

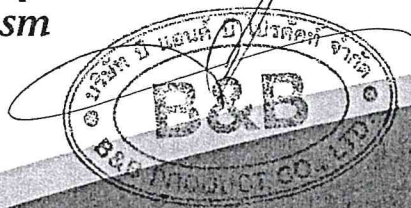



CE 0123

A&D
A&D Medical
<http://www.aandd.jp>

Technology You Can Trust

Application & Point of use

The TM-2657P is the latest model in the range of freestanding fully automatic blood pressure monitors such as the acclaimed previous models, whose ground-breaking designs have been well received and have created many new applications, places of use, and new markets. The main reasons for the high reputation of the previous models are their fast and accurate measurement, compact profile, ease-of-use, and durability. The new TM-2657P has been superbly styled in Japan, having a slim and compact shape with increased printout speed, and offers a diversified selection for connectivity. The TM-2657P helps expand market potential, not only for hospitals, medical clinics and health check-ups, but also for corporate wellness in the workplace, pharmacy services, and fitness centers.

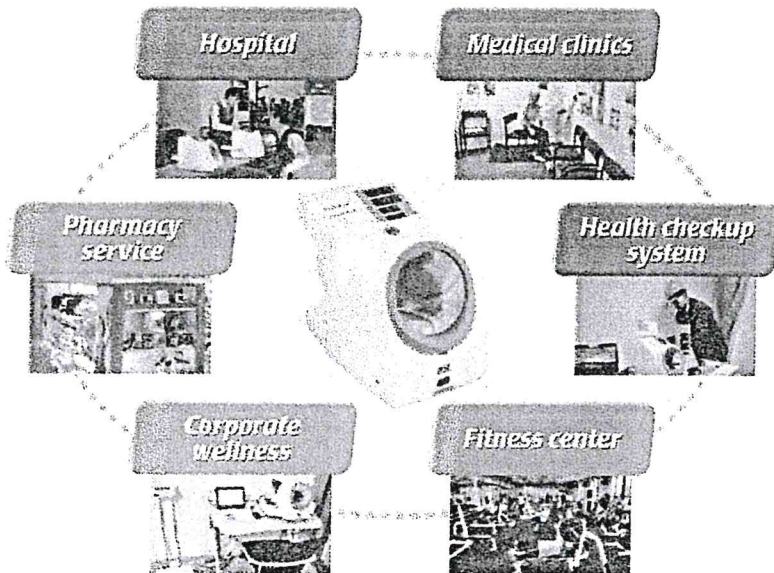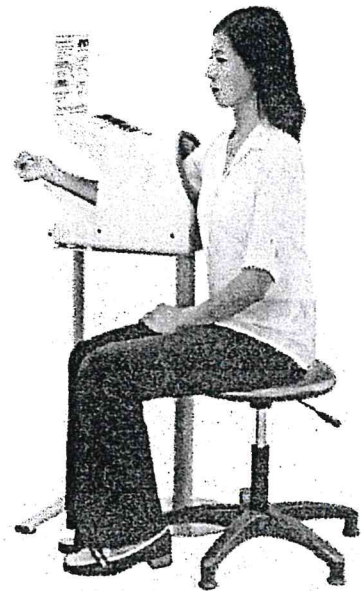


Accurate measurement at hospitals, other medical clinics...

In some hospitals, patients can take their own blood pressure measurement using a fully automatic monitor before seeing the doctor. This "self triage" saves the patients' time and lightens the workload for the medical staff. And with modern validated BP monitors, the readings are as accurate as if the medical staff took the measurement.

Pick an arm, any arm

Dual design allows the users to measure with either arm.

Ease of use removes measurement strain
The slim upright design of TM-2657P enables the ideal arm position to make precise blood pressure measurements.

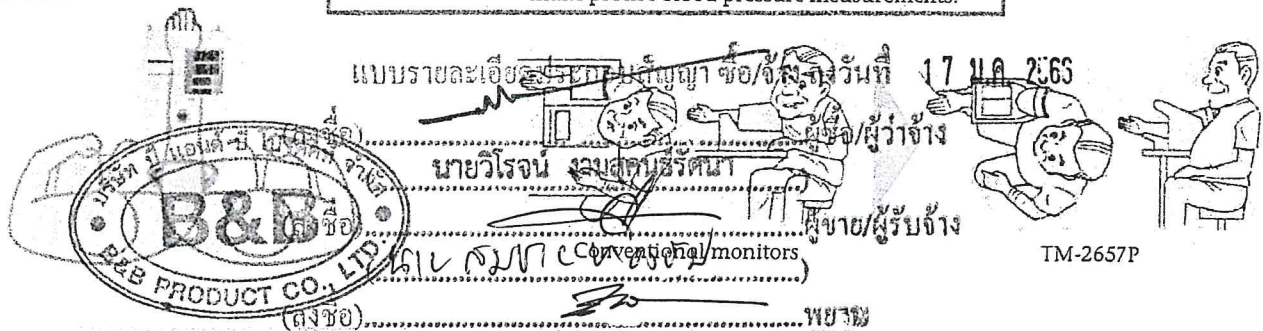

Barrier-free design



It is convenient for pregnant women, patients with back problems and patients in wheelchairs.

Slender design


Slim design allows the users to put it against a wall or on a desk/counter top without taking up too much space.

One button operation

START / STOP button located in the middle of the unit allows simple measurement with either hand.

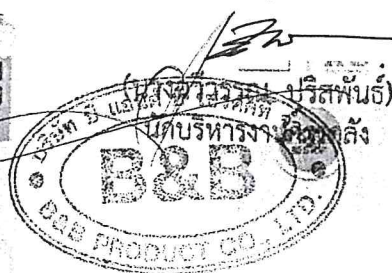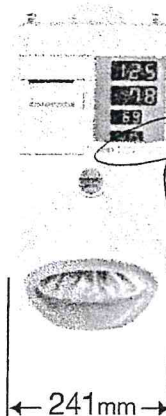

"Torque Controlled Belt drive Method" (TCBM) adopted in our cuff fastening method

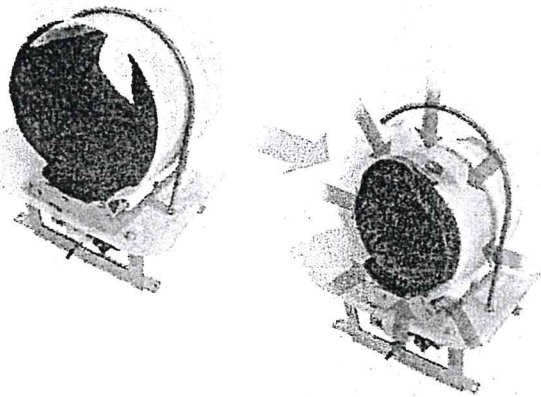

Accurate and reliable oscillometric measurement of blood pressure on the upper arm relies on correct cuff/bladder dimensions and pressure applied.

The A&D Torque Controlled Belt drive Method (TCBM) holds the upper arm perfectly with the essential personalized cuff circumference, the same measurement preparation carried out by clinical nurses.


This optimum ergonomic design enables the users to measure their blood pressure with accuracy, ease, safety, high speed and comfort.

Antibacterial arm cuff cover (included as standard)

Newly developed antibacterial arm cuff cover has been introduced to the TM-2657P in response to advice from medical experts.

It is possible for users to measure blood pressure in a clean environment.

Antibacterial arm cuff cover




Optional extension communication board (RS-232C, Bluetooth)

- TM-2657-01-EX with MiniDIN 8pin and D-Sub 9pin
- TM-2657-03-EX with D-Sub 9pin
- TM-2657-05-EX with D-Sub 9pin and Bluetooth

The user can take control of the data and automate the operation. It can connect to PC, card readers, barcode readers, etc..

The user can also connect TM-2657P with other Bluetooth enabled devices when using TM-2657-05-EX.

(Please consult with A&D's dealers about the compatibility.)

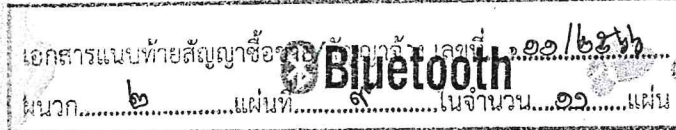

Continuum
CERTIFIED

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ชื่อ/ห้าง ลงวันที่ 17 ม.ค. 2558

ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

นายวิโรจน์ งามสุดหรรณ

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

Reliable thermal printer with open head design

This allows easy paper roll replacement and also helps to avoid possible paper jams.

Various print-out formats

TM-2657P provides the users with print-outs (original mark, pictures, messages, etc.) with your ad, pharmacy name, etc..

A large print area is reserved for the advertisement. The printout can also include measurement information from other devices including some personal scales.

(Please consult with A&D's dealers about the compatibility.)



Other printing examples


Name	17 Oct. 2015	22:18
SYS	130	mmHg
DIA	96	mmHg
PUL	71	/min.



"IHB" (Irregular Heart Beat)

The symbol for "IHB" is printed when a very slight vibration such as shivering or shaking is detected.

(Note: This is for warning purpose only. A&D recommends contacting a physician if you see this symbol (IHB) frequently.)

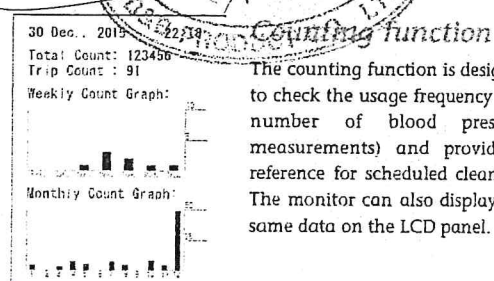


The counting function is designed to check the usage frequency (the number of blood pressure measurements) and provide a reference for scheduled cleaning. The monitor can also display the same data on the LCD panel.

TM-2657P


Options & Accessories



Carrying case



External input/output
unit RS 2ch
REF: TM-2657-01-EX



External input/output
unit RS 1ch
REF: TM-2657-03-EX



External input/output
unit RS+Bluetooth
REF: TM-2657-05-EX

สำเนาถูกต้อง



A&D AUSTRALASIA PTY. LTD.

32, New Street, Renamon, South Australia 5001 AUSTRALIA
Telephone (61)(8)8301-8100 Fax (61)(8)8352-7400

A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED

509 Udyog Vihar Phase V Gurgaon-122 016, Haryana, India
Telephone: (91)(124)471-5555 Fax: (91)(124)471-5509

A&D ENGINEERING, INC.

1750 Automation Parkway, San Jose, CA 95131 U.S.A.
Telephone: (415) 408-0663-5333 Fax: (415) 408-0663-0112

A&D INSTRUMENTS LIMITED


Unit 24/25 Blacklands Way Abingdon Business Park,
Abingdon, Oxon OX14 1DY UNITED KINGDOM
Telephone: [44] (1235) 350420 Fax [44] (1235) 550455
(Authorized Representative Established in the European Community)

บริษัท บีแอนด์บี โปรดักท์ จำกัด

86/76 ซอยรามคำแหง 186 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทร 092-494-6262

โต๊ะวางเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ

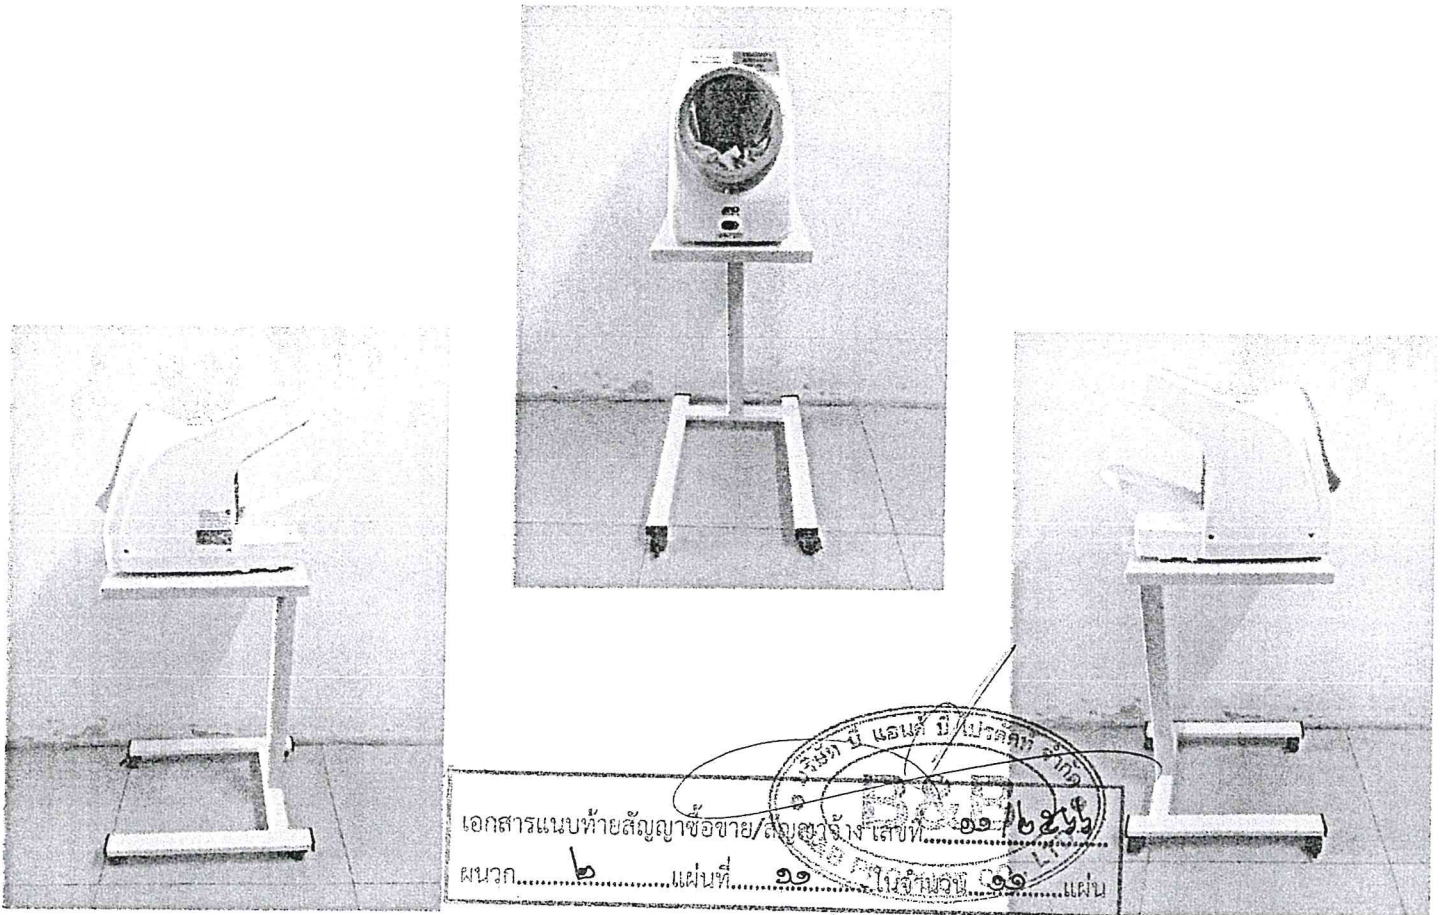

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๐๙/๒๕๖๕
ผนวก... ๒ ...แผ่นที่... ๑๑ ...ในจำนวน... ๑๑ ...แผ่น

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ซื้อ/จ้าง ลงวันที่ 17 ม.ค. 2565



(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
นายวิโรจน์ งามสุดนธิธนา
(ลงชื่อ).....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวพิชญาน์ พิมพ์คำ)

สำเนาถูกต้อง

(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)
นักบริหารงานการคลัง