

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน:สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

วัน/เดือน/ปี: ๕ เมษายน ๒๕๖๕

หัวข้อ: ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วินิจฉัย)
จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(วินิจฉัย)
จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน ๙,๐๐๘,๐๐๐.- บาท (เก้าล้านแปดพัน-
บาทถ้วน) ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ของโครงการพัฒนาศักยภาพ หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการรองรับ
การดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตามเอกสารแนบ)

Link ภายนอก : ๑. <http://www.trathealth.com/index.php?name=newstender&category=๑>

๒. <http://www.oic.go.th/infocenter๒๗/๒๗๓๓/#>

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางสาวปราณทิพย์ ทศรัตน์ปรียากุล)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง




(นายบัญชา สรรพโส)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางสาวอุทัย อ่อนภู)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



ประกาศจังหวัดตราด

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วินิจฉัย) จำนวน ๒ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....

จังหวัดตราด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วินิจฉัย) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการที่ ๑ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๑,๒๕๐,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๓,๗๕๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) สำหรับ ๑) โรงพยาบาลคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ๒) โรงพยาบาลบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด และ ๓) โรงพยาบาลแหลมฉบัง ตำบลแหลมฉบัง อำเภอแหลมฉบัง จังหวัดตราด รายการที่ ๒ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๕,๑๓๘,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) สำหรับโรงพยาบาลคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๘๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านแปดพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	จำนวน	๓	เครื่อง
๒. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA	จำนวน	๑	เครื่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

/ ๖. มีคุณสมบัติ...

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดตราด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.trathealth.com หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๓๙-๕๑๑๐๑๑ ต่อ ๔๔๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายณรงค์ เทพเสนา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๙/๒๕๖๕

การซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วินิจฉัย) จำนวน ๒ รายการ

ตามประกาศ จังหวัดตราด

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

จังหวัดตราด ซึ่งต่อไปเรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

- | | | | |
|---|-------|---|---------|
| ๑. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่
น้อยกว่า ๓๐๐ mA ขับเคลื่อนด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้า | จำนวน | ๓ | เครื่อง |
| ๒. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่
น้อยกว่า ๓๐๐ mA | จำนวน | ๑ | เครื่อง |

พัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อ
แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขาย
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

/๒. คุณสมบัติ...



๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ายรายอื่นทุกราย
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้ายทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
- ๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ



๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
 - (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
- (๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
 - (๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
 - (๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
 - (๔.๓) กรณีมอบอำนาจสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ (ถ้ามี)
- (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
- (๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

/(๓) รายการพิจารณาที่ ๑...



(๓) รายการพิจารณาที่ ๑ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA ขั้วเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

(๓.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๓.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) รายการพิจารณาที่ ๒ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA

(๔.๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔.๒) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๔.๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๕) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๕.๑) สำเนาหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

(๕.๒) กรณีเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศต้องมีเอกสารรับรองประกอบ การนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)



๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
๑. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ๒. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัลไม่น้อยกว่า ๓๐๐mA ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

/๔.๘ คณะกรรมการ...



๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำความผิดอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิดดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือ เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ จังหวัด

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA โดยใช้หลักประกัน อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๒๕๖,๙๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟท์ นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

/กรณีที่ผู้ยื่น...

๖.๒.๑.๑.๒.๑ ข้อเสนอแนะด้านเทคนิค (กรณีการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า) (น้ำหนักร้อยละ ๔๐) ประกอบด้วย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครังนี้

- | | |
|---|-----------|
| (๑) คุณสมบัติของหลอดเอกซเรย์ | ร้อยละ ๑๐ |
| (๑.๑) มี Anode Heat Storage Capacity ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ HU | ร้อยละ ๑๐ |
| (๒) คุณสมบัติชุดเสาและแขนยึดหลอดเอกซเรย์ | ร้อยละ ๒๐ |
| (๒.๑) มีระบบถ่วงให้แขนยึดหลอดอยู่ในสภาพที่สมดุลและหยุดนิ่ง | ร้อยละ ๑๐ |
| (๒.๒) แขนยึดหลอดเอกซเรย์สามารถหมุนรอบแกนยึดหลอดได้ดี | ร้อยละ ๑๐ |
| (๓) ชุดควบคุมระบบขับเคลื่อน | ร้อยละ ๑๐ |
| (๓.๑) Collimator | ร้อยละ ๕ |
| (๓.๒) Calculated dose | ร้อยละ ๕ |

๖.๒.๑.๑.๒.๒ บริการหลังการขาย (น้ำหนักร้อยละ ๓๐) ประกอบด้วย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครังนี้

- | | |
|--|-----------|
| (๑) แผนเพื่อการซ่อมบำรุงหลังการรับประกันความชำรุดบกพร่อง | ร้อยละ ๑๐ |
| (๒) ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง | ร้อยละ ๑๐ |
| (๓) การรับรองว่ามีอะไหล่ขายในราคาท้องตลาด | ร้อยละ ๑๐ |

๖.๒.๒ รายการพิจารณา คือ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ที่ติดตั้งไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA

- | | |
|--|------------------------------|
| (๑) ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) | กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ |
| (๒) บริการหลังการขาย | กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ |
| (๓) ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆกำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ | |

๖.๒.๒.๑ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคาและเกณฑ์อื่น

- | | |
|---------------|-----------------------|
| โดย เกณฑ์ราคา | กำหนดน้ำหนักร้อยละ ๓๐ |
| เกณฑ์อื่น | กำหนดน้ำหนักร้อยละ ๗๐ |

๖.๒.๒.๑.๑ เกณฑ์ราคา มีค่าอ้างอิงการให้คะแนนดังนี้

ราคา	คะแนน
ต่ำกว่าราคากลางน้อยกว่าร้อยละ ๑๐	๓๕ คะแนน
ต่ำกว่าราคากลางร้อยละ ๑๐ ถึง ร้อยละ ๒๐	๗๐ คะแนน
ต่ำกว่าราคากลางมากกว่าร้อยละ ๒๐	๑๐๐ คะแนน


*ราคากลางเครื่องละ ๕,๑๓๘,๐๐๐.-บาท จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๕,๑๓๘,๐๐๐.-บาท

(ห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๖.๒.๒.๑.๒ เกณฑ์อื่น ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| ๖.๒.๒.๑.๒.๑ ข้อเสนอแนะด้านเทคนิค | กำหนดน้ำหนักร้อยละ ๔๐ |
| ๖.๒.๒.๑.๒.๒ บริการหลักการขาย | กำหนดน้ำหนักร้อยละ ๓๐ |
| รวมเท่ากับ | ร้อยละ ๗๐ |

/๖.๒.๒.๑.๒.๑ ข้อเสนอ...

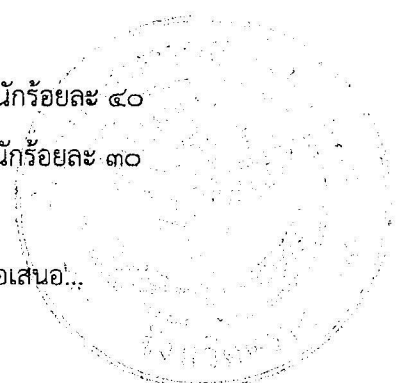

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเข้าหรือตราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้จังหวัดตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ จังหวัดจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่จังหวัดได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

๖.๒ ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๖.๒.๑ รายการพิจารณา คือ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

- | | |
|---|------------------------------|
| (๑) ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) | กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ |
| (๒) บริการหลังการขาย | กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ |
| (๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆกำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ | |

๖.๒.๑.๑ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคาและเกณฑ์อื่น	
โดย เกณฑ์ราคา	กำหนดน้ำหนักร้อยละ ๓๐
เกณฑ์อื่น	กำหนดน้ำหนักร้อยละ ๗๐

๖.๒.๑.๑.๑ เกณฑ์ราคา มีค่าอ้างอิงการให้คะแนนดังนี้


ราคา	คะแนน
ต่ำกว่าราคากลางน้อยกว่าร้อยละ ๑๐	๓๕ คะแนน
ต่ำกว่าราคากลางร้อยละ ๑๐ ถึง ร้อยละ ๒๐	๗๐ คะแนน
ต่ำกว่าราคากลางมากกว่าร้อยละ ๒๐	๑๐๐ คะแนน

*ราคากลางเครื่องละ ๑,๒๕๐,๐๐๐.-บาท จำนวน ๓ เครื่อง เป็นเงิน ๓,๘๗๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๖.๒.๑.๑.๒ เกณฑ์อื่น ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| ๖.๒.๑.๑.๒.๑ ข้อเสนอด้านเทคนิค | กำหนดน้ำหนักร้อยละ ๔๐ |
| ๖.๒.๑.๑.๒.๒ บริการหลักการขาย | กำหนดน้ำหนักร้อยละ ๓๐ |
| รวมเท่ากับ | ร้อยละ ๗๐ |

/๖.๒.๑.๑.๒.๑ ข้อเสนอ...

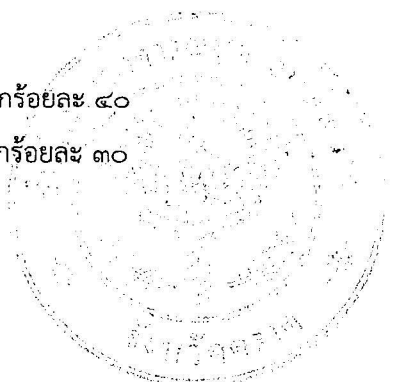

๖.๒.๒.๑.๒.๑ ข้อเสนอแนะด้านเทคนิค (กรณีการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA) (น้ำหนักร้อยละ ๔๐) ประกอบด้วย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้

- | | |
|--|-----------|
| (๑) คุณสมบัติของหลอดเอกซเรย์ | ร้อยละ ๑๕ |
| (๑.๑) ความสามารถในการปรับหมุนหลอดเอกซเรย์ | ร้อยละ ๕ |
| (๑.๒) เครื่องสามารถทำงานด้วยแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูง | ร้อยละ ๑๐ |
| (๒) คุณสมบัติหลอดเอกซเรย์ | ร้อยละ ๕ |
| (๒.๑) หลอดเอกซเรย์มีความสามารถในการจุมความร้อนได้สูง | ร้อยละ ๕ |
| (๓) คุณสมบัติของแผ่นรับภาพเอกซเรย์ | ร้อยละ ๒๐ |
| (๓.๑) แผ่นรับภาพเอกซเรย์สามารถแปลงข้อมูลภาพด้วยรังสีเอกซเรย์เป็นดิจิตอลที่รายละเอียดภาพสูง | ร้อยละ ๕ |
| (๓.๒) มีความสามารถในการนำส่งสัญญาณภาพแบบไร้สายด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง | ร้อยละ ๑๐ |
| (๓.๓) แผ่นรับภาพมีน้ำหนักเบาสะดวกต่อการใช้งาน | ร้อยละ ๕ |

๖.๒.๒.๑.๒.๒ บริการหลังการขาย (น้ำหนักร้อยละ ๓๐) ประกอบด้วย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้

- | | |
|--|-----------|
| (๑) แผนเพื่อการซ่อมบำรุงหลังการรับประกันความชำรุดบกพร่อง | ร้อยละ ๑๐ |
| (๒) ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง | ร้อยละ ๑๐ |
| (๓) การรับรองว่ามีอะไหล่ขายในราคาท้องตลาด | ร้อยละ ๑๐ |

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

/๖.๕ ในการตัดสิน...

๖.๕ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่า จะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือว่า การยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อจังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญา ตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพดที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพดลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพดนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

/(๔) หนังสือค้ำประกัน...

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัด จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง


ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่ จังหวัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้ได้ดังเดิมภายใน ๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของโครงการพัฒนาศักยภาพ หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลั่ง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของโครงการพัฒนาศักยภาพ หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลั่ง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเท่านั้น

/๑๑.๒ เมื่อจังหวัด...

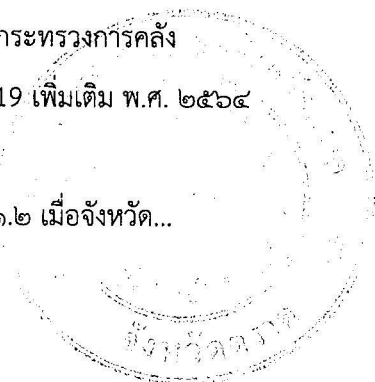

๑๑.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ฝ่าฝืนปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว






ราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รายการที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
๑.	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	๓ เครื่อง	๑,๒๙๐,๐๐๐.-	๓,๘๗๐,๐๐๐.-
รวมเป็นเงิน (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)				๓,๘๗๐,๐๐๐.-

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายสุรัชย์ เจียมกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).......... กรรมการ (ลงชื่อ).......... กรรมการ
(นายสุราวดี บุญฤทธิ์) (นางสาวพัทธนันท์ พิศกลาง)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลบ่อไร่

(ลงชื่อ).......... กรรมการ (ลงชื่อ).......... กรรมการ
(นางสาวพนาวลัย ธรรมบริสุทธิ) (นายรุ่งอรุณ นิรันดร์เรือง)
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลแหลมงอบ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลคลองใหญ่

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
.....

๑. ความต้องการ

เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA ชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แบบ High Frequency Inverter Generator จำนวน ๑ เครื่อง

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นเครื่องเอกซเรย์ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปในสถานที่ที่ต้องการได้สะดวก ถ่ายภาพทางรังสีวิทยา ได้ทุกส่วนของร่างกาย

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกโดยใช้มอเตอร์ขับเคลื่อน

๓.๒ สามารถใช้พลังงานในการถ่ายภาพทางรังสีวิทยาและขับเคลื่อนจากแบตเตอรี่และสามารถ
อัดประจุไฟฟ้าได้จากกระแสไฟฟ้าสลับ ๒๒๐-๒๔๐ V. ๕๐ Hz.

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงและชุดควบคุมการถ่ายภาพรังสี (Generator Controller)

๔.๑.๑ ระบบกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงเป็นชนิด High Frequency Inverter type ความถี่ ๕๐-๖๐ kHz
แบบ Cordless สามารถเอกซเรย์ได้จากพลังงานแบตเตอรี่

๔.๑.๒ มีพลังงานในการถ่ายเอกซเรย์ไม่น้อยกว่า ๓๒ kW

๔.๑.๓ ควบคุมด้วยระบบ Microprocessor พร้อมระบบ Anatomical Programs ที่สามารถ
บันทึกใหม่ได้ไม่น้อยกว่า ๗๒ ค่า

๔.๑.๔ สามารถปรับค่า kV ได้ โดยค่าต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๔๐ kV ค่าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ kV
ปรับได้ step ครึ่งละ ๑ kV

๔.๑.๕ สามารถปรับค่า mAs ได้ต่ำสุดไม่มากกว่า ๐.๓๒ mAs และค่าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๒๐ mAs

๔.๑.๖ มี Hand Switch สำหรับควบคุมการถ่ายภาพรังสี

๔.๑.๗ ใช้กับไฟฟ้าขนาด ๒๒๐ - ๒๔๐ V. ๕๐ Hz.

๔.๒ หลอดเอกซเรย์ (X-Ray Tube)

๔.๒.๑ หลอดเอกซเรย์เป็นแบบ Rotating Anode Tube.


๔.๒.๒ มีขนาดของ Target Angle ไม่มากกว่า ๑๖ องศา

๔.๒.๓ มี Focal Spot ขนาดเล็กไม่ใหญ่กว่า ๐.๗ mm. มี Focal Spot ขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า
๑.๓ mm.

๔.๒.๔ มี Anode Heat Storage Capacity ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ HU.

๔.๒.๕ มี Light Beam Collimator สามารถปรับขนาดของลำรังสีได้ตามต้องการและ
มีความสว่างไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลักซ์

๔.๒.๖ มีชุด Collimator ที่สะดวกต่อการใช้งาน สามารถปรับหมุนได้ตามต้องการ

๑.  ๒.  ๓.  ๔.  ๕. 

/๔.๓ ชุดเสาและแขน....

๔.๓ ชุดเสาและแขนยึดหลอดเอกซเรย์ (Tube Column and Supporting Arm)

๔.๓.๑ ระบบแขนยึดหลอดเอกซเรย์เป็นแบบ Telescopic สามารถปรับระยะยึดออกในแนวนอน และจัดหัวหลอดได้สะดวก และมีระบบถ่วงให้แขนยึดหลอดเอกซเรย์อยู่ในสภาพที่สมดุล และหยุดนิ่งได้ทุกระดับโดยระบบ Electromagnetic Lock

๔.๓.๒ สามารถปรับระดับความสูงของหลอดเอกซเรย์ได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐๐ มิลลิเมตร

๔.๓.๓ แขนยึดหลอดเอกซเรย์สามารถหมุนรอบแกนยึดหลอดได้

๔.๔ ชุดควบคุมระบบขับเคลื่อน

๔.๔.๑ มีระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และมีระบบเบรกอัตโนมัติ

๔.๔.๒ ชุดควบคุมความเร็วสามารถปรับระดับความเร็วได้หลายระดับ ตามความต้องการของผู้ใช้

๔.๔.๓ มีระบบขับเคลื่อนที่ Collimator เพื่อสะดวกในการจัดตำแหน่งในการถ่ายโดยไม่ต้องเดินมาที่ตัวรถ

๔.๔.๔ สามารถไต่ระดับความลาดชันได้ไม่น้อยกว่า ๗ องศา

๔.๔.๖ ใช้พลังงานขับเคลื่อนจาก Battery

๔.๔.๗ มี Battery Voltage Indicator

๔.๔.๘ มีระบบ Calculated dose สำหรับวัดปริมาณรังสีที่ออกมาจากตัวเครื่อง

๕ อุปกรณ์ประกอบ

๕.๑ เสือตะกั่วกันรังสีเอกซเรย์ จำนวน ๑ ชุด

๕.๒ ไทรอยด์ชีว จำนวน ๑ ชุด

๕.๓ ฉากตะกั่ว จำนวน ๑ ชุด

๕.๔ Gonad Shield จำนวน ๑ set

๕.๕ มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ ชุด

๕.๖ มีคู่มือวงจรไฟฟ้าของเครื่องเพื่อใช้ในการดูแลและบำรุงรักษา จำนวน ๑ ชุด

๖ เงื่อนไขเฉพาะ

๖.๑ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน

๖.๒ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพสินค้า ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันรับมอบสินค้าครบถ้วน

๖.๓ ผู้ขายต้องส่งเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญงานซึ่งได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตมาดำเนินการติดตั้งเครื่อง และอุปกรณ์ รวมทั้งระบบเชื่อมต่อต่างๆ ทั้งหมดจนสามารถใช้งานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

๖.๔ ในวันส่งมอบอุปกรณ์ผู้ขายต้องดำเนินการให้เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทำการตรวจสอบคุณภาพเครื่องและออกเอกสารรับรองความปลอดภัยจากรังสี โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๖.๕ มีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทฯ ผู้ผลิต หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศไทยจากบริษัทผู้จำหน่าย (ให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา)

๖.๖ กรณีเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศต้องมีเอกสารรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์

จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา)

๑.....

๒.....

๓.....

๔.....

๕.....

/๖.๗ ในระยะประกัน....

- ๖.๗ ในระยะประกันผู้ขายต้องเข้ามาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องทุกๆ ๓ เดือน
- ๖.๘ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่ไว้จำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๖.๙ หากสิ่งของตามสัญญาเกิดการชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง เนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขาย จะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หรือหาเครื่องที่มีสภาพการใช้งานได้ดีมาให้สำรองใช้ระหว่างซ่อมบำรุง หากขัดข้องใช้งานไม่ได้ ผู้ขายจะต้องจัดหาเครื่องใหม่ให้โดยเร็ว
- ๖.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องชี้แจงรายละเอียดและคุณสมบัติทางเทคนิคในแคตตาล็อก พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อ ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจน (ให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุรัชย์ เจียมกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรวิทย์ บุญฤทธิ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพัทธนันท์ พิศกลาง)

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลบ่อไร่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพนาวลัย ธรรมบริสุทธิ์)

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลแหลมงอบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรุ่งอรุณ นิรันดร์เรือง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลคลองใหญ่

(นายบัญชา ลรรพโล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑.ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วินิจฉัย) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๑,๒๕๐,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๓,๘๗๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

-จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโครงการพัฒนาศักยภาพ หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๓,๘๗๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๔.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕

- รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๑,๒๕๐,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๓,๘๗๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๕.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ สืบราคาจากท้องตลาด

๕.๑.๑ บริษัท เมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ๕.๑.๒ บริษัท เอซีซี เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด

๕.๑.๓ บริษัท เอส ที เพอร์เฟกชั่น จำกัด ๕.๑.๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิแคร์ ชีพพลาย

๕.๑.๕ บริษัท เคพีเอ็น เมดิคอล จำกัด ๕.๑.๖ บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง) ทุกคน

๑) นายสุรัชย์ เจริญกุล	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)	ประธานกรรมการ
	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	
๒) นายสรารุณ บุญฤทธิ์	นายแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
	รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่	
๓) นางสาวพัทธนันท์ พิศกลาง	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
	โรงพยาบาลบ่อไร่	
๔) นางสาวพนาวลัย ธรรมบริสุทธิ์	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
	โรงพยาบาลแหลมฉบัง	
๕) นายรุ่งอรุณ นิรันดร์เรือง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
	โรงพยาบาลคลองใหญ่	

ราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รายการที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
๒.	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA	๑ เครื่อง	๕,๑๓๘,๐๐๐.-	๕,๑๓๘,๐๐๐.-
รวมเป็นเงิน (ห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				๕,๑๓๘,๐๐๐.-


 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายสุรัชชัย เจียมกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายสรวิทย์ บุญฤทธิ์) (นางสาวพัทธนันท์ พิศกลาง)
 นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่
 นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
 โรงพยาบาลบ่อไร่

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวพนาวลัย ธรรมบริสุทธิ) (นายรุ่งอรุณ นิรันดร์เรือง)
 นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
 โรงพยาบาลแหลมงอบ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 โรงพยาบาลคลองใหญ่

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

๑) ความต้องการ

เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๒ กิโลวัตต์ มีอุปกรณ์ที่สามารถปรับแต่งและแสดงภาพเอกซเรย์ดิจิตอลได้ ที่ตัวเครื่องและสามารถใช้งานร่วมกับระบบจัดเก็บรับส่ง และจัดการภาพทางการแพทย์ (PACS) ของโรงพยาบาลได้

๒) คุณสมบัติทั่วไป

สำหรับใช้งานในการถ่ายภาพเอกซเรย์ในแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาลเพื่อการวินิจฉัยโรค โดยเป็นเครื่องที่สามารถเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยระบบควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

๓) คุณสมบัติทางเทคนิค

๓.๑) คุณสมบัติเครื่องเอกซเรย์ มีดังนี้

- ๓.๑.๑) เครื่องเอกซเรย์ระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า เสาหลอดเอกซเรย์สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ เพื่อการเคลื่อนย้ายที่สะดวก
- ๓.๑.๒) สามารถปรับระยะโฟกัสของหลอดเอกซเรย์ได้ต่ำสุดไม่เกินกว่า ๗๒๐ มิลลิเมตร และระยะโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๐๑๐ มิลลิเมตร
- ๓.๑.๓) สามารถปรับหมุนหลอดเอกซเรย์ ในแนวรอบแกนตั้ง Rotation Angle ได้ไม่น้อยกว่า ± 170 องศา เพื่อควบคุมการถ่ายภาพเอกซเรย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๓.๑.๔) สามารถปรับหมุนหลอดเอกซเรย์ ในแนวรอบแกนนอน ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๗ องศา
- ๓.๑.๕) เครื่องเอกซเรย์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าความเร็วสูงสุดสำหรับการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและหลังไม่น้อยกว่าช่วง ๐-๐.๗ เมตร/วินาที หรือสามารถเคลื่อนที่ตามทางลาดชันได้ไม่น้อยกว่า ๗ องศา
- ๓.๑.๖) เครื่องทำงานด้วยแบตเตอรี่ สามารถถ่ายภาพได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ครั้ง
- ๓.๑.๗) มีสวิตช์ควบคุมการถ่ายภาพเอกซเรย์แบบมีสาย หรือระบบควบคุมทางไกล (Remote)
- ๓.๑.๘) ชุดเสายึดหลอดเอกซเรย์เป็นแบบ(Collapsible Column) เลื่อนขึ้นลงและพับเก็บได้

๓.๒) คุณสมบัติสำหรับการถ่ายภาพรังสี (X-Ray Specification) มีดังนี้

- ๓.๒.๑) เครื่องกำเนิดรังสีมีขนาดกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๒ กิโลวัตต์
- ๓.๒.๒) กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ระดับไม่น้อยกว่า ๓๒๐ มิลลิแอมป์
- ๓.๒.๓) สามารถปรับความต่างศักย์ได้ไม่น้อยกว่าช่วง ๔๐-๑๒๕ กิโลโวลต์ โดยปรับได้ครั้งละ ๑ กิโลโวลต์
- ๓.๒.๔) สามารถปรับระดับกระแสไฟฟ้าวินาทีได้ไม่น้อยกว่าช่วง ๐.๑-๓๒๐ มิลลิแอมป์วินาที
- ๓.๒.๕) ระยะเวลาในการถ่ายภาพเอกซเรย์ไม่เกิน ๓ วินาที
- ๓.๒.๖) ความสามารถในการระบายความร้อนแบบต่อเนื่อง (Continuous Thermal Dissipation)

๑.....

๒.....

๓.....

๔.....

๕.....

/๓.๓) คุณสมบัติของหลอด...

- ๓.๓) คุณสมบัติของหลอดเอกซเรย์เทคโนโลยี (X-Ray Tube) มีดังนี้
- ๓.๓.๑) ค่าความต่างศักย์ของหลอดเอกซเรย์ ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลโวลต์
 - ๓.๓.๒) ขนาดเข้าโพกัสเอกซเรย์ขนาดเล็กไม่ใหญ่เกินกว่า ๐.๘ และขนาดโพกัสเข้าเอกซเรย์ขนาดใหญ่ไม่เกินกว่า ๑.๓ มิลลิเมตร ขนาดกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๒ กิโลวัตต์
 - ๓.๓.๓) ขั้วหลอดเอกซเรย์แอโนดมีขนาดมุมเอียงไม่เกินกว่า ๑๕ องศา
 - ๓.๓.๔) ความจุความร้อนของหลอดเอกซเรย์ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ HU
- ๓.๔) คุณสมบัติของชุดคอลลิเมเตอร์ (Collimator) มีดังนี้
- ๓.๔.๑) คอลลิเมเตอร์สามารถปรับขนาดได้และมีไฟสว่างขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลักซ์
 - ๓.๔.๒) มีแสงเลเซอร์เพื่อกำหนดขอบเขตของระยะโพกัส
 - ๓.๔.๓) แหล่งกำเนิดของแสงสว่างสามารถให้แสงสว่างสูงได้จากพลังงานไฟแอลอีดี
 - ๓.๔.๔) สามารถปรับหมุนคอลลิเมเตอร์ได้ไม่น้อยกว่า -๙๐/+๑๘๐ องศา
 - ๓.๔.๕) มี Light Beam Collimator เป็นชนิด LED
- ๓.๕) คุณสมบัติของแผ่นรับภาพเอกซเรย์ดิจิทัล (DR) มีดังนี้
- ๓.๕.๑) แผ่นรับภาพเอกซเรย์ดิจิทัลขนาด ๔๖๐x๓๘๔x๑๕ มิลลิเมตร มีขนาดพิกเซล ไม่มากกว่า ๑๕๐ ไมครอน
 - ๓.๕.๒) พื้นที่ในการรับภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕x๔๓ เซนติเมตร รายละเอียดในการแสดงภาพ สูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๐๔๐ X ๒๔๖๖ พิกเซล
 - ๓.๕.๓) แผ่นแปลงสัญญาณภาพ (Detector) มีประสิทธิภาพในการตรวจจับรังสีเอกซ์ (Detective Quantum Efficiency : DQE) ไม่น้อยกว่า ๗๐ %
 - ๓.๕.๔) การทำงานระบบไร้สาย Wi-Fi มาตรฐานการเชื่อมต่อแบบ IEEE๘๐๒.๑๑a/b/g/n/ac ช่วงความถี่ ๒.๔GHz / ๕GHzหรือระบบไร้สาย ตั้งแต่ ๔ G ขึ้นไป
 - ๓.๕.๕) การเชื่อมต่อแบบไร้สายมีระยะเวลาในการแสดงภาพตัวอย่างไม่นานเกินกว่า ๓ วินาที และระยะเวลาในการประมวลผลภาพไม่นานเกินกว่า ๗ วินาที
 - ๓.๕.๖) ปฏิบัติงานด้วยแบตเตอรี่จำนวน ๒ ชุด ระยะเวลาการปฏิบัติงานได้นานไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง โดยมีระยะเวลาในการชาร์จไฟฟ้าเต็มไม่นานเกินกว่า ๓ ชั่วโมง
 - ๓.๕.๗) แผ่นสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลกรัม และสามารถรับแรงกด ในบริเวณพื้นที่จากเส้นผ่าศูนย์กลางระยะ ๔๐ มิลลิเมตร ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม
 - ๓.๕.๘) ขนาดน้ำหนักของแผ่นรับภาพดิจิทัลรวมแบตเตอรี่ไม่เกินกว่า ๓ กิโลกรัม
 - ๓.๕.๙) มาตรฐานการป้องกันที่ระดับ IP๕๔ หรือดีกว่า
- ๓.๖) คุณสมบัติจอแสดงผลและชุดประมวลผลภาพ (Image Processing) มีดังนี้
- ๓.๖.๑) จอภาพระบบสัมผัส (Touch Screen) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ชนิดรายละเอียดสูง ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐x๑,๐๒๔ พิกเซล
 - ๓.๖.๒) ชุดประมวลผลความเร็วสูง หน่วยความจำหลัก HDD ไม่น้อยกว่า ๒๕๖ หน่วยความจำ สำหรับ อ่านอย่างเดียว (RAM) ไม่น้อยกว่า ๔ กิกะไบต์

๑.....๒.....๓.....๔.....๕.....
/๓.๖.๓) การประมวลผล...

- ๓.๖.๓) การประมวลผลภาพสามารถถ่ายโอนข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายทางการแพทย์แบบ DICOM ๓.๐ ได้ อย่างน้อยดังนี้ DICOM Media Storage, DICOM MPPS (SCU), DICOM Print Management (SCU), DICOM Storage (SCU), DICOM Storage Commitment (SCU), DICOM Worklist (SCU)
- ๓.๖.๔) รูปแบบการปฏิบัติงานมาตรฐานอย่างน้อย ดังนี้ มีระบบการประมวลผลภาพ (Acquisition) มีระบบการประมวลผลภาพขั้นสูง มีระบบการจัดเก็บภาพแบบ DICOM Store
- ๓.๖.๕) มีเครื่องมือสำหรับการประมวลผลขั้นพื้นฐานมีอย่างน้อย ดังนี้ Windowing, Magnifying, Rotating, Flipping, Cropping, Annotation เป็นต้น
- ๓.๖.๖) คุณสมบัติพิเศษในการปฏิบัติงานอย่างน้อยดังนี้ สามารถสำรองข้อมูลการใช้งานแบบอัตโนมัติ มีระบบการล้างข้อมูลแบบอัตโนมัติ มีระบบการปรับภาพอัตโนมัติ เป็นต้น

๔) อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๔.๑) แบตเตอรี่สำหรับแผ่นรับภาพ	จำนวน ๒ ชุด
๔.๒) แท่นชาร์จแบตเตอรี่	จำนวน ๑ ชุด
๔.๓) เสื้อตะกั่วป้องกันรังสี	จำนวน ๑ ชุด
๔.๔) แวนตาป้องกันรังสี	จำนวน ๑ ชุด
๔.๕) ฉากตะกั่วแบบมีล้อเลื่อน	จำนวน ๑ ชุด
๔.๖) Thyroid shield	จำนวน ๑ ชุด
๔.๑๐) Gonad shield	จำนวน ๑ ชุด
๔.๑๑) Chest Bucky Stand Auto	จำนวน ๑ ชุด
๔.๑๒) Detector Holder	จำนวน ๑ ชุด
๔.๑๓) คู่มือการใช้งานเครื่อง	จำนวน ๑ ชุด

๕) คุณสมบัติและเงื่อนไขอื่น

- ๕.๑) เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน
- ๕.๒) ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพสินค้า ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันรับมอบสินค้าครบถ้วน
- ๕.๓) ผู้ขายต้องส่งเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญงานซึ่งได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตมาดำเนินการติดตั้งเครื่อง และอุปกรณ์ รวมทั้งระบบเชื่อมต่อต่างๆ ทั้งหมดจนสามารถใช้งานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
- ๕.๔) ในวันส่งมอบอุปกรณ์ผู้ขายต้องดำเนินการให้เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทำการ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องและออกเอกสารรับรองความปลอดภัยจากรังสี โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- ๕.๕) มีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทฯ ผู้ผลิต หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศไทยจากบริษัทผู้จำหน่าย (ให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา)
- ๕.๖) กรณีเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศต้องมีเอกสารรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา)
- ๕.๗) ในระยะประกันผู้ขายต้องเข้ามาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องทุกๆ ๓ เดือน

๑.....๒.....๓.....๔.....๕.....
/๕.๘) ผู้เสนอราคา...

- ๕.๘) ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่ไว้จำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๕.๙) หากสิ่งของตามสัญญาเกิดการชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หรือหาเครื่องที่มีสภาพการใช้งานได้ดีมาให้สำรองใช้ระหว่างซ่อมบำรุง
- ๕.๑๐) ผู้เสนอราคาต้องชี้แจงรายละเอียดและคุณสมบัติทางเทคนิค ในแคตตาล็อก พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อ ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจน (ให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุรัชย์ เจียมกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสรารุณี บุญฤทธิ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวพัทธนันท์ พิศกลาง)

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลบ่อไร่

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวพนาวลัย ธรรมบริสุทธิ์)

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลแหลมงอบ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายรุ่งอรุณ นิรันดร์เรือง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลคลองใหญ่

(นายบุญชา ลรรพโส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑.ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วินิจฉัย) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๕,๑๓๘,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

-จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโครงการพัฒนาศักยภาพ หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๕,๑๓๘,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕

- รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๕,๑๓๘,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ สืบราคาจากท้องตลาด

๕.๑.๑ บริษัท ไทย เฮลท์ เทค จำกัด

๕.๑.๒ บริษัท เอซีซี เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด

๕.๑.๓ บริษัท เคพีเอ็น เมดิคอล จำกัด

๕.๑.๔ บริษัท เมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

๕.๑.๕ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิแคร์ ชัพพลาย

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง) ทุกคน

๑) นายสุรัชย์ เจริญกุล

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

ประธานกรรมการ

(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

๒) นายสรวิทย์ บุญฤทธิ์

นายแพทย์ชำนาญการ

กรรมการ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

๓) นางสาวพัทธนันท์ พิศกลาง

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ

กรรมการ

โรงพยาบาลบ่อไร่

๔) นางสาวพนาวลัย ธรรมบริสุทธิ์

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ

กรรมการ

โรงพยาบาลแหลมงอบ

๕) นายรุ่งอรุณ นิรันดร์เรือง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

โรงพยาบาลคลองใหญ่



บันทึกข้อความ

รับที่ ๑๑๙๖
วันที่ ๑๖.๖.๒๕
เวลา ๑๐.๑๐ น.

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด สำนักงานบริหารทั่วไป-งานพัสดุฯ โทร ๐-๓๙๕๑-๑๐๑๑ ต่อ ๔๔๑

ที่ ตร ๐๐๓๓/๑๑๙๖

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานขอซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วินิจฉัย) จำนวน ๒ รายการ และจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโครงการพัฒนาศักยภาพ หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วินิจฉัย) จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๙,๐๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านแปดพันบาทถ้วน) (เอกสาร ๑)

๑.๒ ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๔๔๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วินิจฉัย) จำนวน ๒ รายการ สำหรับใช้ประกอบการจัดซื้อในครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดราคากลางสรุปเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๙,๐๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านแปดพันบาทถ้วน) (เอกสาร ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ จังหวัดตราด อนุมัติให้ใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคากลางดังกล่าว ในการดำเนินการจัดซื้อตามแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ที่ ตร ๐๐๓๓/๑๐๙ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ (เอกสาร ๓)

๒.๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จึงขอจัดทำรายงานขอซื้อตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วินิจฉัย) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็น

เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้บริการผู้ป่วยและขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

/๒.รายละเอียด...

๒. รายละเอียดของงานซื้อ

รายการที่ ๑ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐บาท รวมเป็นเงิน ๓,๗๕๐,๐๐๐.๐๐บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) สำหรับ ๑) โรงพยาบาลคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ๒) โรงพยาบาลบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด และ ๓) โรงพยาบาลแหลมงอบ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

รายการที่ ๒ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๕,๑๓๘,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) สำหรับโรงพยาบาลคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๓. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามสืปรราคาจากท้องตลาด จำนวน ๙,๐๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านแปดพันบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

งบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโครงการพัฒนาศักยภาพ หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๙,๐๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านแปดพันบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผล

ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เนื่องจากเป็นการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น และพิจารณาต่อรายการ

๘. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ

ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วินิจฉัย) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเห็นควร ไม่นำร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตราด และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เนื่องจาก ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่องมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

๙. กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา

๑๐. ข้อเสนออื่น ๆ

ขอเสนอรายชื่อบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนี้

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------|---|--------------------------|
| ๑) นายสุรัชย์ เจียมกุล | นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด | ประธานกรรมการ
กรรมการ |
| ๒) นายสรายุทธ บุญฤทธิ์ | นายแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ | กรรมการ |
| ๓) นางสาวพัชรนันท์ พิศกลาง | นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลบ่อไร่ | กรรมการ |

อำนาจและหน้าที่

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และรายงานผลให้ทราบภายใน ๗ วันทำการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------|
| ๑) นายวีรภัทร สุนทรวังศ์ | นายแพทย์ปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อไร่ | ประธานกรรมการ
กรรมการ |
| ๒) นางสาวพนาวลัย ธรรมบริสุทธิ | นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลแหลมงอบ | กรรมการ |
| ๓) นายรุ่งอรุณ นิรันดร์เรือง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลคลองใหญ่ | กรรมการ |

อำนาจและหน้าที่

ตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕ และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลง และรายงานผลให้ทราบภายใน ๗ วันทำการ

๓. ข้อระเบียบ

๓.๑ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒, ข้อ ๒๕ (๑), (๕), ข้อ ๔๓, ข้อ ๔๕ (๒) และข้อ ๔๖ (เอกสาร ๔)

๓.๒ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่องมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (เอกสาร ๕)

๓.๓ คำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๕๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ผนวก ฉ. มอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด และที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบทุกขั้นตอน ทุกมาตรา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และทุกข้อตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือข้อสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อ ๑. การดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุดจากเงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด, เงินงบประมาณจังหวัด ซึ่งมีโครงการที่มอบให้ส่วนราชการส่วนภูมิภาคและเงินนอกงบประมาณ โดยมีวงเงินในการมอบอำนาจดังต่อไปนี้ ข้อ ๑.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท (เอกสาร ๖)

๓.๔ ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๑๘๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอและผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (ครั้งที่๒) ผนวก ข ข้อ ๒ “นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ควบคุม กำกับดูแล เร่งรัด ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านเศรษฐกิจ สังคม พลังงาน สาธารณสุขการบริหารราชการ และงานอื่นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ดังนี้ ๘.๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด” (เอกสาร ๗)

๔. ข้อพิจารณา

๔.๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วินิจฉัย) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้
รายการที่ ๑ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐บาท รวมเป็นเงิน ๓,๗๕๐,๐๐๐.๐๐บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่น-บาทถ้วน) สำหรับ ๑) โรงพยาบาลคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ๒) โรงพยาบาลบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด และ ๓) โรงพยาบาลแหลมงอบ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

รายการที่ ๒ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๕,๑๓๘,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) สำหรับโรงพยาบาลคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๔.๒ ลงนามในคำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วินิจฉัย) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๕. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้



(นางสาวอุทัย อ่อนภู)

นักวิชาการพัสดุ

เจ้าหน้าที่



(นางอุษณี เนินสถาน)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



(นายบัญชา สรรพโส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

เห็นชอบ

ลงนามแล้ว



(นายฉัตรพงศ์ ไชยพงษ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

นพ. ๑/นวก ๑/จบก. ๖	วันที่
หน. กลุ่มงาน/งาน	วันที่
เจ้าหน้าที่	วันที่ 1 มี.ค. ๖๕
เจ้าหน้าที่พิมพ์/งาน	วันที่